


De acuerdo con los datos obtenidos que presentó el equipo, se realiza tabla para verificar la intensidad de salida de la luz de la lámpara

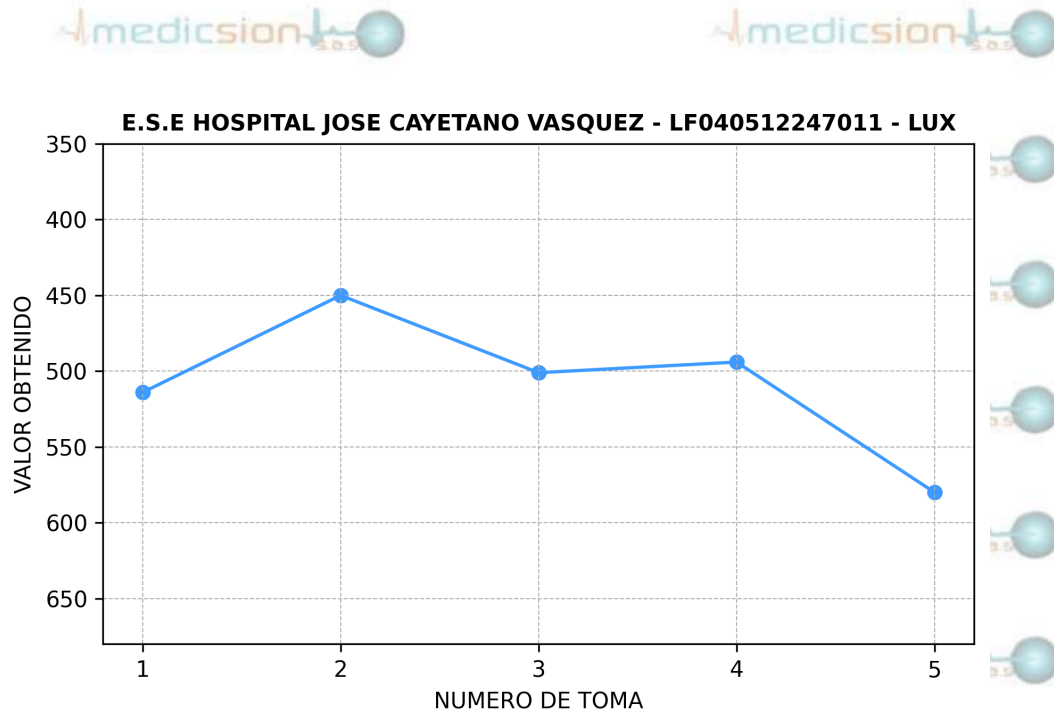

### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que la lámpara de fototerapia, mantenga su precisión a lo largo del tiempo.

### OBSERVACIONES

Tiene dos tubos dañados, hay que realizarle mantenimiento preventivo