Shift More

Input signal: **697 Hz + 1209 Hz**
to be shifted from 0 to 200 samples (step = 50).

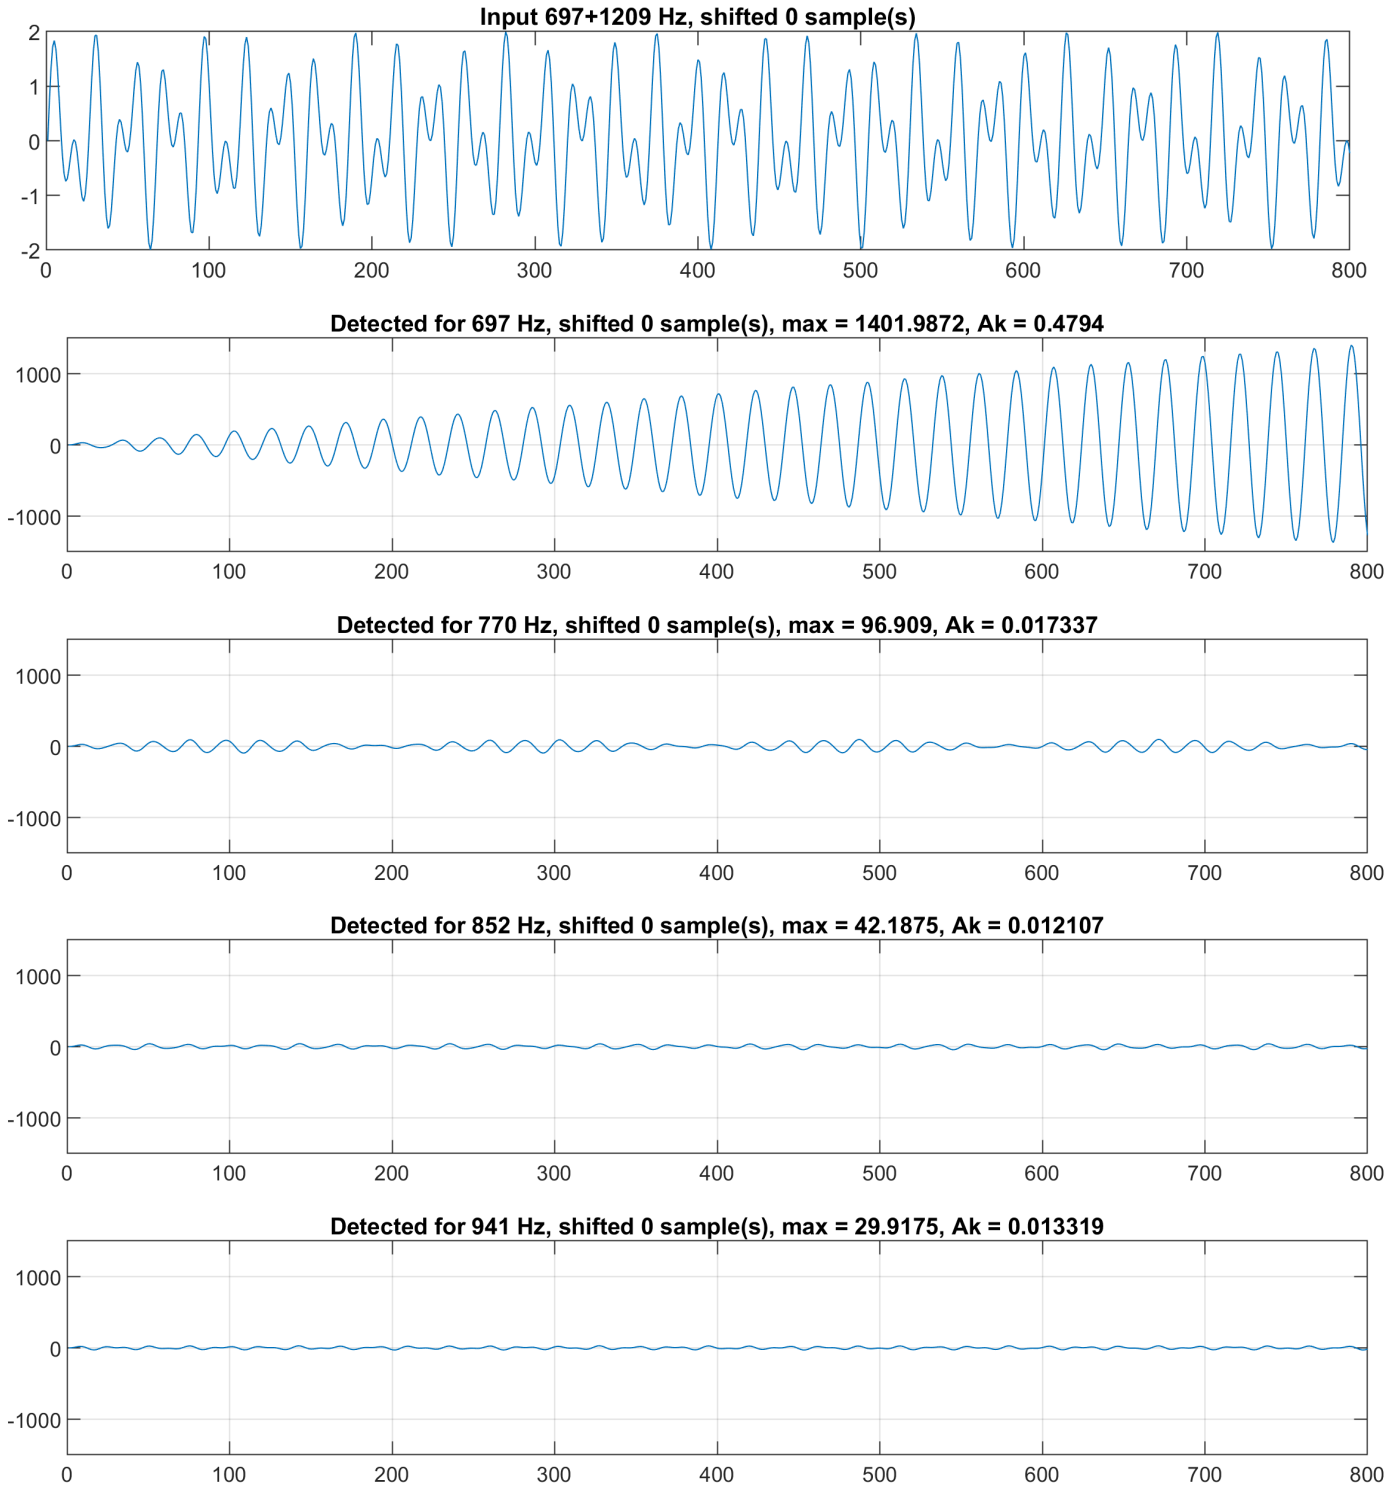

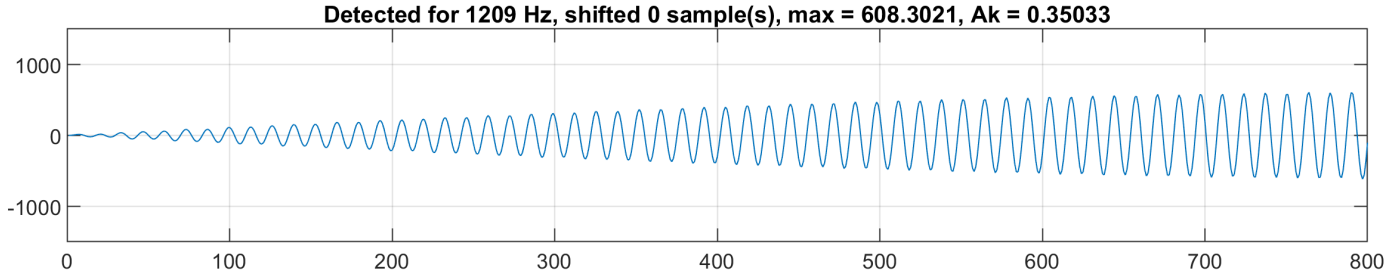
Detected for 1209 Hz, shifted 0 sample(s), max = 608.3021, Ak = 0.35033
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

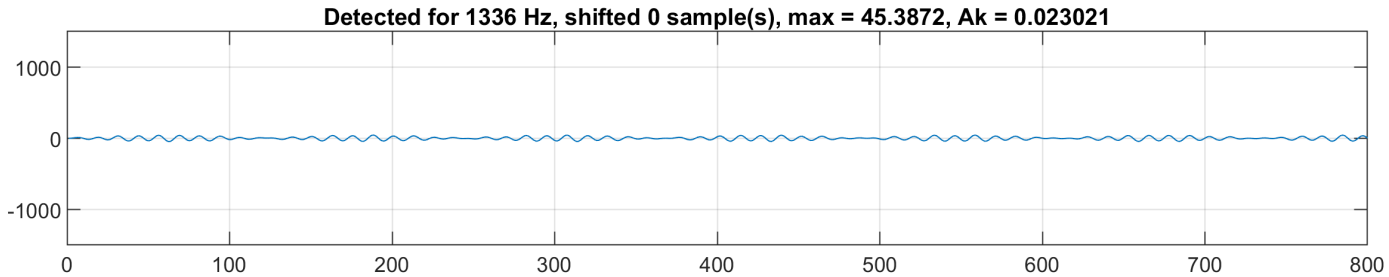
Detected for 1336 Hz, shifted 0 sample(s), max = 45.3872, Ak = 0.023021
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

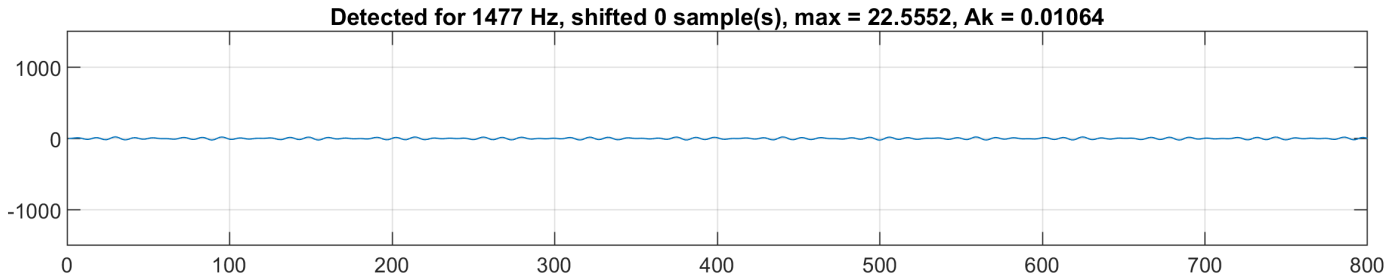
Detected for 1477 Hz, shifted 0 sample(s), max = 22.5552, Ak = 0.01064
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

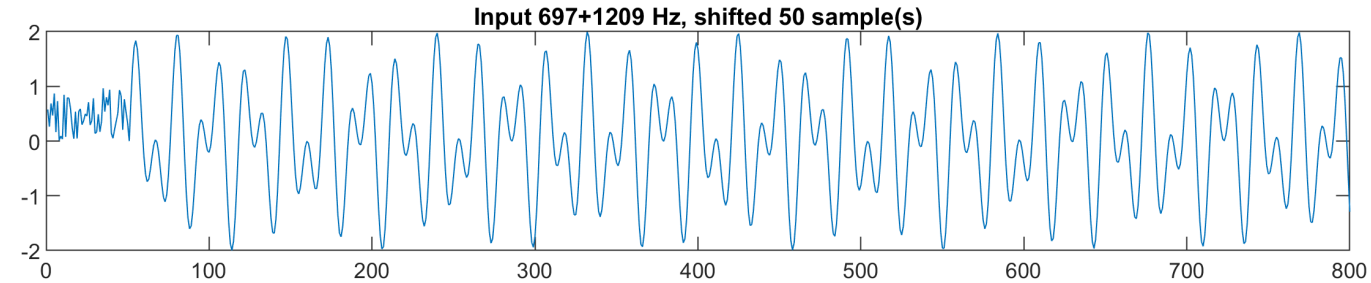
Input 697+1209 Hz, shifted 50 sample(s)
2
1
0
-1
-2
0
100
200
300
400
500
600
700
800

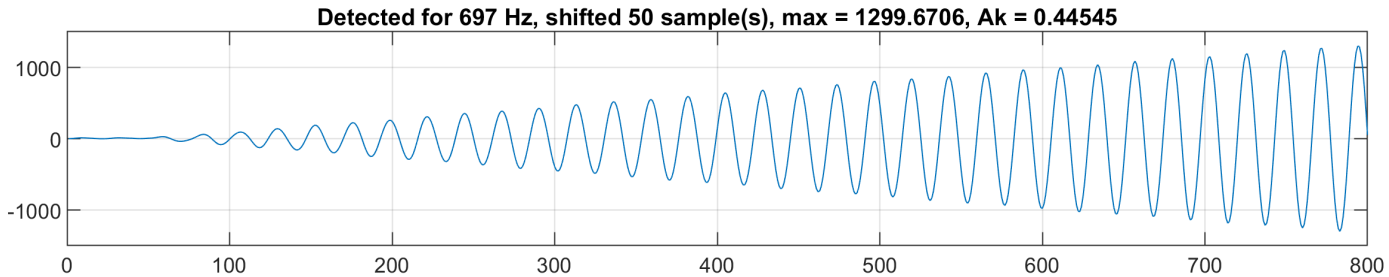
Detected for 697 Hz, shifted 50 sample(s), max = 1299.6706, Ak = 0.44545
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

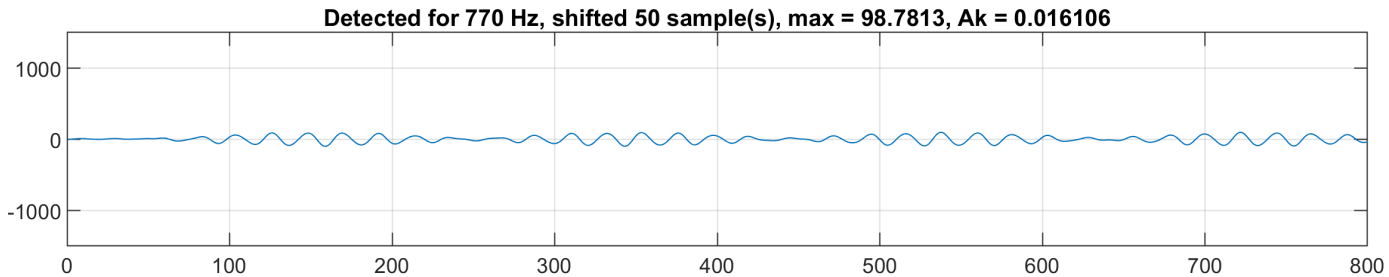
Detected for 770 Hz, shifted 50 sample(s), max = 98.7813, Ak = 0.016106
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

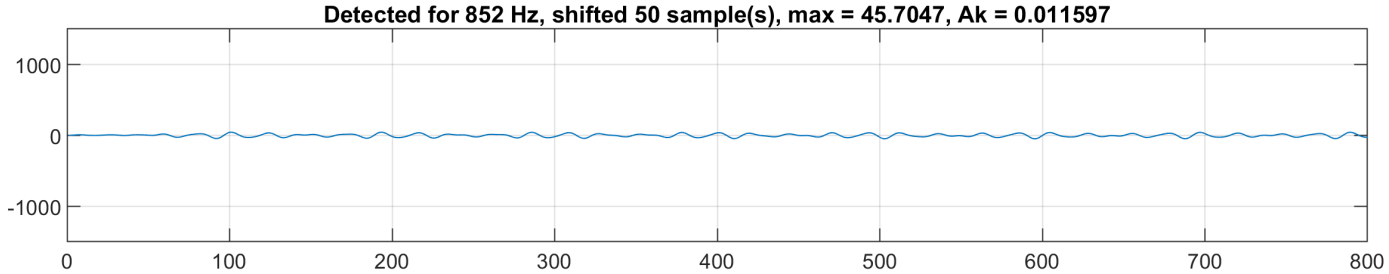
Detected for 852 Hz, shifted 50 sample(s), max = 45.7047, Ak = 0.011597
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

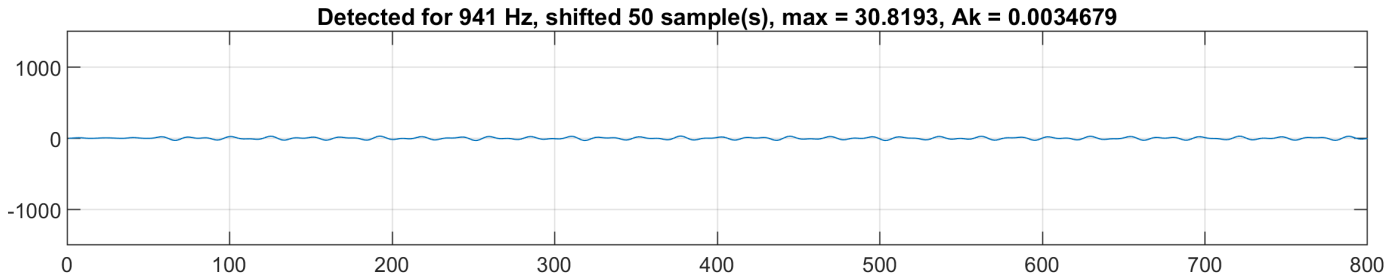
Detected for 941 Hz, shifted 50 sample(s), max = 30.8193, Ak = 0.0034679
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

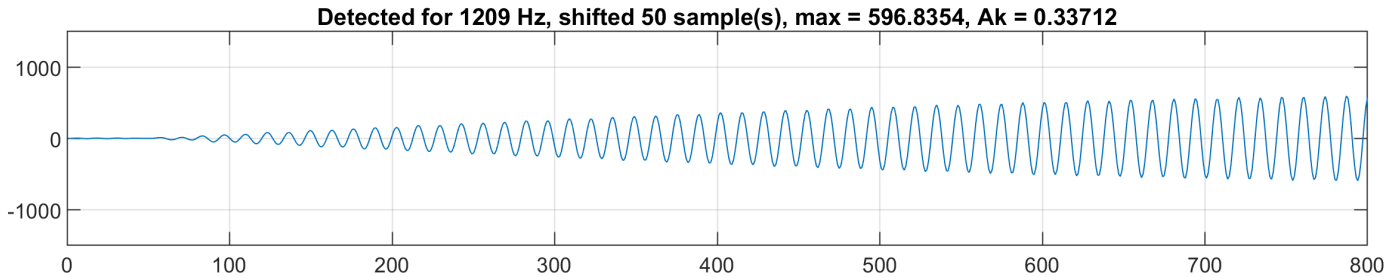
Detected for 1209 Hz, shifted 50 sample(s), max = 596.8354, Ak = 0.33712
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

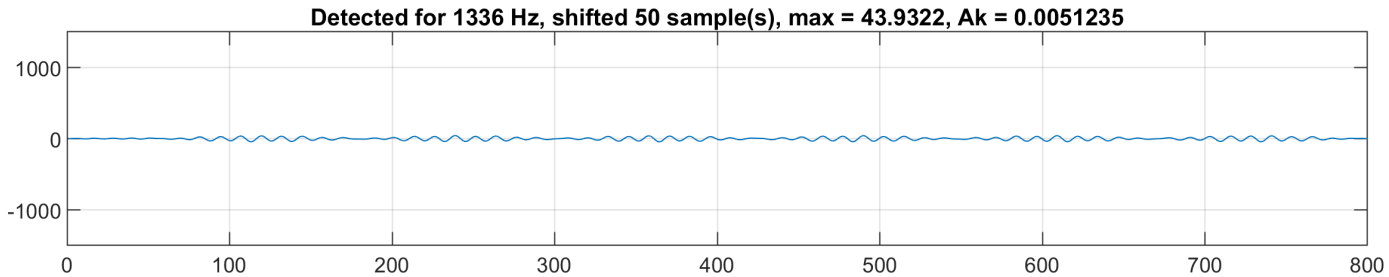
Detected for 1336 Hz, shifted 50 sample(s), max = 43.9322, Ak = 0.0051235
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

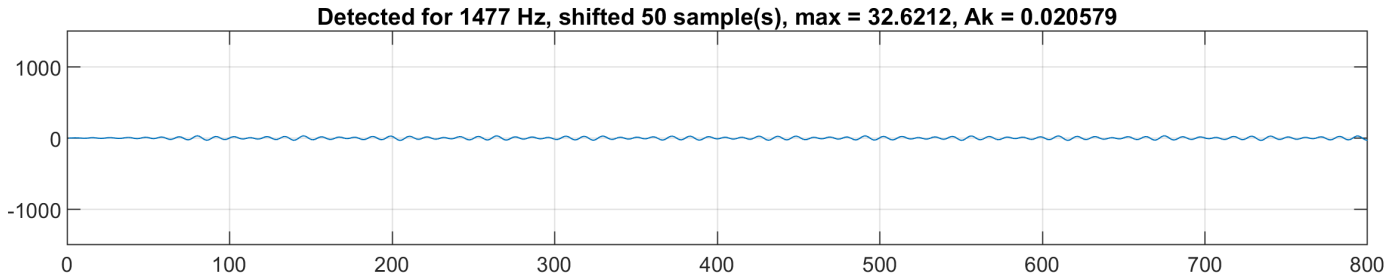
Detected for 1477 Hz, shifted 50 sample(s), max = 32.6212, Ak = 0.020579
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

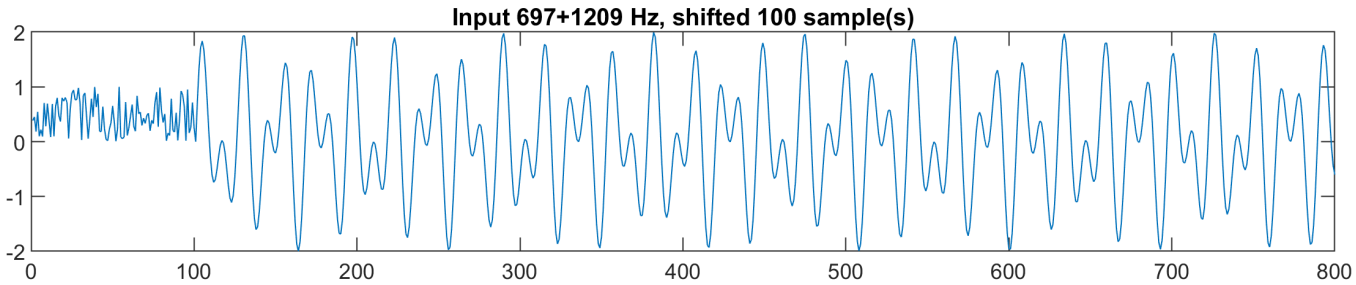
Input 697+1209 Hz, shifted 100 sample(s)
2
1
0
-1
-2
0
100
200
300
400
500
600
700
800

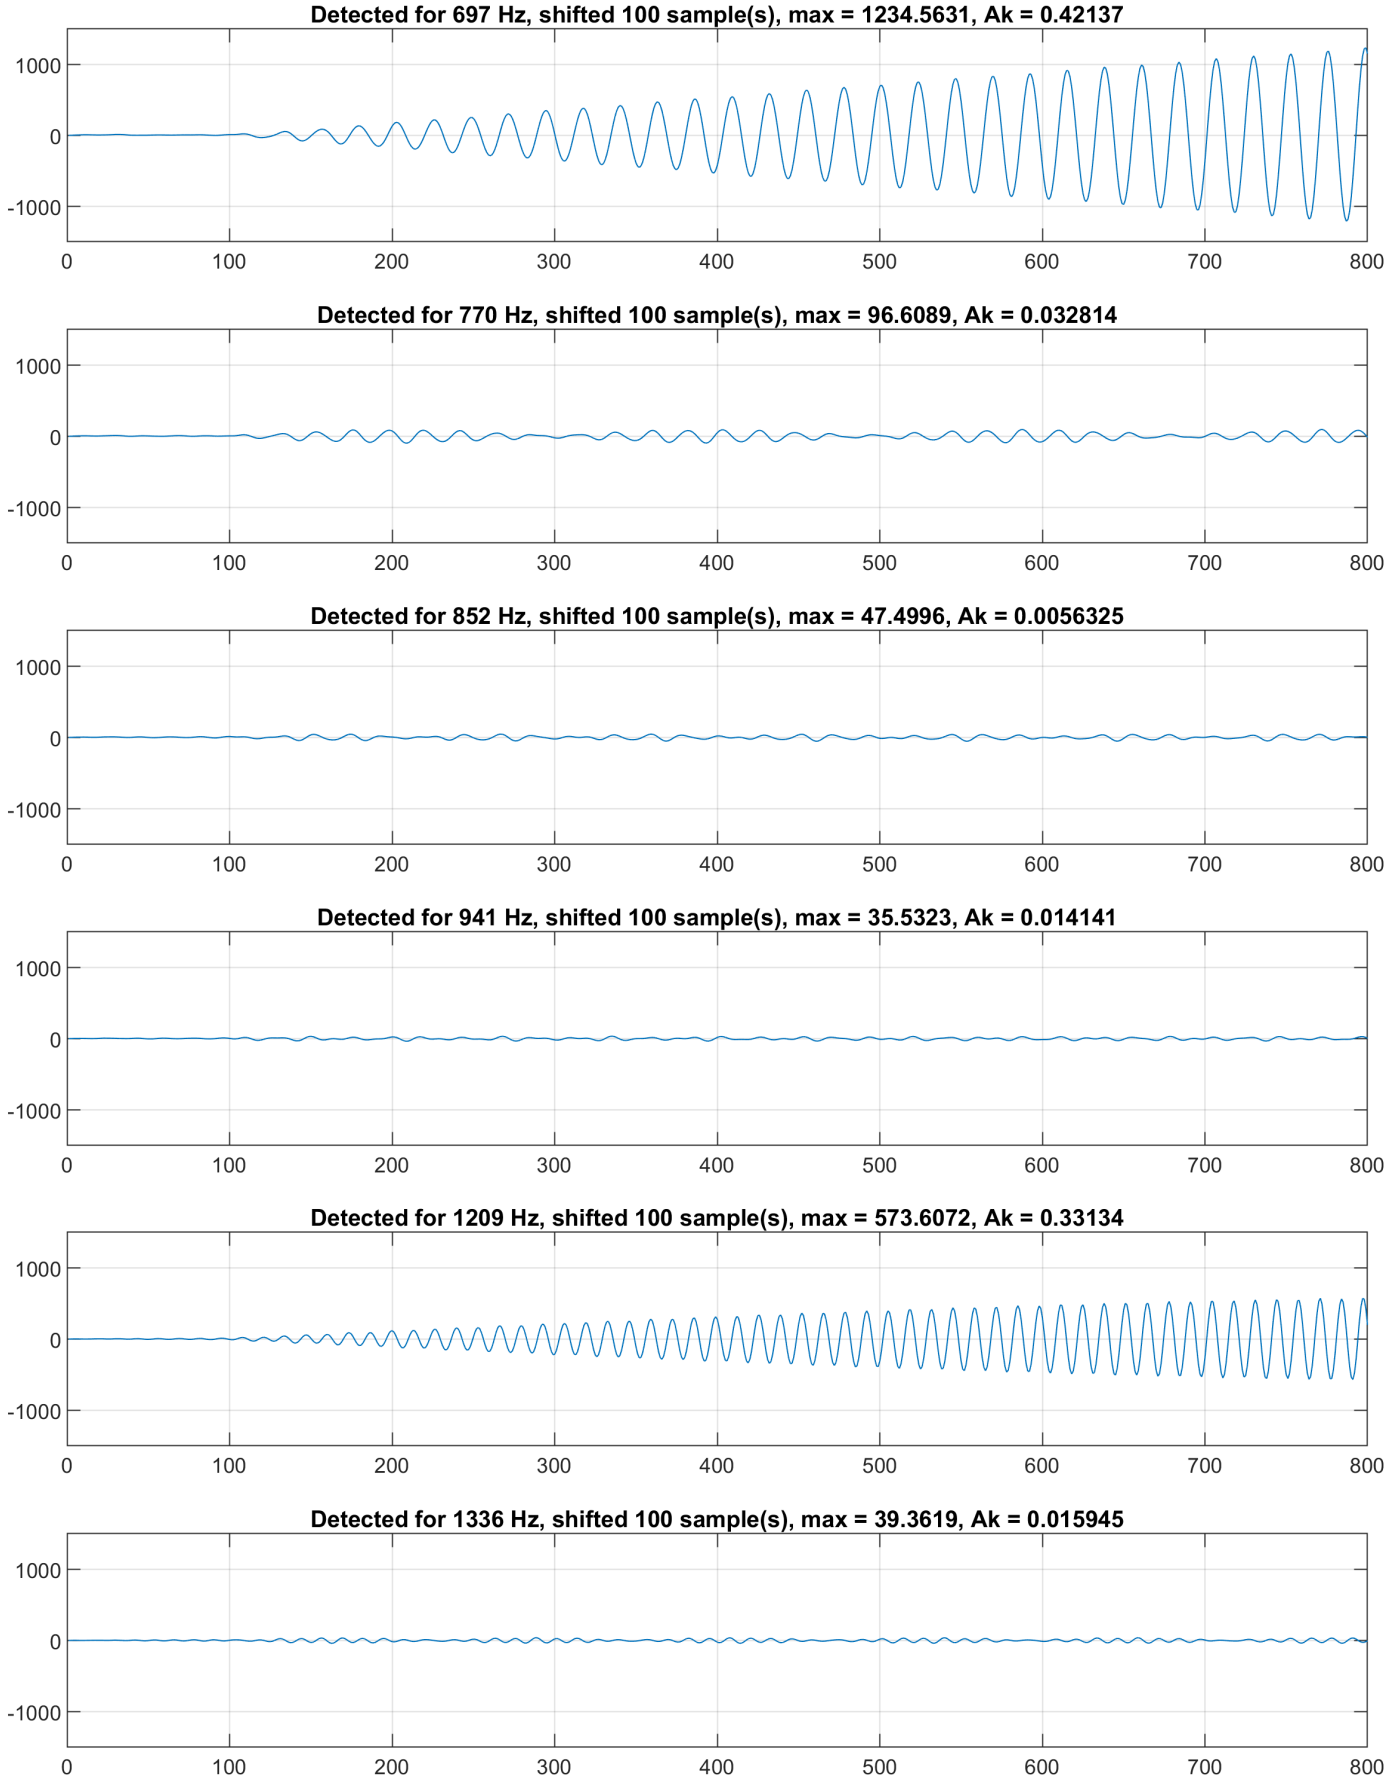
Detected for 697 Hz, shifted 100 sample(s), max = 1234.5631, Ak = 0.42137
Detected for 770 Hz, shifted 100 sample(s), max = 96.6089, Ak = 0.032814
Detected for 852 Hz, shifted 100 sample(s), max = 47.4996, Ak = 0.0056325
Detected for 941 Hz, shifted 100 sample(s), max = 35.5323, Ak = 0.014141
Detected for 1209 Hz, shifted 100 sample(s), max = 573.6072, Ak = 0.33134
Detected for 1336 Hz, shifted 100 sample(s), max = 39.3619, Ak = 0.015945
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

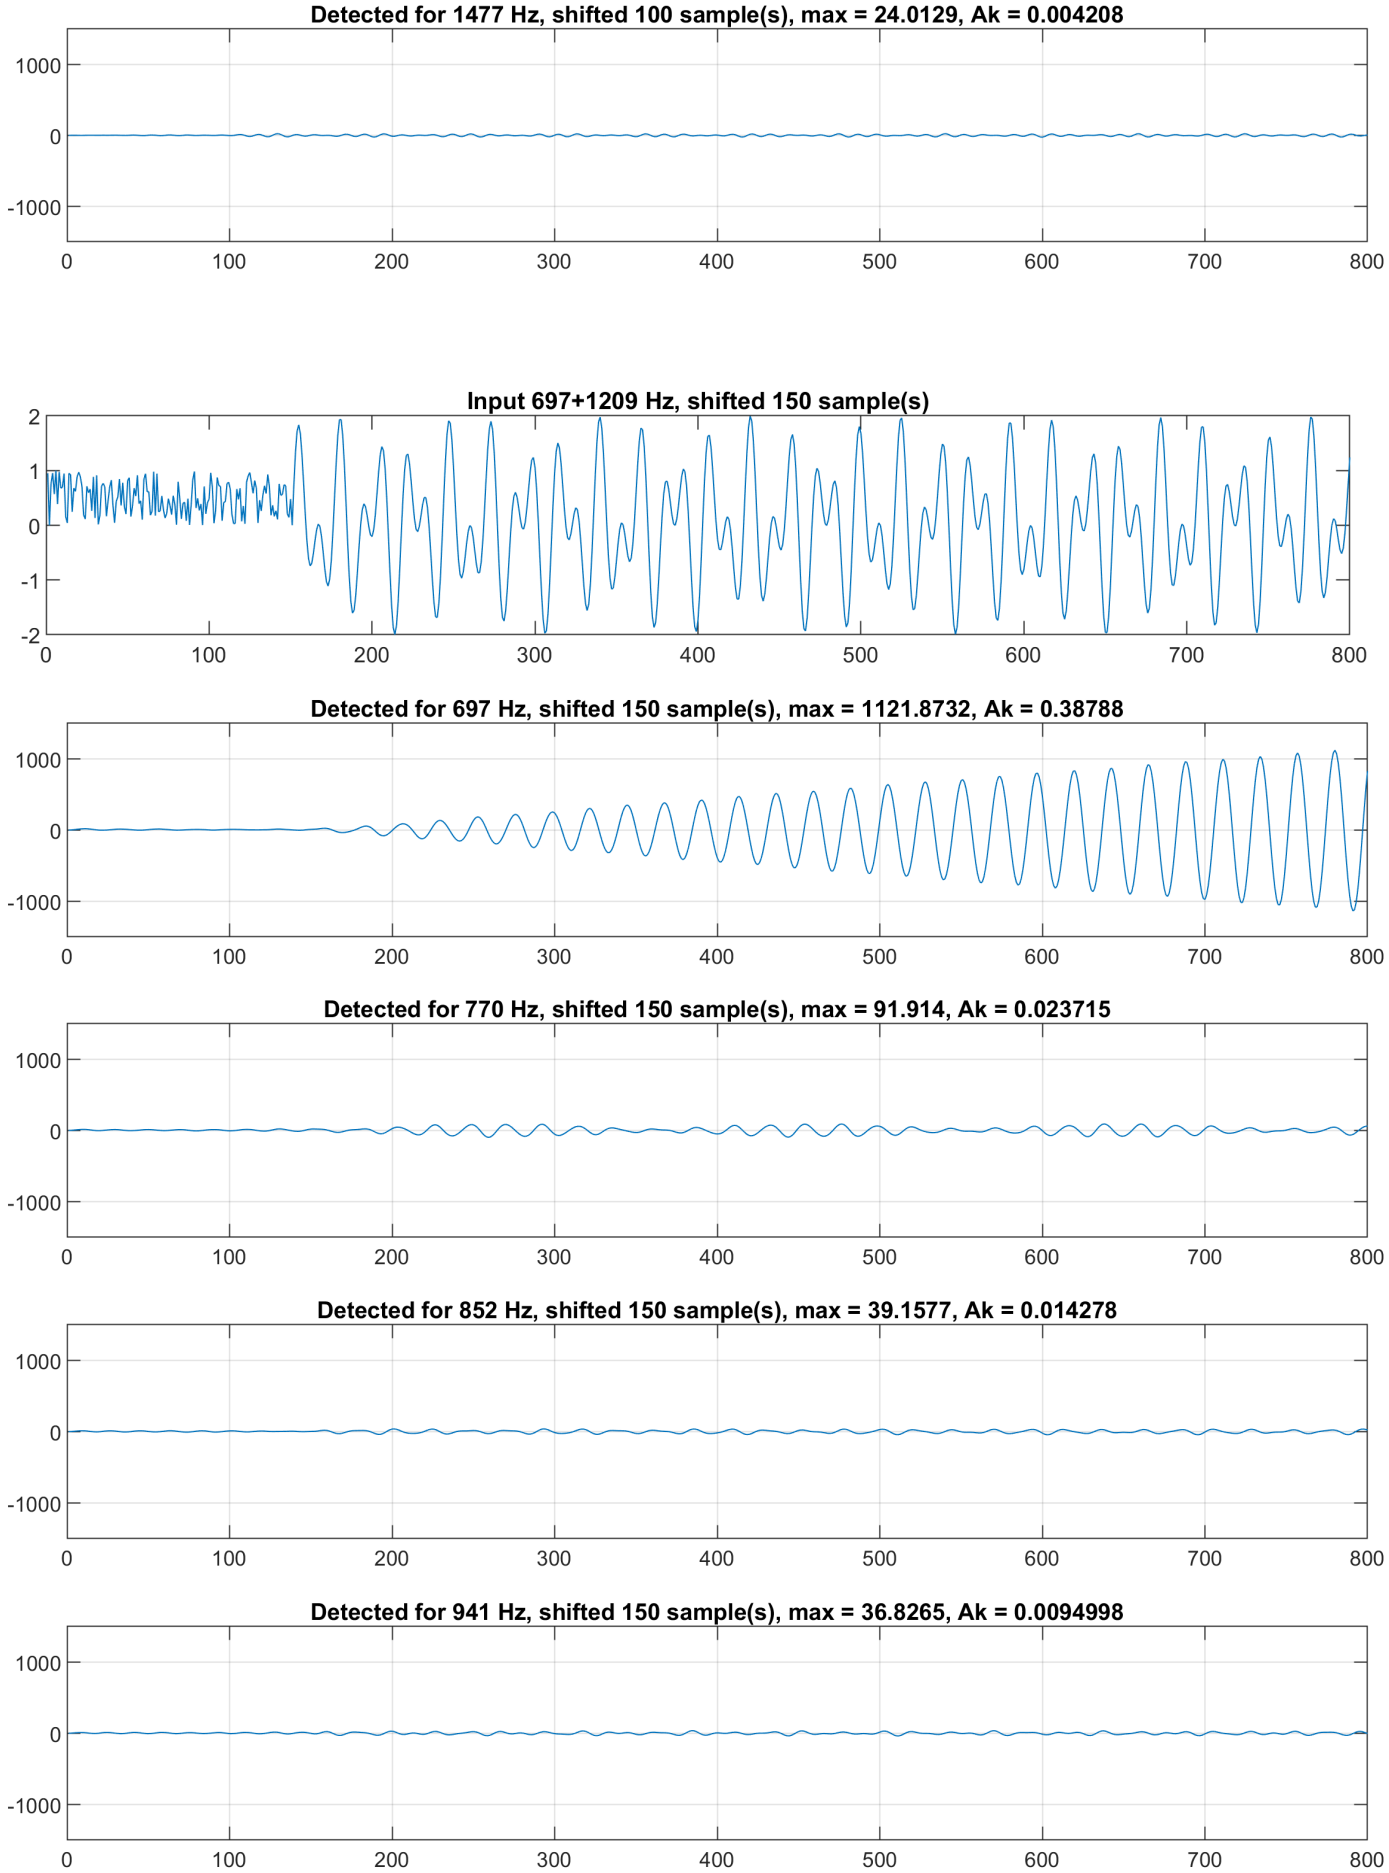
Detected for 1477 Hz, shifted 100 sample(s), max = 24.0129, Ak = 0.004208
Input 697+1209 Hz, shifted 150 sample(s)
Detected for 697 Hz, shifted 150 sample(s), max = 1121.8732, Ak = 0.38788
Detected for 770 Hz, shifted 150 sample(s), max = 91.914, Ak = 0.023715
Detected for 852 Hz, shifted 150 sample(s), max = 39.1577, Ak = 0.014278
Detected for 941 Hz, shifted 150 sample(s), max = 36.8265, Ak = 0.0094998

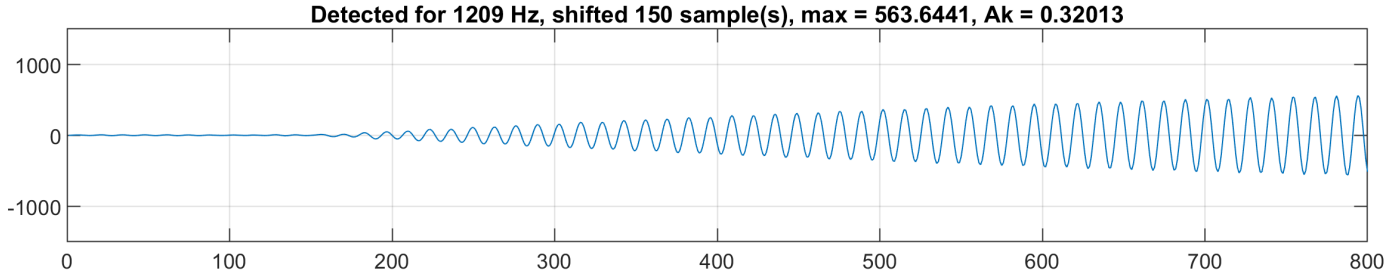
Detected for 1209 Hz, shifted 150 sample(s), max = 563.6441, Ak = 0.32013
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

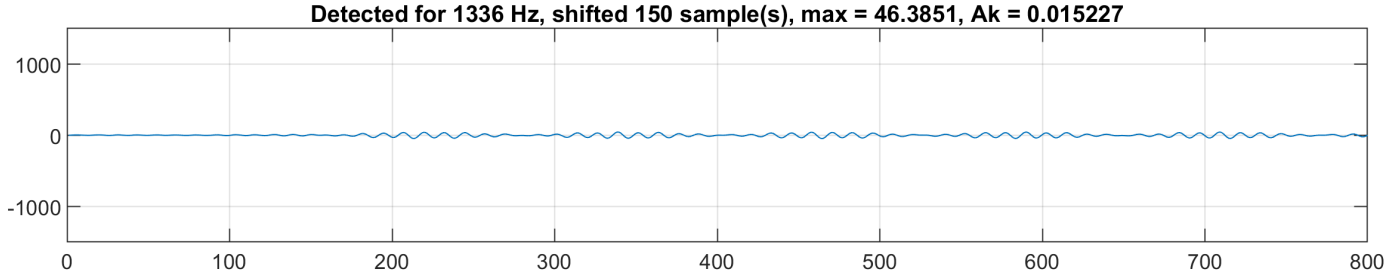
Detected for 1336 Hz, shifted 150 sample(s), max = 46.3851, Ak = 0.015227
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

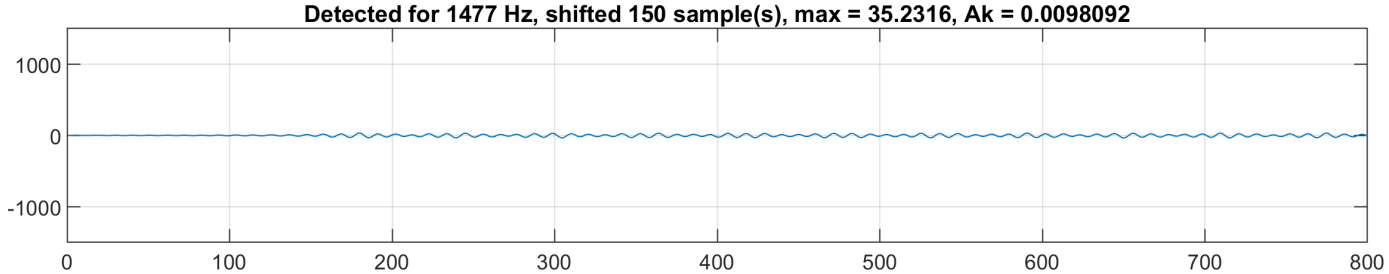
Detected for 1477 Hz, shifted 150 sample(s), max = 35.2316, Ak = 0.0098092
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

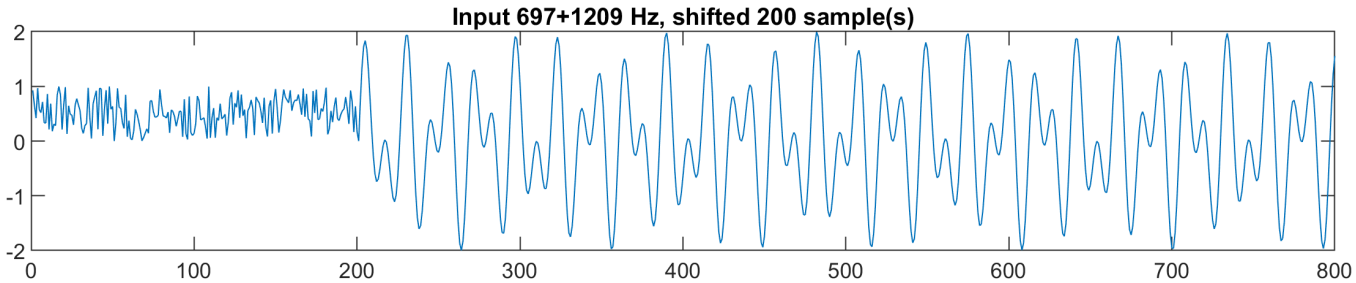
Input 697+1209 Hz, shifted 200 sample(s)
2
1
0
-1
-2
0
100
200
300
400
500
600
700
800

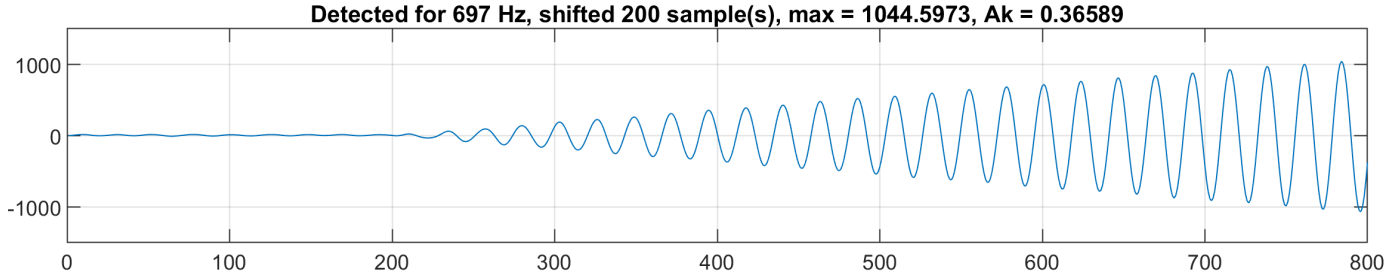
Detected for 697 Hz, shifted 200 sample(s), max = 1044.5973, Ak = 0.36589
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

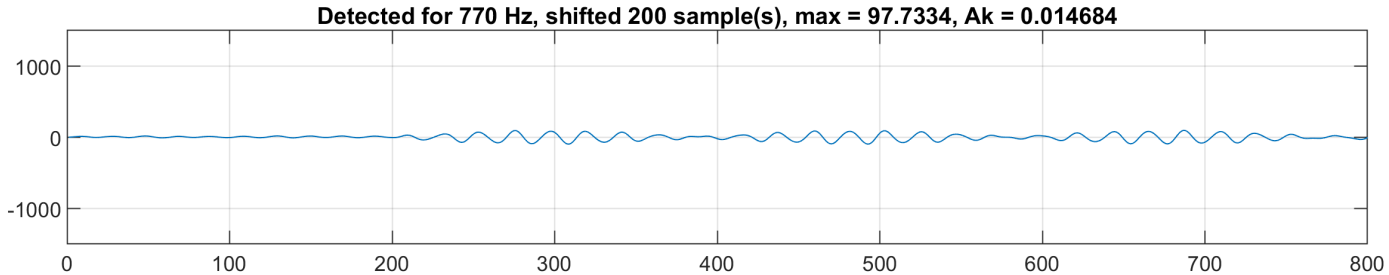
Detected for 770 Hz, shifted 200 sample(s), max = 97.7334, Ak = 0.014684
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

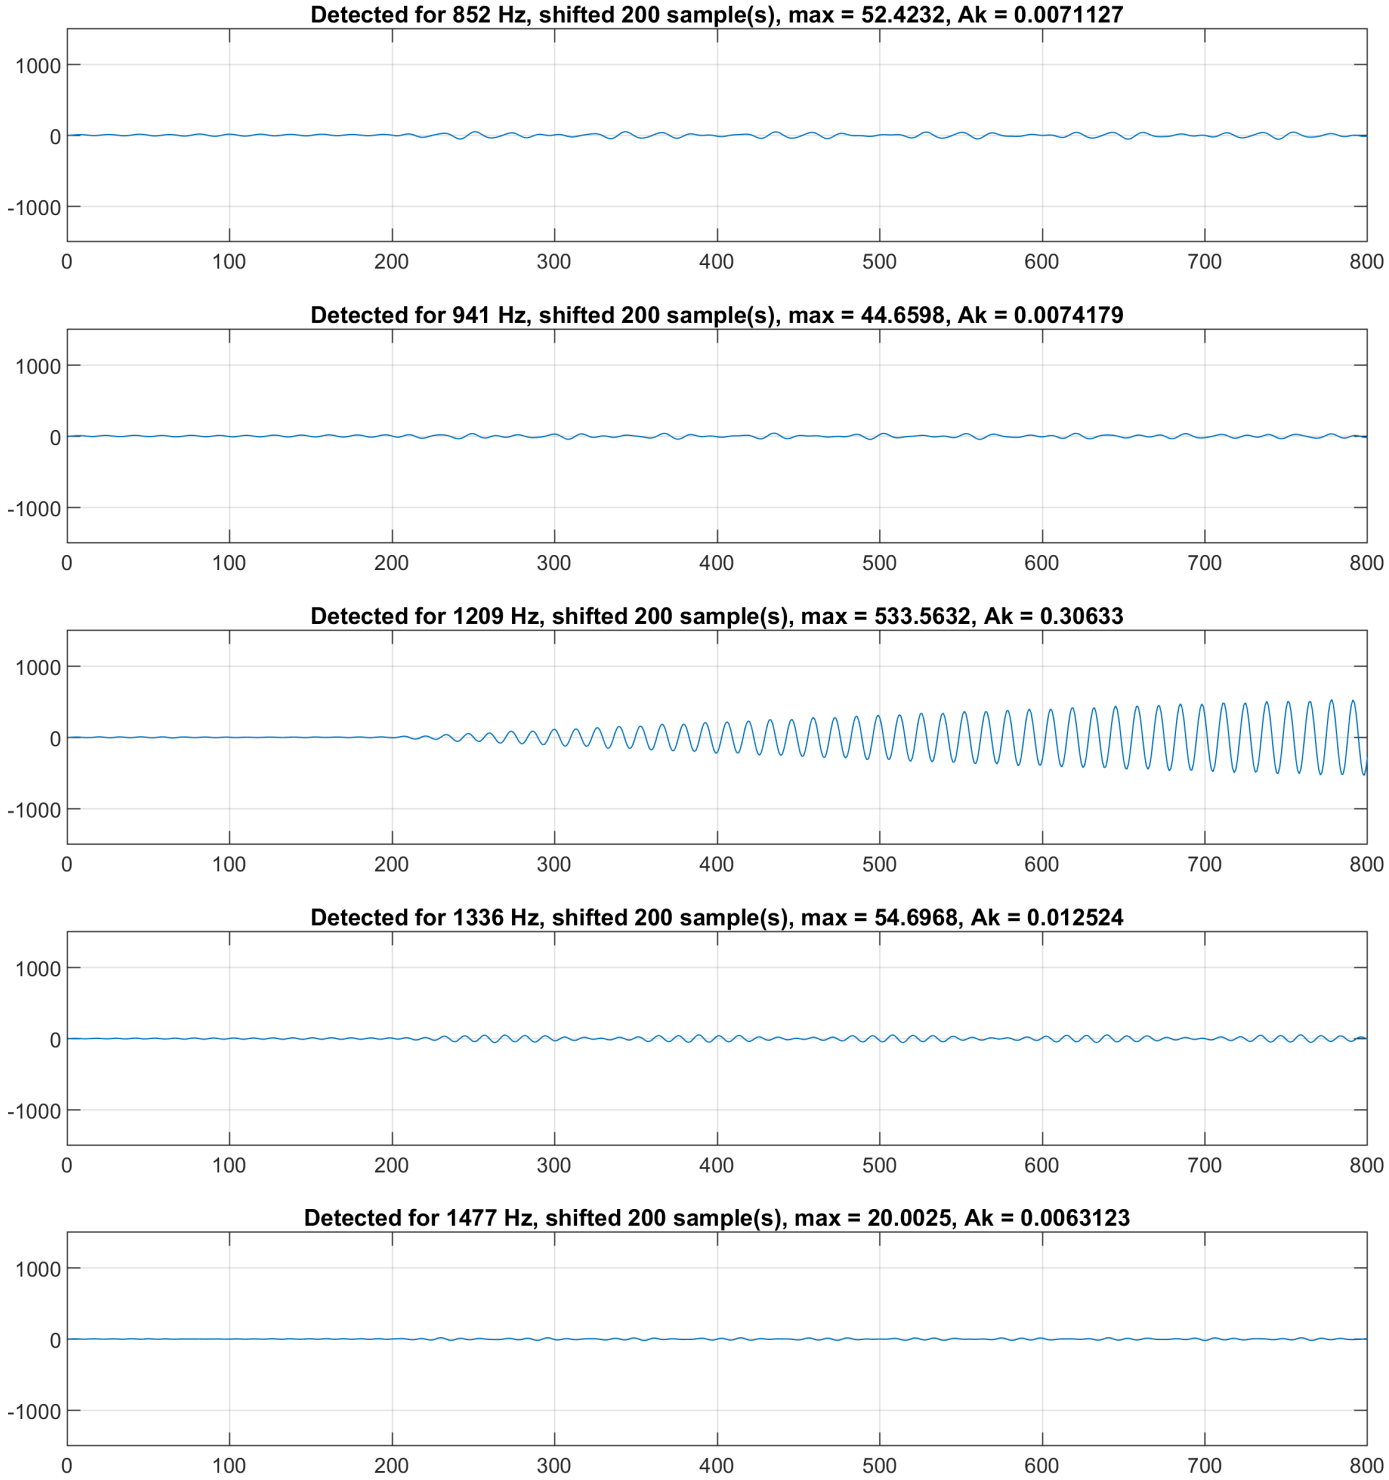
Detected for 852 Hz, shifted 200 sample(s), max = 52.4232, Ak = 0.0071127
Detected for 941 Hz, shifted 200 sample(s), max = 44.6598, Ak = 0.0074179
Detected for 1209 Hz, shifted 200 sample(s), max = 533.5632, Ak = 0.30633
Detected for 1336 Hz, shifted 200 sample(s), max = 54.6968, Ak = 0.012524
Detected for 1477 Hz, shifted 200 sample(s), max = 20.0025, Ak = 0.0063123
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800

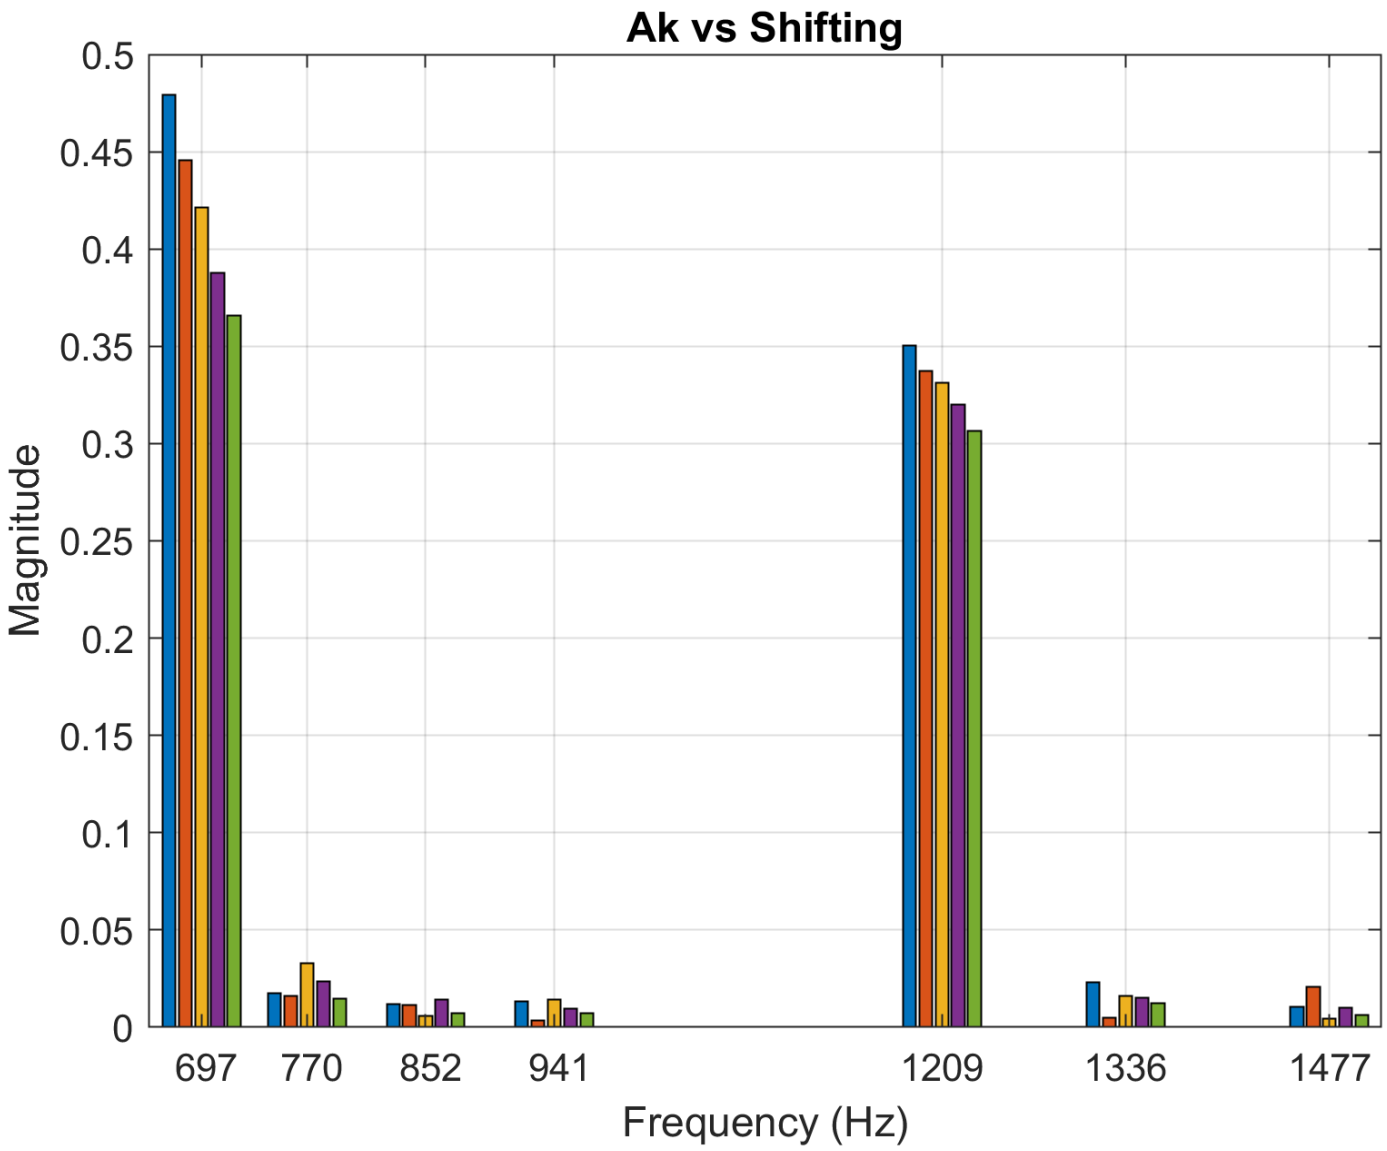
Ak vs Shifting
Magnitude
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
697
770
852
941
1209
1336
1477
Frequency (Hz)