## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимальную массу пользователя.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.

## 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием необходимо провести санитарную обработку изделия влажной тканью с использованием моющих средств.
В дальнейшем также необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Стульчак, и санитарное ведро дезинфицировать хлором и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.
Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.

| | |
|---|---|
| Модель | Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Производитель | ООО «Ортоника» |
| Адрес места производства | 394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8 |
| Юридический адрес | 396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8 |
| Регистрационный номер медицинского изделия | РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064) |
| Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет | ООО «Реамед» |
| Адрес | 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11 |
| E-mail | service@ortonica.ru |
| Телефон | 8 (800) 707-44-52 |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|---|---|
| Наименование, марка, модель изделия | Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1 |
| Срок гарантии | 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем |
| С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. | _____подпись покупателя |

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

**ORTONICA** ПО ТУ 9452-002-66445146-2016 **TU 1**



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1 (далее «стул», «изделие») – это базовый санитарный стул с надежной стальной рамой и санитарным оснащением из прочного гигиеничного пластика.
Предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали с полимерным покрытием. Ножки с противоскользящими накладками позволяют установить необходимую высоту сиденья в зависимости от роста пользователя. Подлокотники обеспечивают опору во время использования, а мягкие вставки на подлокотниках - комфорт. Конструкция стула позволяет использовать его совместно со стационарным унитазом. Для этого необходимо снять санитарное ведро и отрегулировать ножки по высоте в зависимости от высоты унитаза.


## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Общая длина, см | 52,5-54,5 |
| Общая ширина, см | 81,5-85 |
| Общая высота, см | 67-82 |
| Глубина сиденья, см | 47,5 |
| Высота сиденья, см | 41-56 |
| Количество регулировок высоты | 7 |
| Расстояние между поручнями, см | 61 |
| Максимальная масса пользователя, кг | 150 |
| Общая масса (+/-5%), кг | 6,1 |

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1 поставляется в картонной коробке в разобранном виде.


| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1 | 1 |
| 2 | Набор инструментов | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |




Санитарное ведро с крышкой - 1 шт




Стульчак - 1 шт
Крышка стульчака - 1 шт




Труба рамы передняя - 1 шт




Труба рамы задняя - 1 шт




Распорка - 2 шт




Крепление санитарного ведра-2 шт




Подлокотник с ножками – 2 шт




Спинка стула - 1 шт




Гайка М6 - 6 шт



Винт М6х35 - 6 шт



Ключ гаечный М10 – 2 шт




Колпачок на гайку – 6 шт

## 5. СХЕМА СБОРКИ

Для сборки воспользуйтесь инструментом, входящим в комплект. При необходимости допускается использование собственного инструмента.

Рис. 1

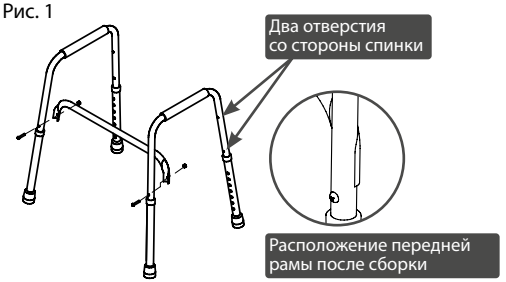



Соберите основание стула. Подлокотники необходимо разместить так, чтобы с передней стороны оказалось одно отверстие, а со стороны спинки – два (рис. 1).

Установите переднюю трубу рамы (она имеет 2 отверстия на цилиндрической части), как показано на рис. 1 с помощью крепежа из комплекта.

Затяните трубу рамы.


Рис. 2



Установите заднюю трубу рамы (имеет 3 отверстия на цилиндрической поверхности) согласно рис. 2.


Трубу рамы не затягивать.

Рис. 3

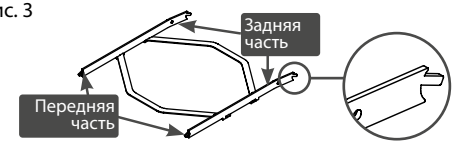


Соберите предварительно основание для приемника-резервуара, так, чтобы одинаковые концы распорок находились с одной стороны. Крепление приемника-резервуара установите в пазы распорок согласно рис. 3.

Рис. 4




Установите предварительно собранное основание приемника-резервуара передней частью, держа его как показано на рис. 4, в отверстия передней трубы рамы.

Затем прижмите заднюю трубу рамы так, чтобы направляющие выступы распорок попали в отверстия трубы рамы.


Затяните крепеж задней трубы рамы.

Рис. 5



Установите спинку, прикрутив её винтами к подлокотникам согласно рис. 5.


Рис. 6



Затяните все гайки.

Установите колпачки на гайки (рис. 6).

Рис. 7

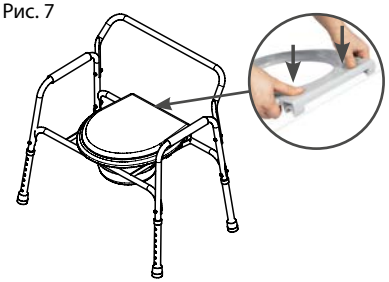

Установите и зафиксируйте стульчак, а затем крышку стульчака, нажав с обеих сторон на места фиксации (рис. 7).

При необходимости отрегулируйте ножки стула по высоте с помощью кнопочного фиксатора. Для этого нажмите на кнопочный фиксатор и переместите ножку в требуемое положение, затем зафиксируйте кнопку в отверстии до щелчка, в одном из 7 положений.

Перемещение ножки стула относительно фиксатора осуществляйте строго по линии отверстий. Проверьте, чтобы все ножки были зафиксированы на одной высоте.

Приподнимите стульчак с крышкой и поместите приемник-резервуар на крепления. Опустите стульчак с крышкой. Стул готов к эксплуатации.