8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Модель	Средство для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.» («Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко., Лтд.») 297, ул Чуцяо, 212009 Чженьцзян, провинция Цзянсу, КНР (No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People's Republic of China)
Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)	ООО «Ортоника»
Регистрационный номер медицинского изделия	ФСЗ 2012/13491 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932313)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование, марка, модель изделия	Средство для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

СРЕДСТВО ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА ИНВАЛИДАМИ:
КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ (БЕЗ КОЛЕС)

ORTONICA TU 3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Средство для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3 (далее «стул») предназначено для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул изготовлен из прочной стали, имеет высококачественное, антикоррозийное покрытие. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали, имеет полимерное покрытие. На ножки установлены резиновые опоры. Подлокотные опоры откидные, на них установлены мягкие вставки. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек стула. Для установки сиденья и крышки стула, необходимо надавить одновременно с двух сторон на пластиковые детали в местах крепления. (Рис. 1) Пластмассовое санитарное ведро с крышкой сиденья съемное. Сиденье, крышка сиденья и санитарное ведро с крышкой изготовлены из ударопрочного пластика .

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная длина, см	50-60
Габаритная ширина, см	55,5
Габаритная высота, см	62,5-72,5
Ширина между подлокотниками, см	47,5
Количество регулировок высоты	5
Грузоподъемность, кг	85
Вес, кг (± 5%)	7,15

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3 поставляется в картонной коробке.

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3	1
2	Крышка стульчака	1
3	Стульчак	1
4	Ведро с крышкой	1
5	Паспорт изделия	1

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.
- Не допускайте нагрева изделия температурой выше 50°С.

6. СХЕМА СБОРКИ

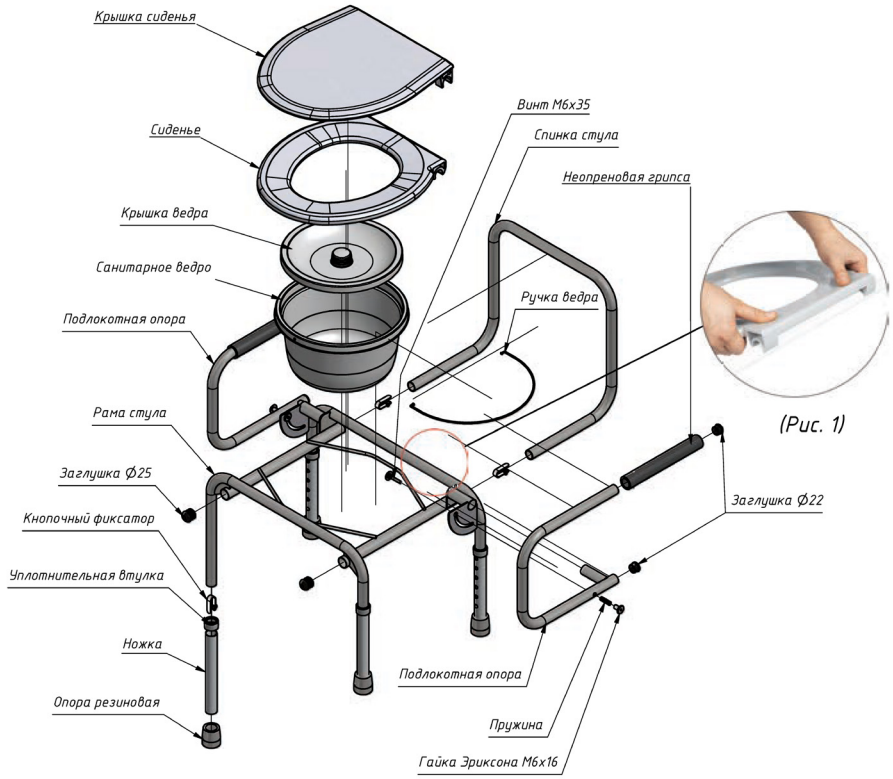

(Рис. 1)

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать на сухо.

Стульчак и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.

Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.