
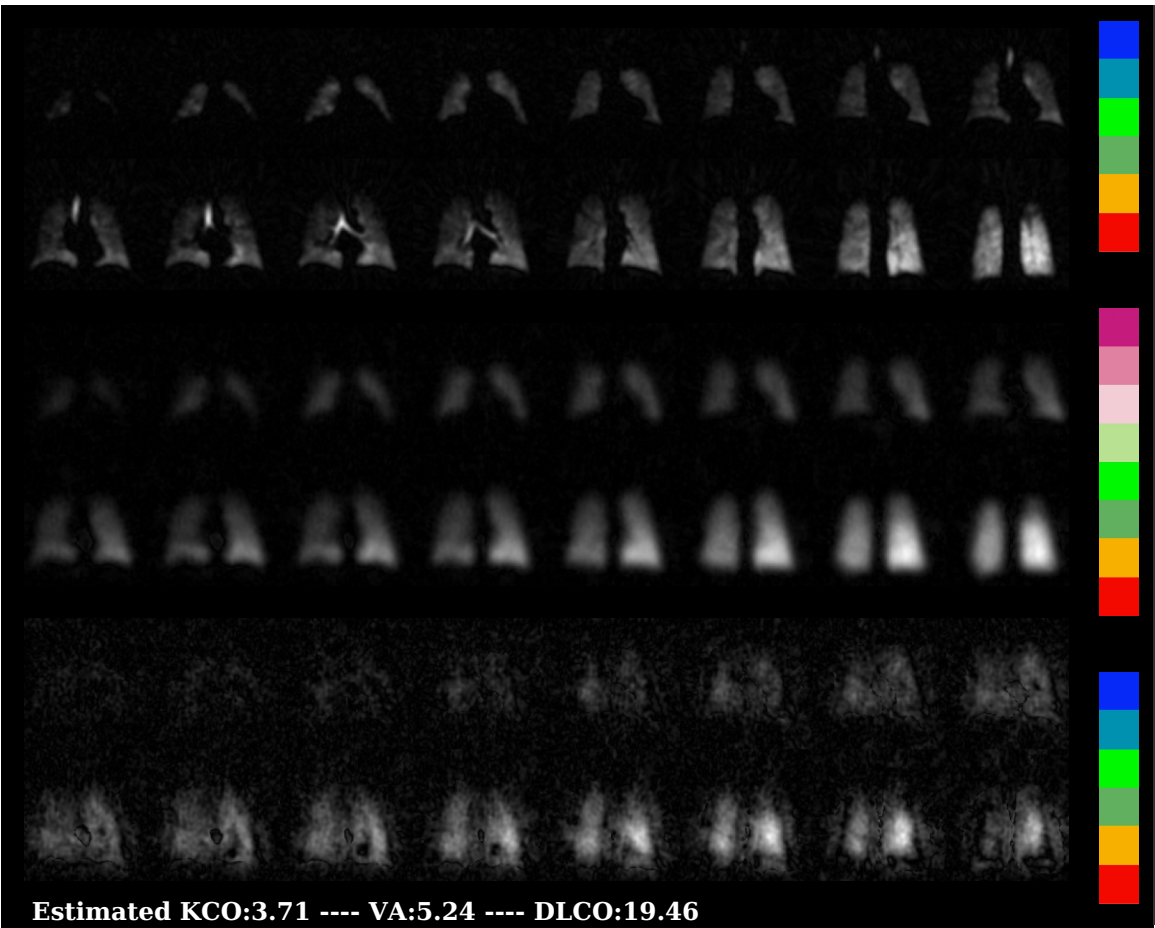


Summary of test

scan: 2023-01-03; processed: 2023-05-07

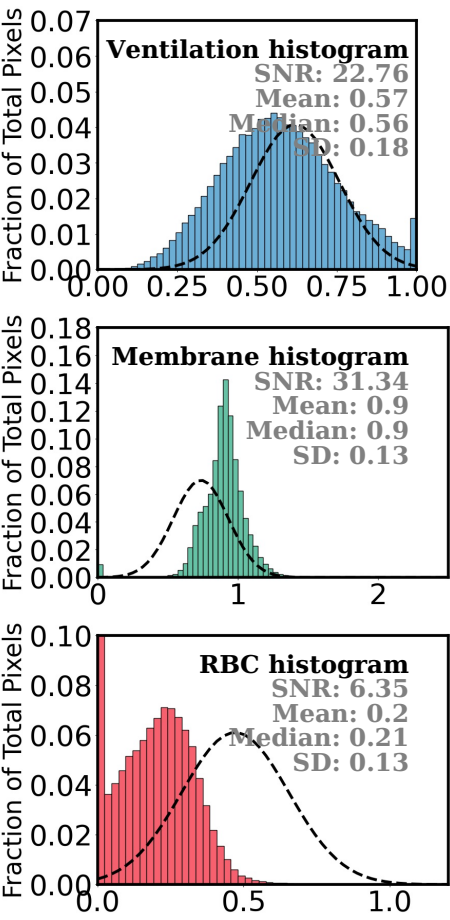

Subject	test	Ref
RBC:M.	0.202	0.57±0.07
Inflation	3.7L	3.4±0.33
Defect	0.94%	5±3%
Low	19.9%	16±8%
High	10.95%	15±5%
Defect	0.0%	1±<1%
Low	0.08%	8±2%
High	0.59%	1±1%
Defect	17.32%	4±2%
Low	45.12%	14±6%
High	0.1%	15±10%