
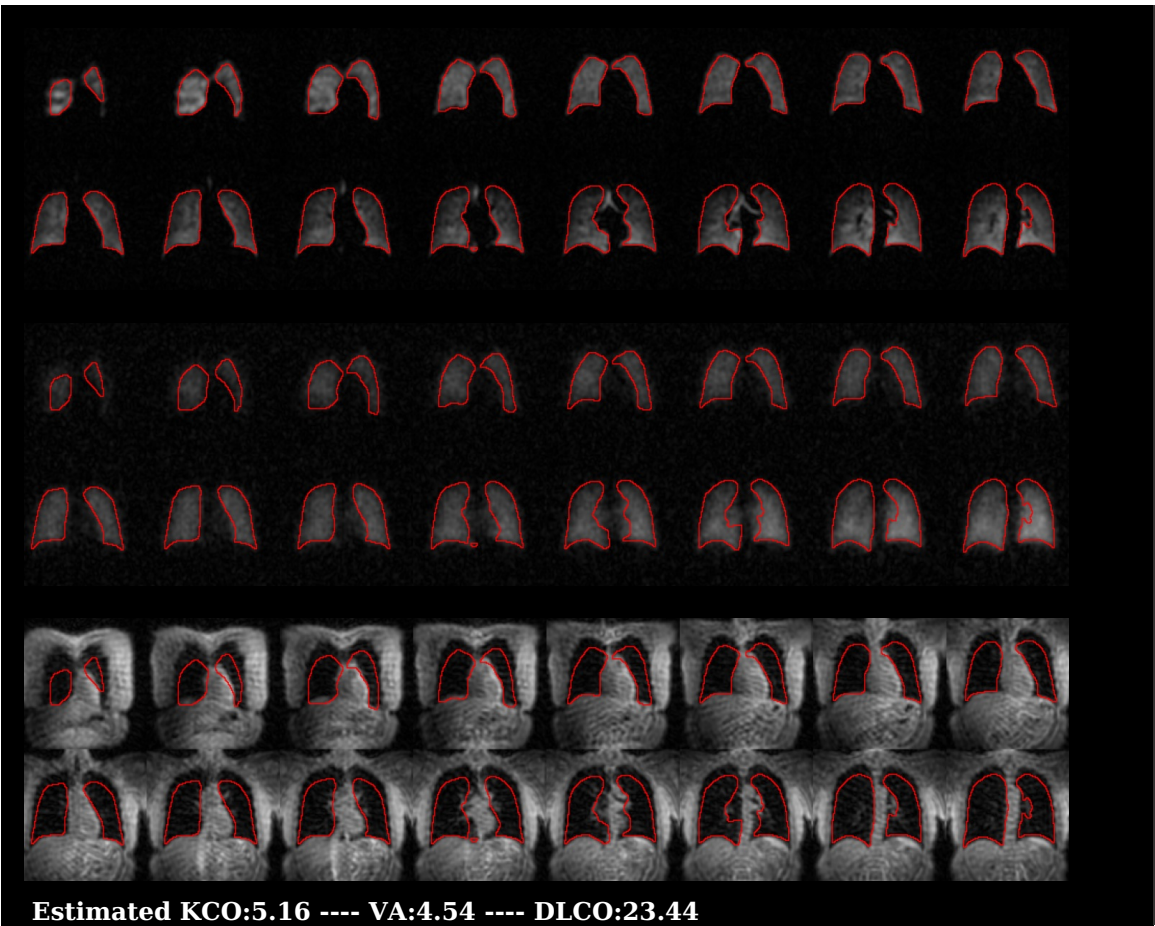


Summary of test

scan: 2022-08-16; processed: 2023-05-07

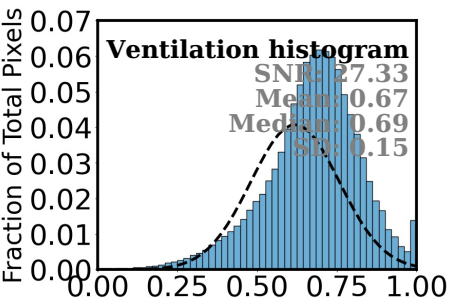

Subject	test	Ref
RBC:M.	0.427	X ±Y
Inflation	3.19L	X ±Y
Defect	0.33%	x±y%
Low	5.59%	x±y%
High	16.95%	x±y%
Defect	0.06%	x±y%
Low	12.28%	x±y%
High	0.14%	x±y%
Defect	6.45%	x±y%
Low	30.98%	x±y%
High	3.08%	x±y%