
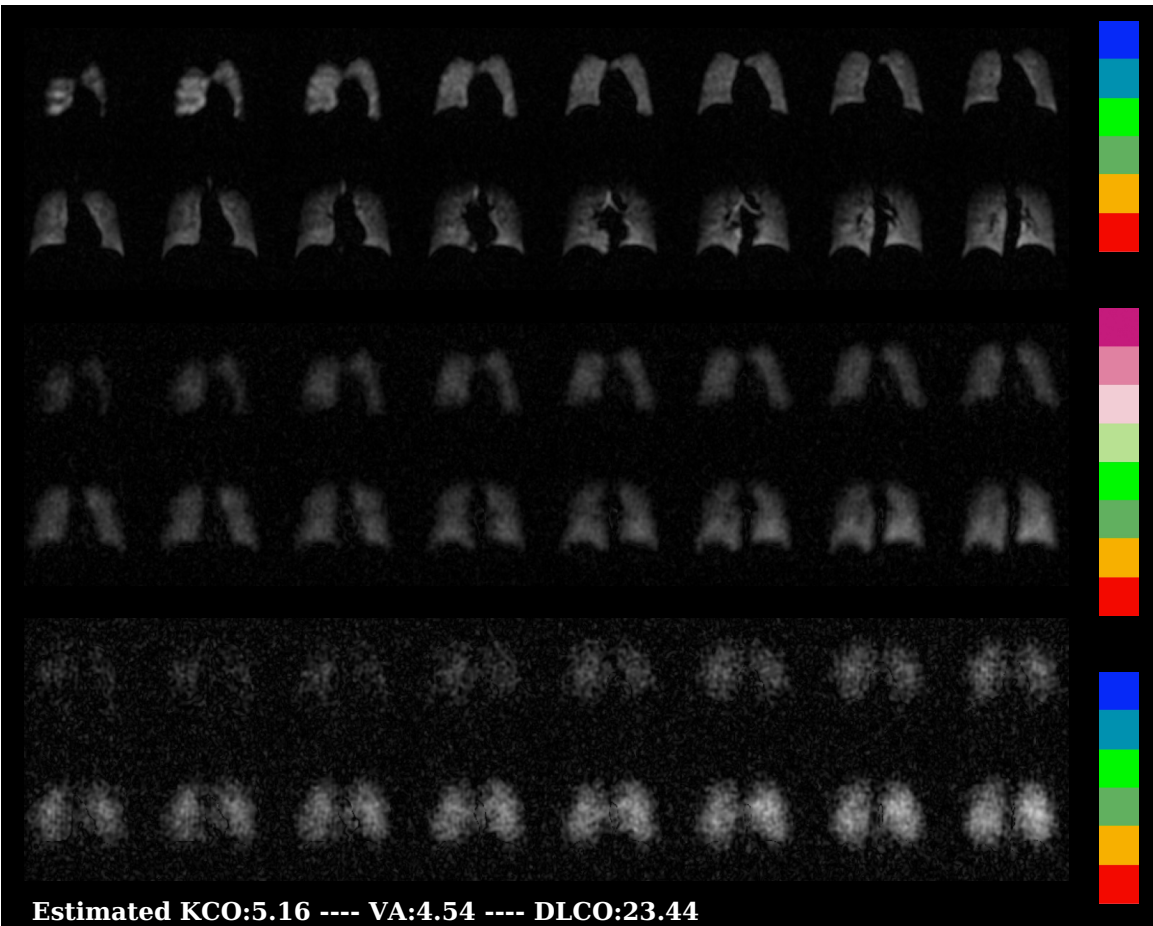
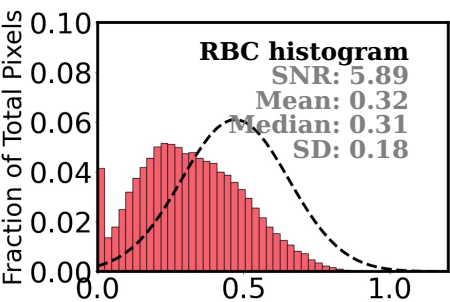
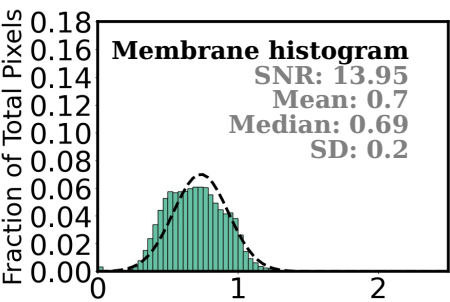


Summary of test

scan: 2022-08-16; processed: 2023-05-07

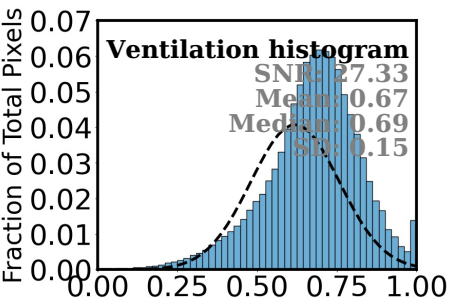

Subject	test	Ref
RBC:M.	0.427	0.57±0.07
Inflation	3.19L	3.4±0.33
Defect	0.33%	5±3%
Low	5.59%	16±8%
High	16.95%	15±5%
Defect	0.06%	1±<1%
Low	12.28%	8±2%
High	0.14%	1±1%
Defect	6.45%	4±2%
Low	30.98%	14±6%
High	3.08%	15±10%