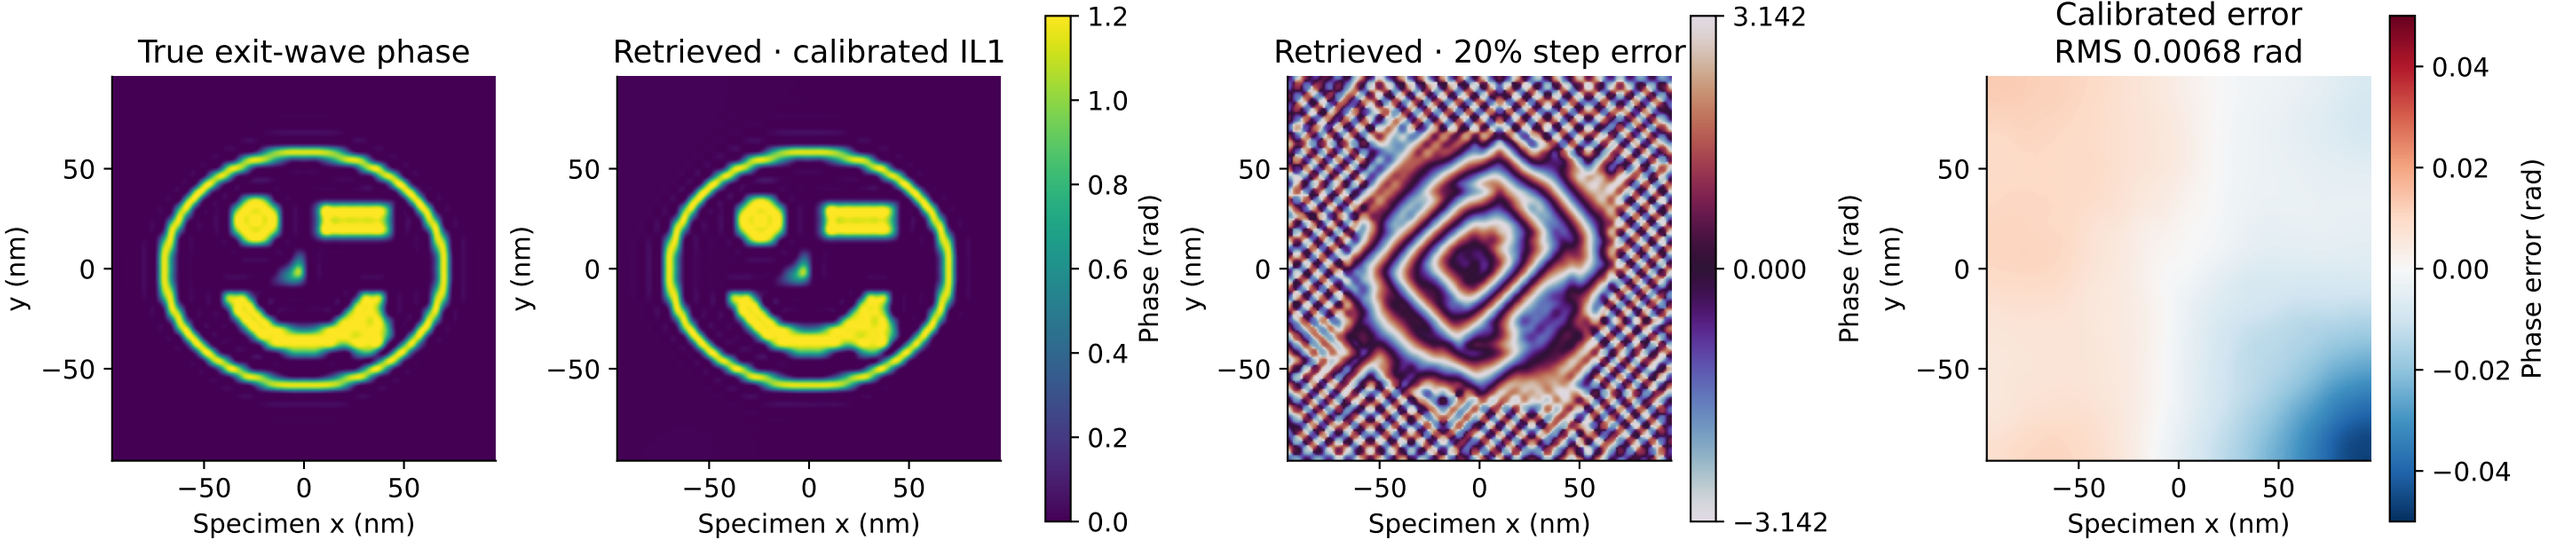

True exit-wave phase
Retrieved · calibrated IL1
Retrieved · 20% step error
Calibrated error
RMS 0.0068 rad
y (nm)
Specimen x (nm)
Phase (rad)
Phase error (rad)
50
0
−50
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
3.142
0.000
−3.142
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04