


Bulk(1)= NA(0.5)CA(2.821)K(0.02)FE(5.879)MG(50.51)AL(3.548)SI(38.451)TI(0.1)CR(0.218)O(?)O(0.096)



KLB-1 H-free tc-ig50 ex  
domino version: 2022.12.14  
database: td-ds633-ig50-03test.txt  
LIQH18: external+margules  
FSP4TR: site mixing+margules  
OL: site mixing+margules  
GRT: site mixing+margules  
CRD: site mixing+margules  
OPX: site mixing+margules  
CPX: site mixing+margules  
SPN: site mixing+margules  
ILM00: site mixing+margules

TEST= 0.1000E-008  
LO1MAX= 350  
GCMAX= 60  
DELXSTAR= 0.1000E-002  
STEPSTAR= 200  
STEPMAX= 40  
DELXMIN= 0.1000E-011  
ZEROEM= 0.2220E-023  
PMINAAA= 0.2225E-306  
PMINXXX= 0.2442E-023  
PMINXELSI=0.0000E+000

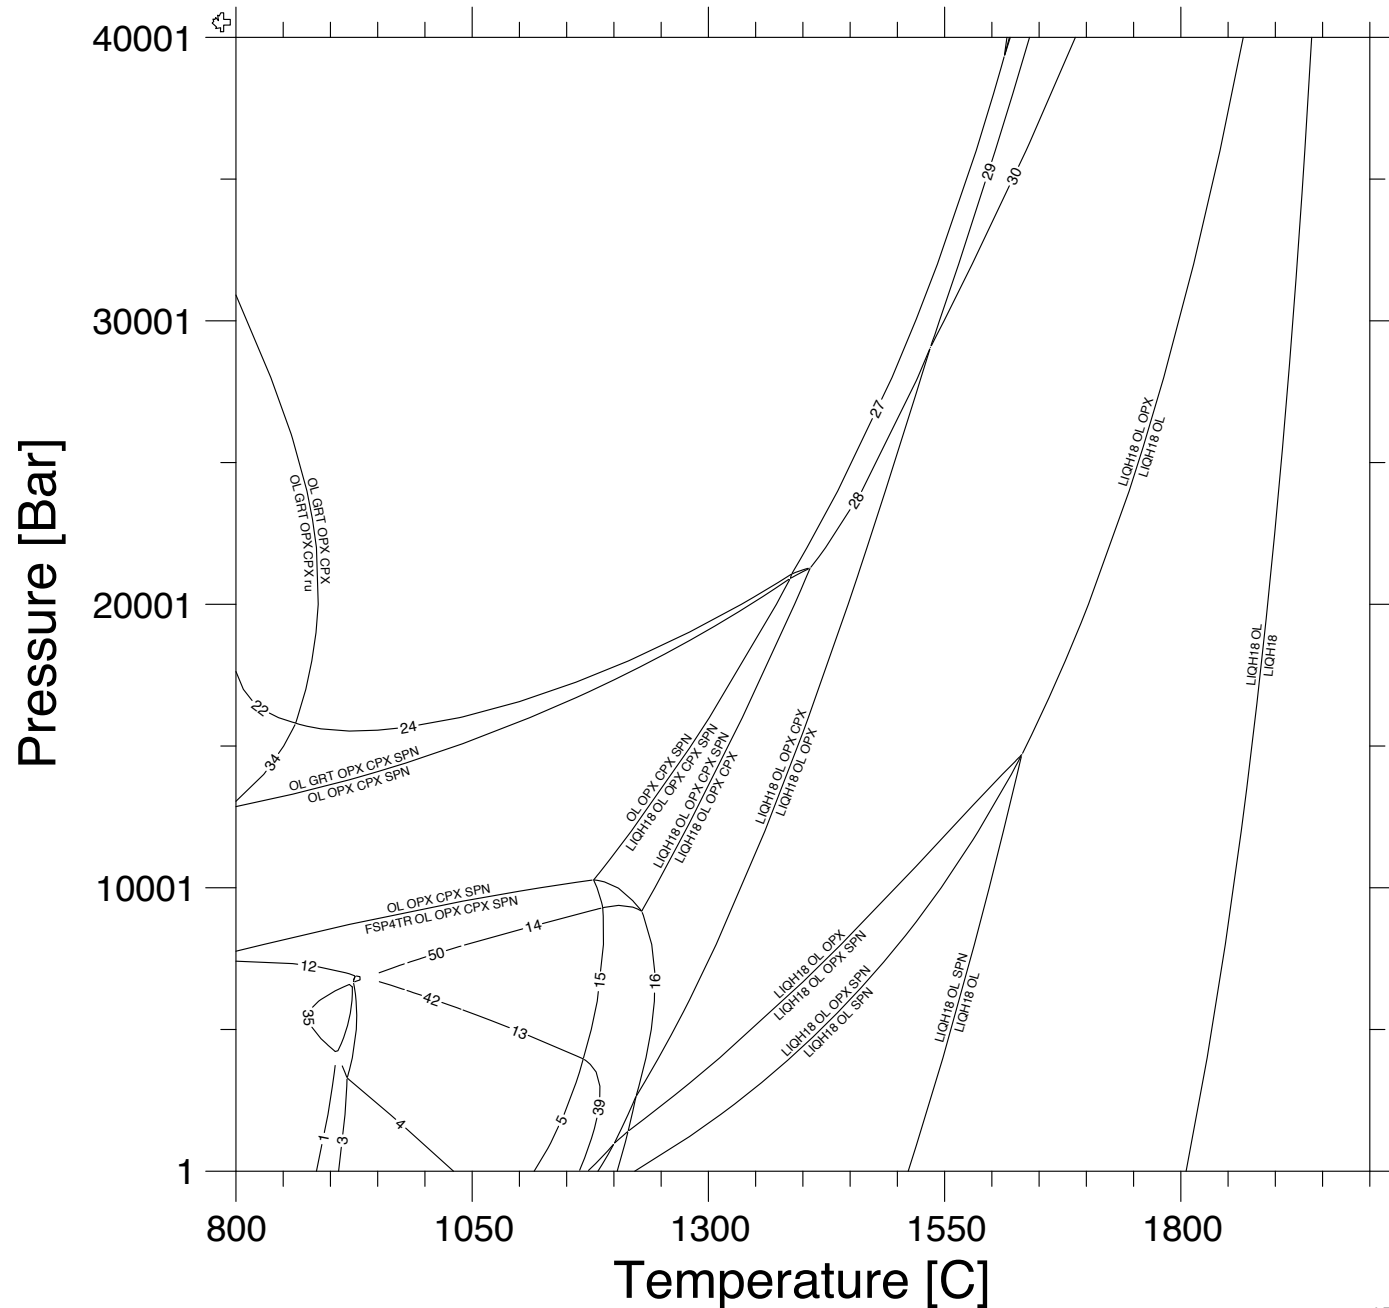