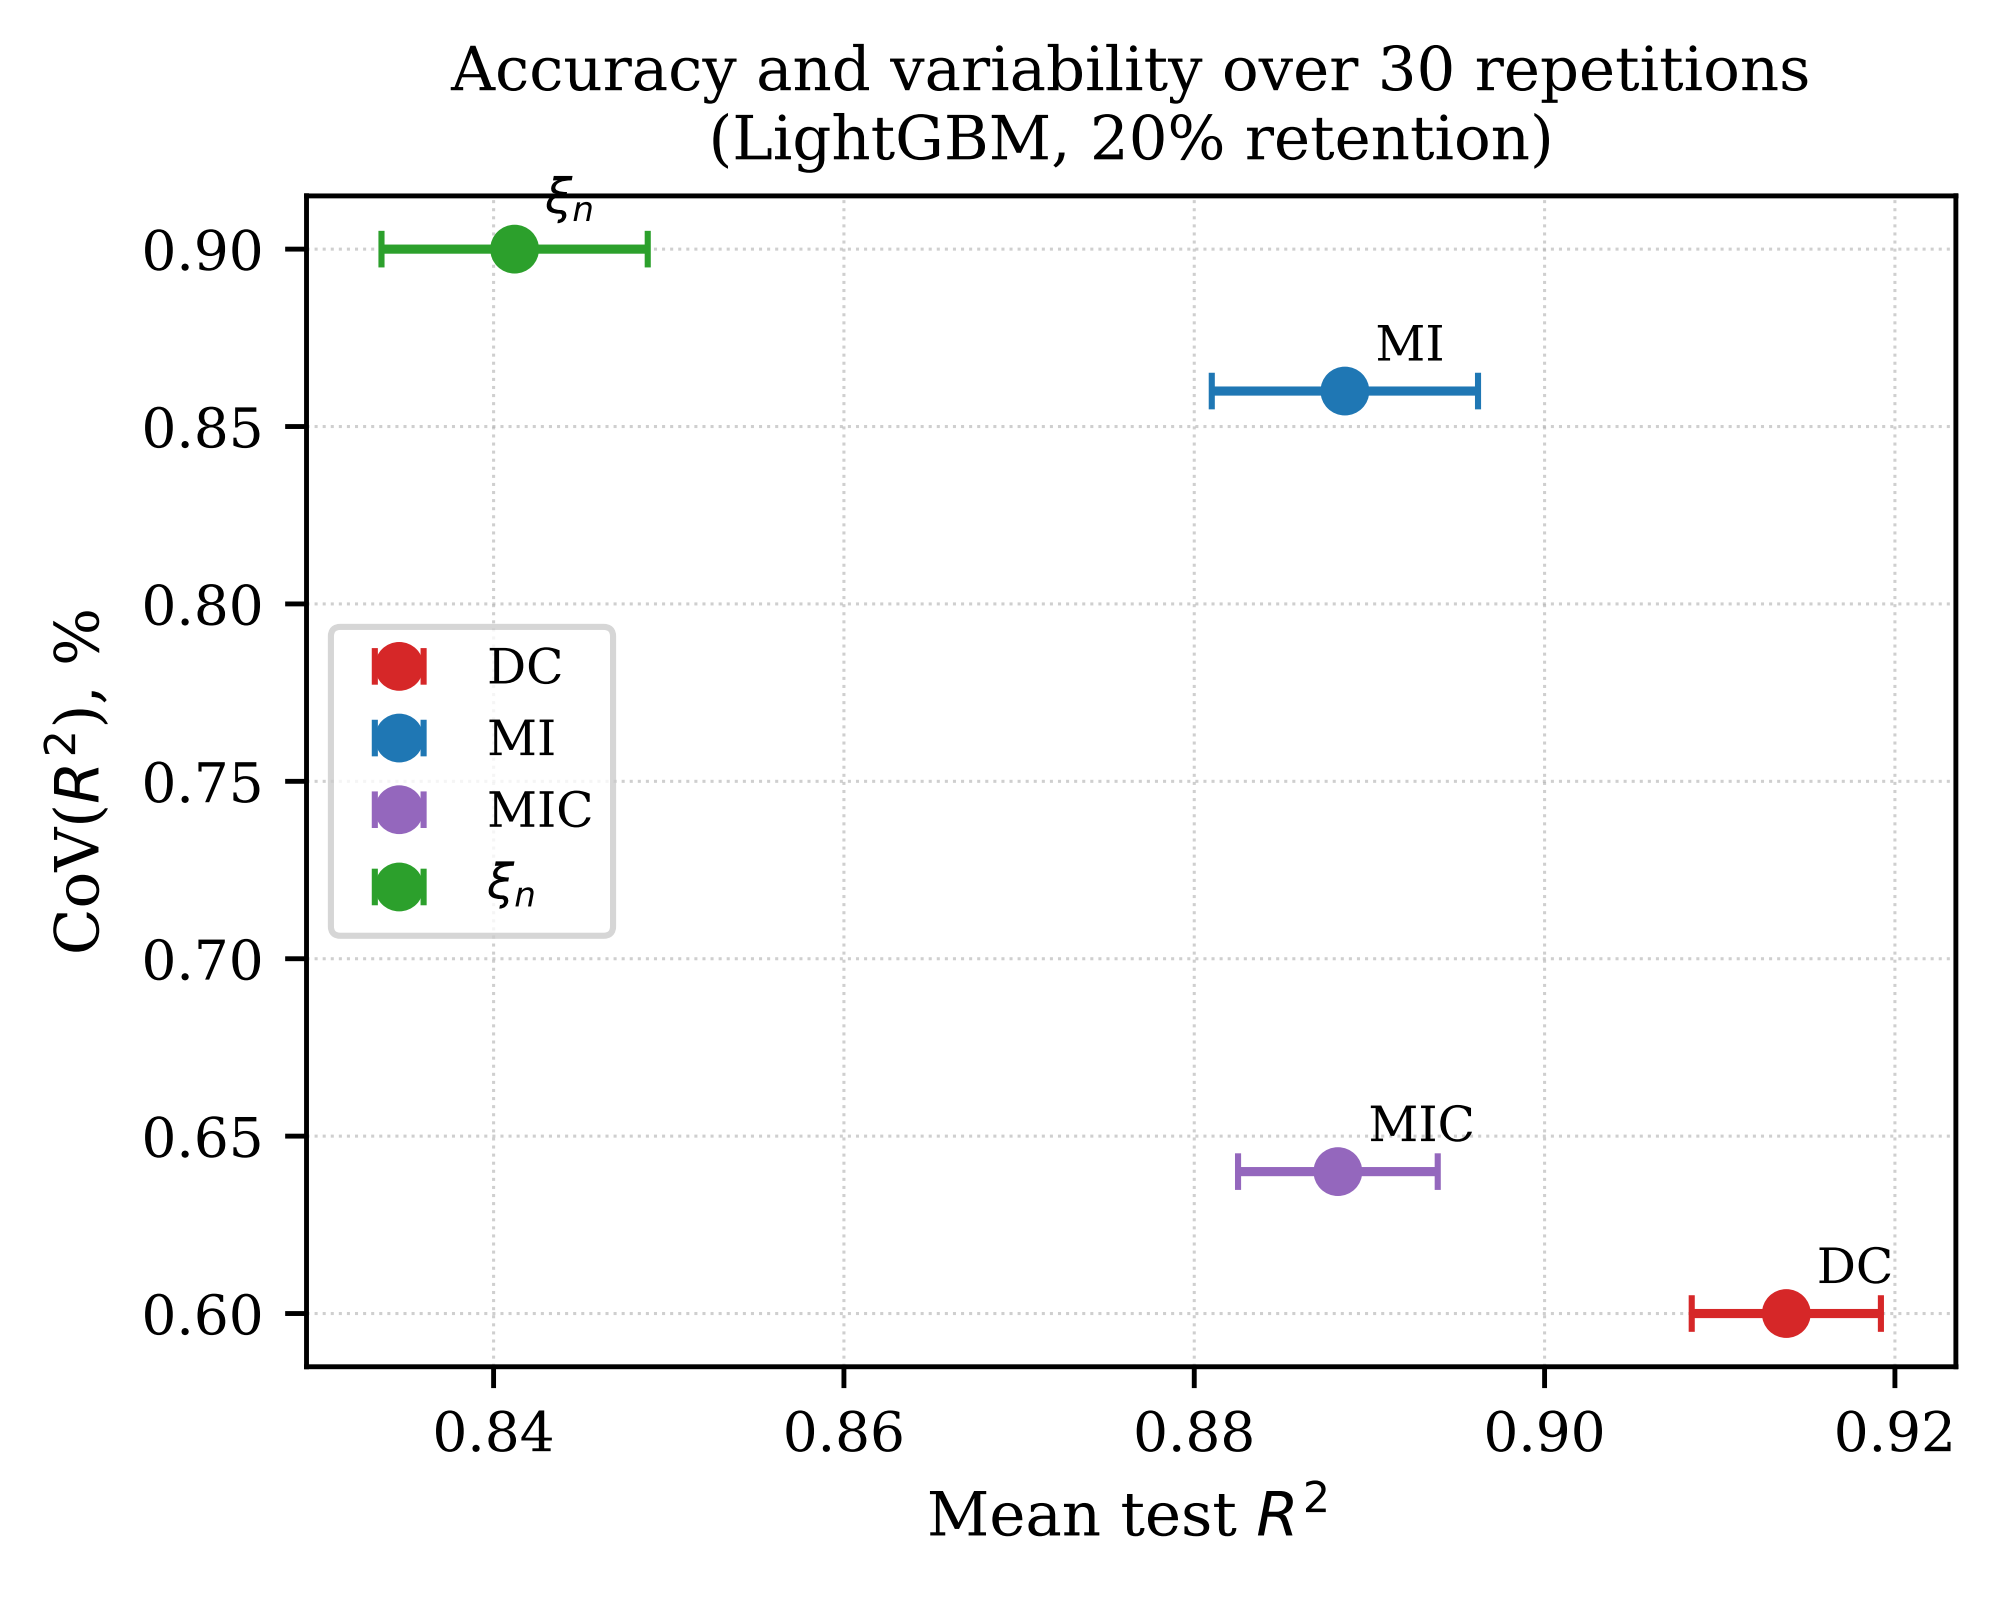
Accuracy and variability over 30 repetitions
(LightGBM, 20% retention)
ξ_n
MI
MIC
DC
DC
MI
MIC
ξ_n
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
CoV(R^2), %
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
Mean test R^2