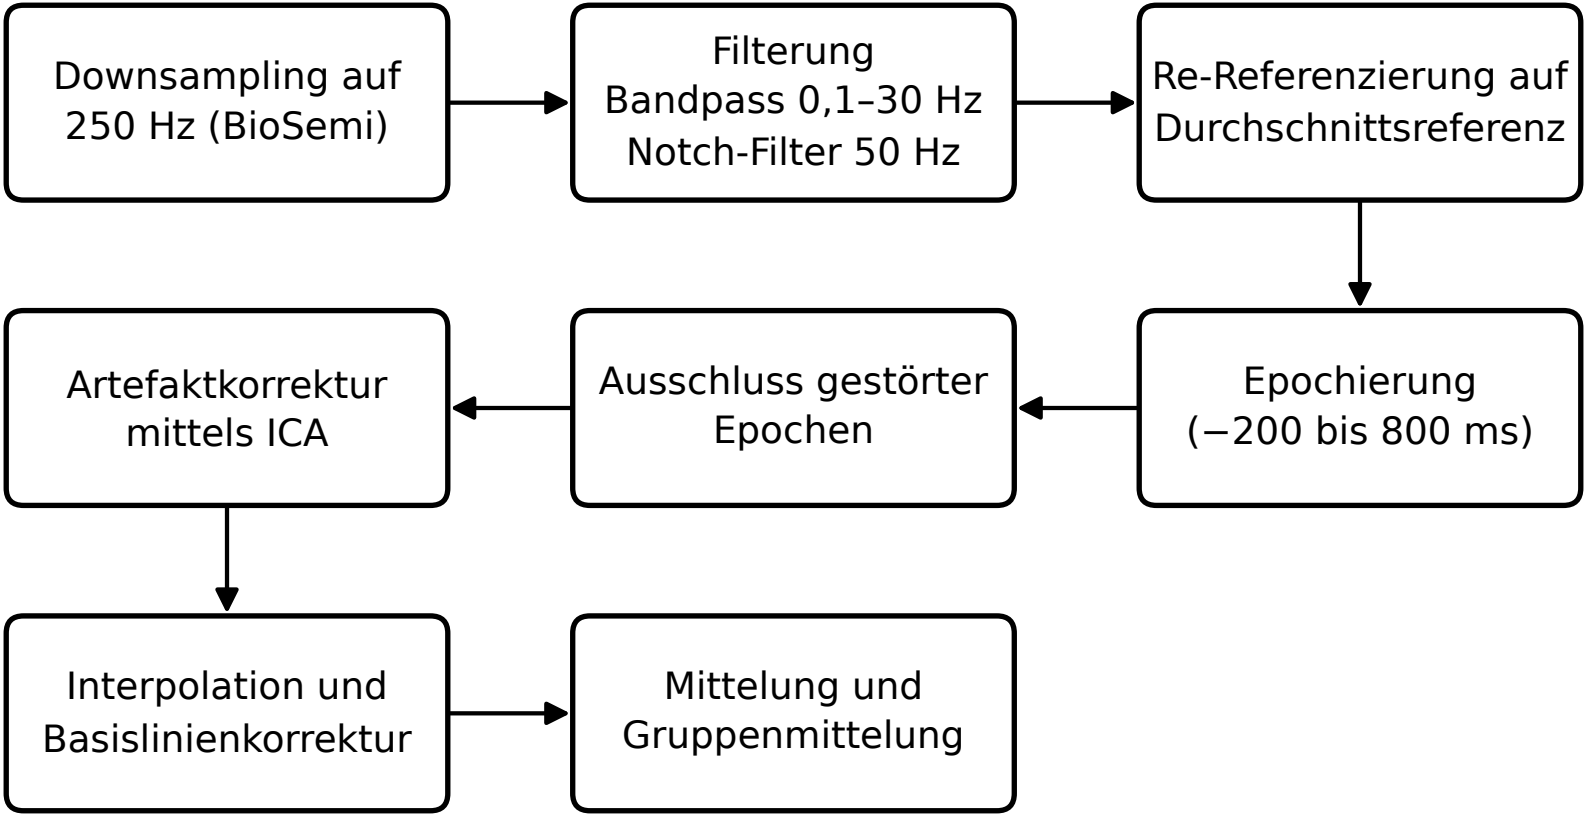
Downsampling auf 250 Hz (BioSemi)
Filterung Bandpass 0,1–30 Hz Notch-Filter 50 Hz
Re-Referenzierung auf Durchschnittsreferenz
Epochierung (−200 bis 800 ms)
Ausschluss gestörter Epochen
Artefaktkorrektur mittels ICA
Interpolation und Basislinienkorrektur
Mittelung und Gruppenmittelung