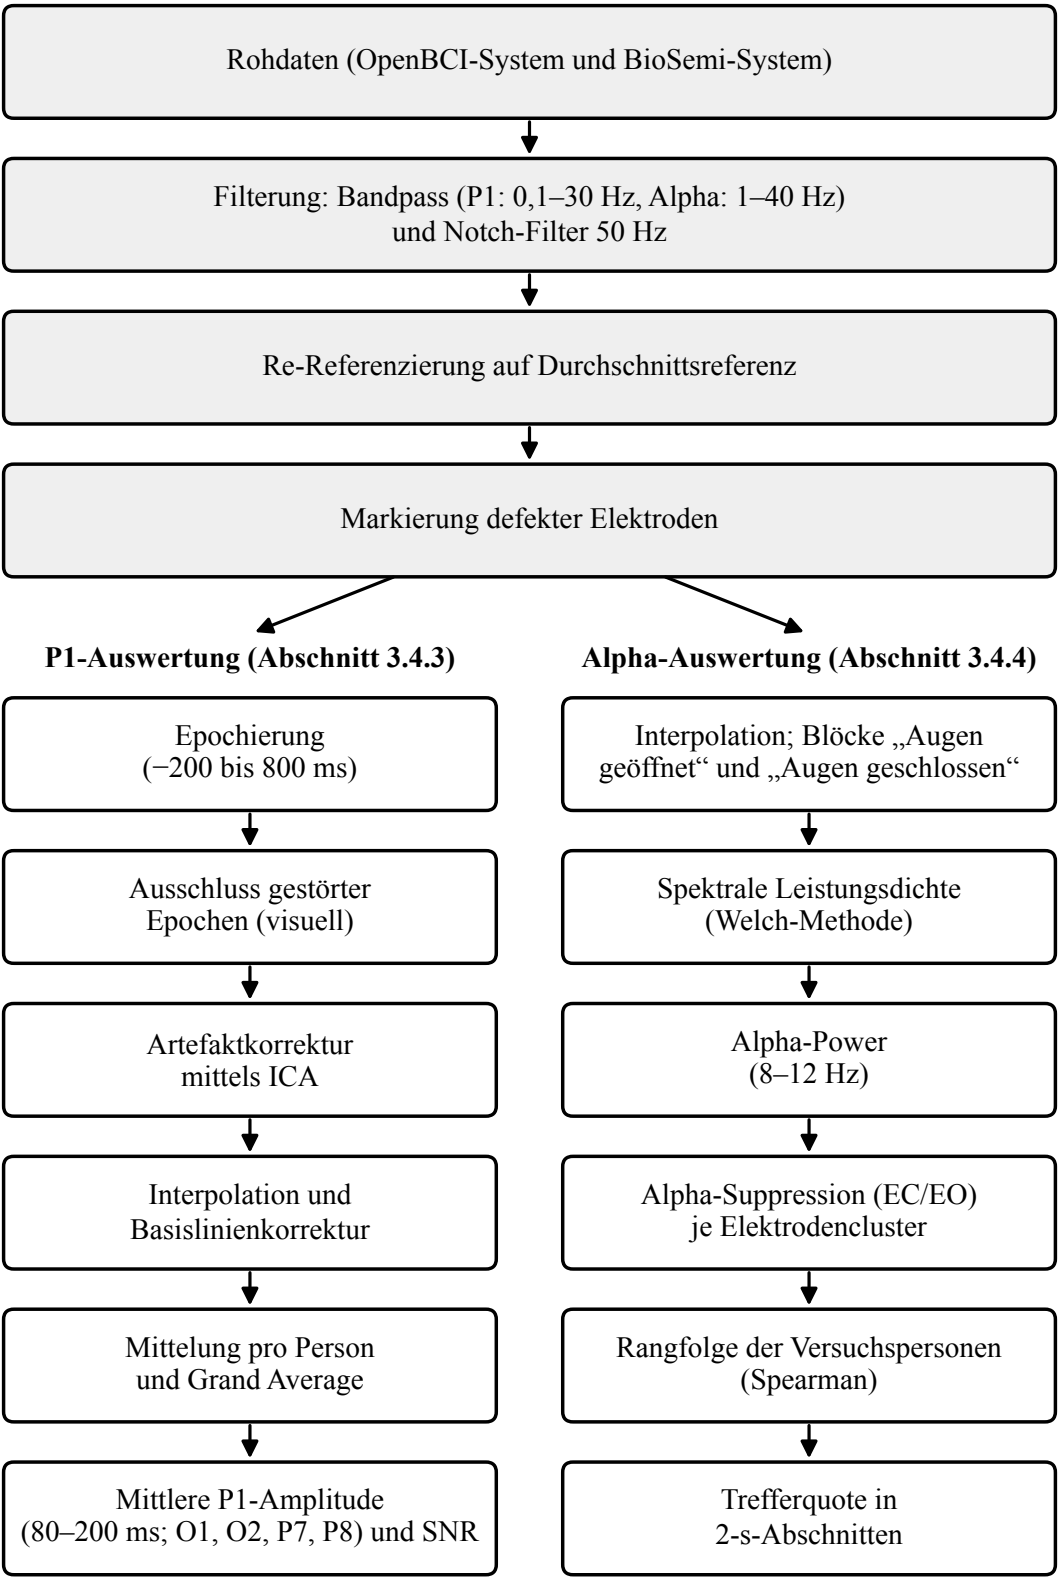

Rohdaten (OpenBCI-System und BioSemi-System)
Filterung: Bandpass (P1: 0,1–30 Hz, Alpha: 1–40 Hz)
und Notch-Filter 50 Hz
Re-Referenzierung auf Durchschnittsreferenz
Markierung defekter Elektroden
P1-Auswertung (Abschnitt 3.4.3)
Alpha-Auswertung (Abschnitt 3.4.4)
Epochierung
(−200 bis 800 ms)
Ausschluss gestörter
Epochen (visuell)
Artefaktkorrektur
mittels ICA
Interpolation und
Basislinienkorrektur
Mittelung pro Person
und Grand Average
Mittlere P1-Amplitude
(80–200 ms; O1, O2, P7, P8) und SNR
Interpolation; Blöcke „Augen
geöffnet“ und „Augen geschlossen“
Spektrale Leistungsdichte
(Welch-Methode)
Alpha-Power
(8–12 Hz)
Alpha-Suppression (EC/EO)
je Elektrodencluster
Rangfolge der Versuchspersonen
(Spearman)
Trefferquote in
2-s-Abschnitten