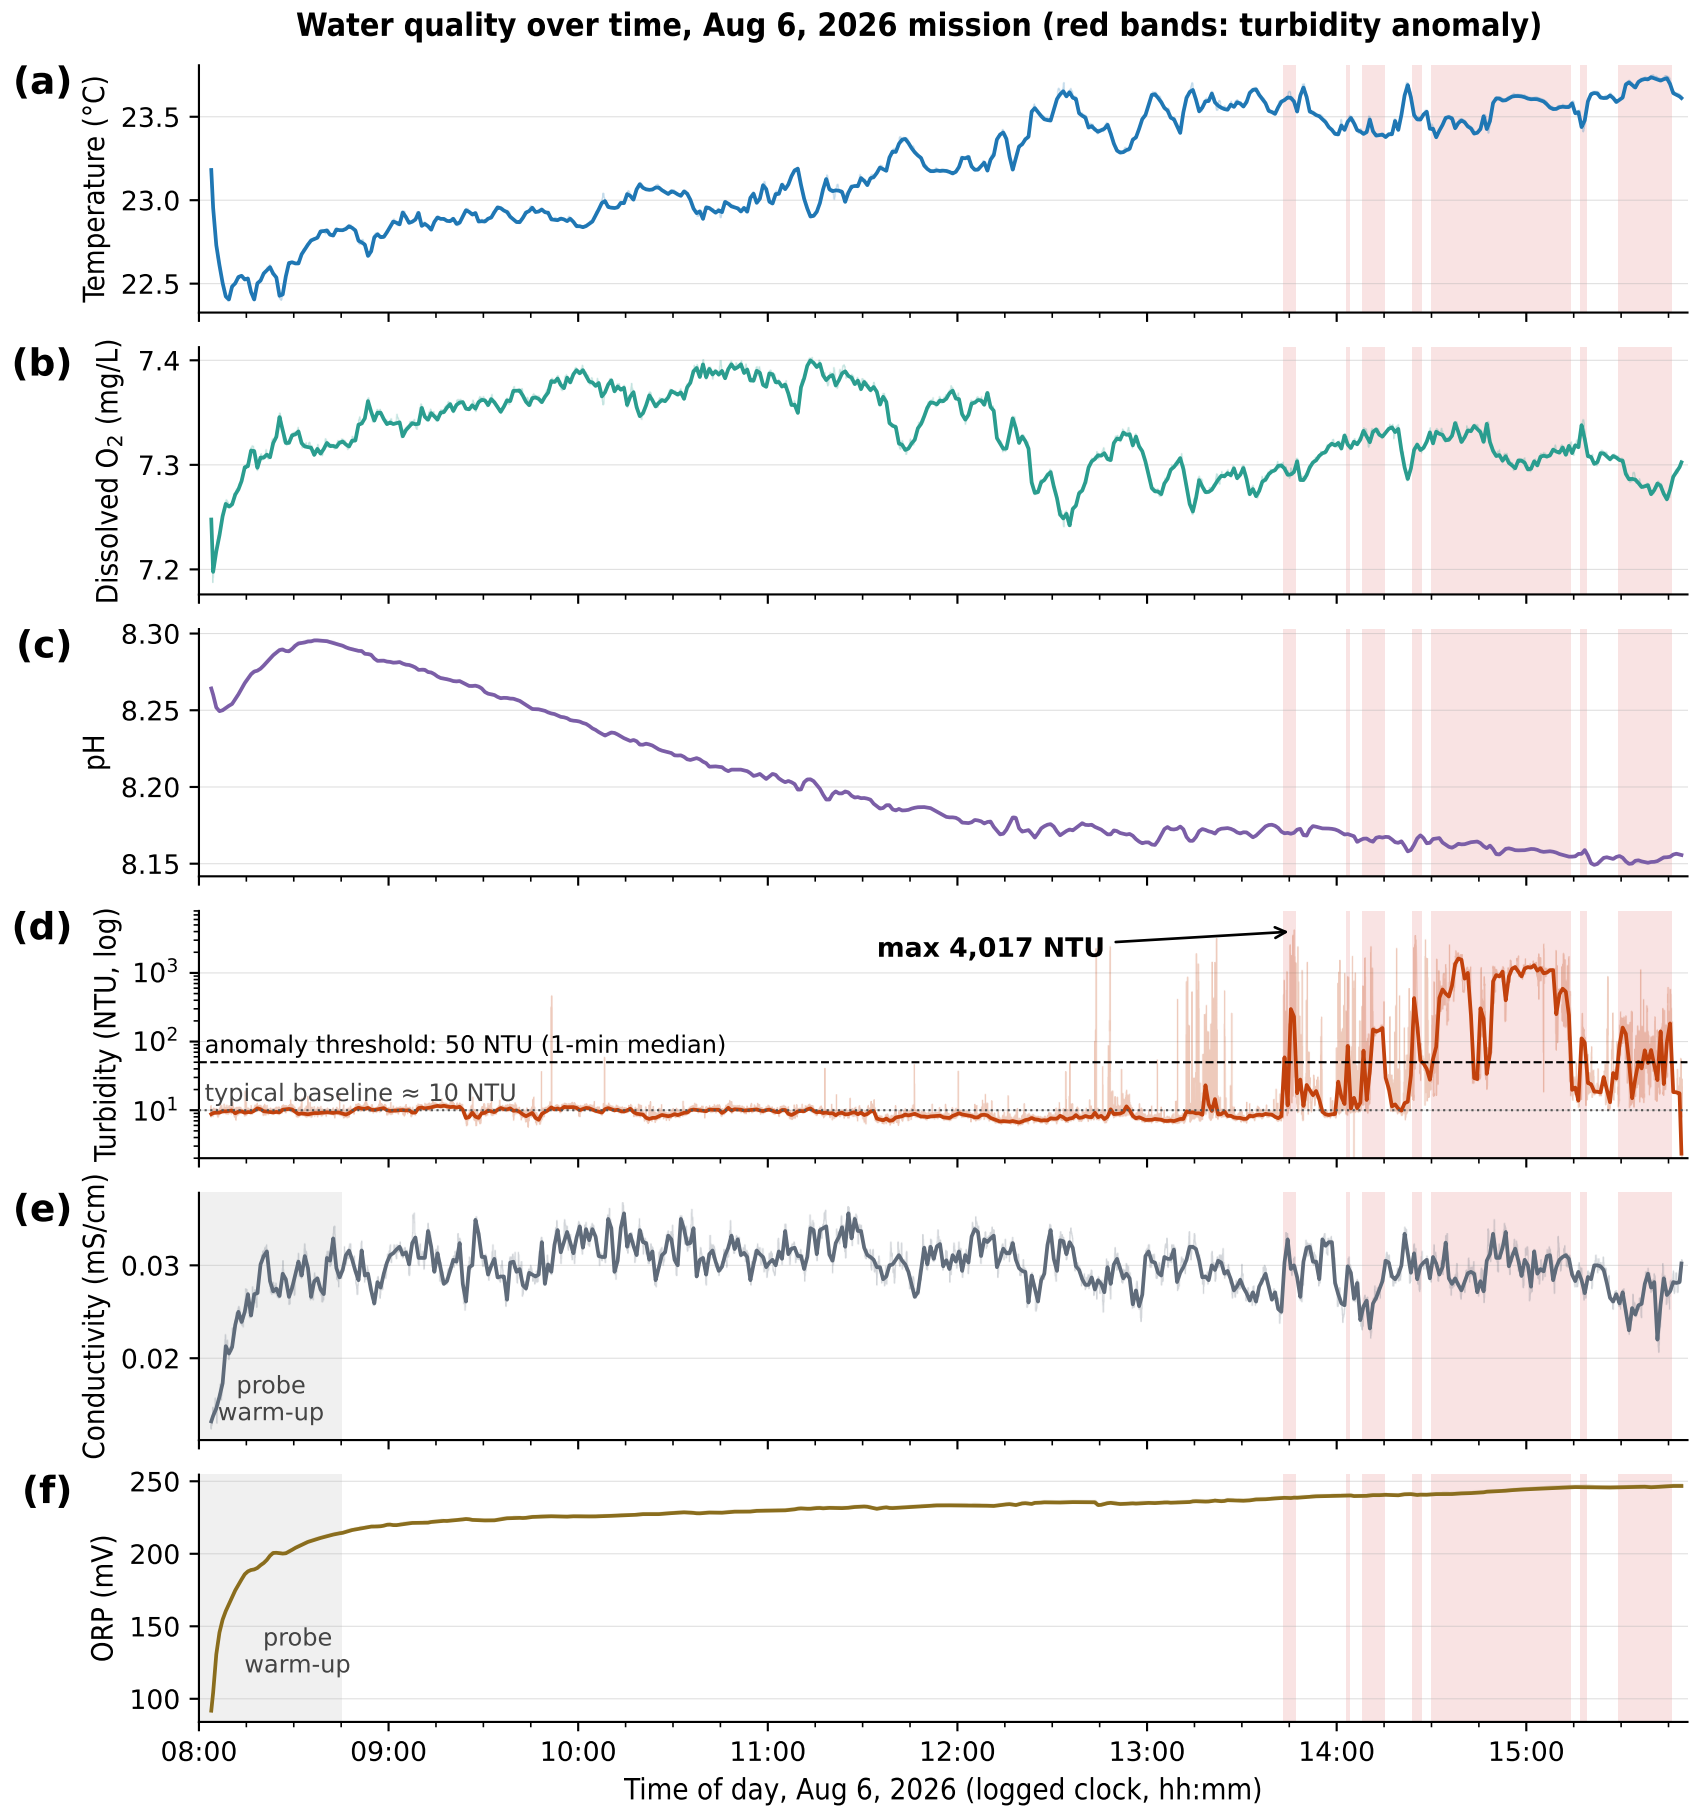

Water quality over time, Aug 6, 2026 mission (red bands: turbidity anomaly)
(a)
Temperature (°C)
23.5
23.0
22.5
(b)
Dissolved O2 (mg/L)
7.4
7.3
7.2
(c)
pH
8.30
8.25
8.20
8.15
(d)
Turbidity (NTU, log)
max 4,017 NTU
anomaly threshold: 50 NTU (1-min median)
typical baseline ≈ 10 NTU
(e)
Conductivity (mS/cm)
0.03
0.02
probe warm-up
(f)
ORP (mV)
250
200
150
100
probe warm-up
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Time of day, Aug 6, 2026 (logged clock, hh:mm)