


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0417

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	46,23	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34970
Espesor [mm] Wall Thickness	2,42	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41291
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

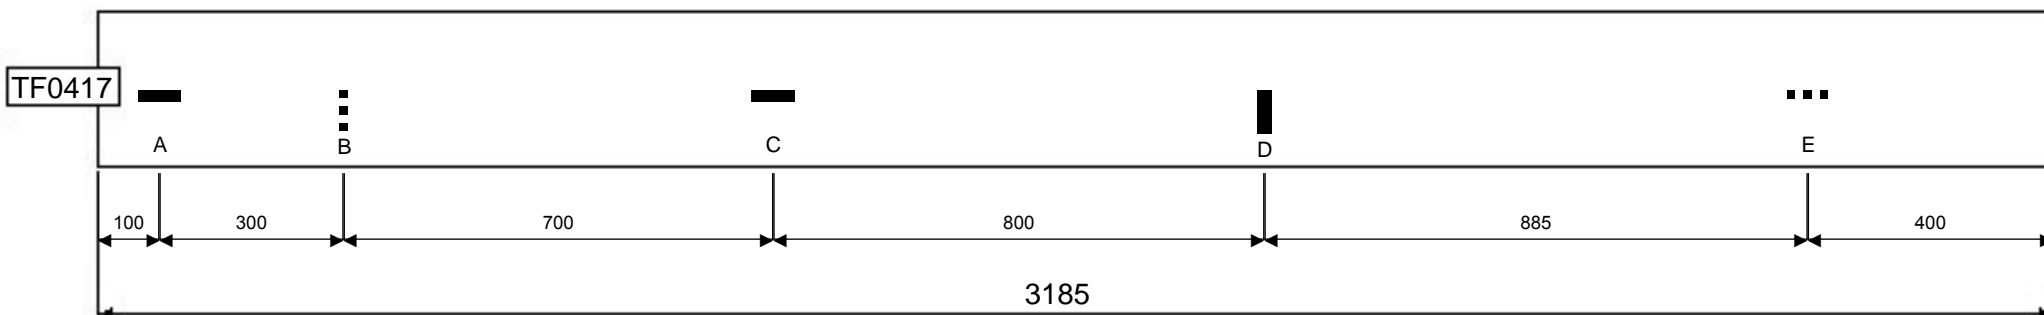

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	±15	0,278	0,206	0,242	25,00	24,50	0,275	0,277	0,59	Dante Antunez	22/03/11
B	Transversal Interno Transverse ID	0,70	10	+5-0	0,254	0,242	0,242	25,00	20,40	0,242	0,240	0,59	Dante Antunez	22/03/11
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,54	10	+5-0	0,254	0,242	0,242	24,40	24,40	0,241	0,240	0,54	Dante Antunez	22/03/11
D	Transversal Externo Transverse OD	0,56	10	+5-0	0,254	0,242	0,242	24,70	24,70	0,232	0,240	0,56	Dante Antunez	22/03/11
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,59	10	+5-0	0,254	0,242	0,242	24,30	24,30	0,240	0,242	0,59	Dante Antunez	22/03/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT	Fecha Date	22/03/2011 11:51:31 a.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------