


Tubo patrón número
Reference standard #

SS0328

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	EXXON MOBIL	Ciclo Product	60267
Espesor [mm] Wall Thickness	10,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	78644
Trazabilidad Traceability	41			Expediente Manufacturing Order	5/1177.01

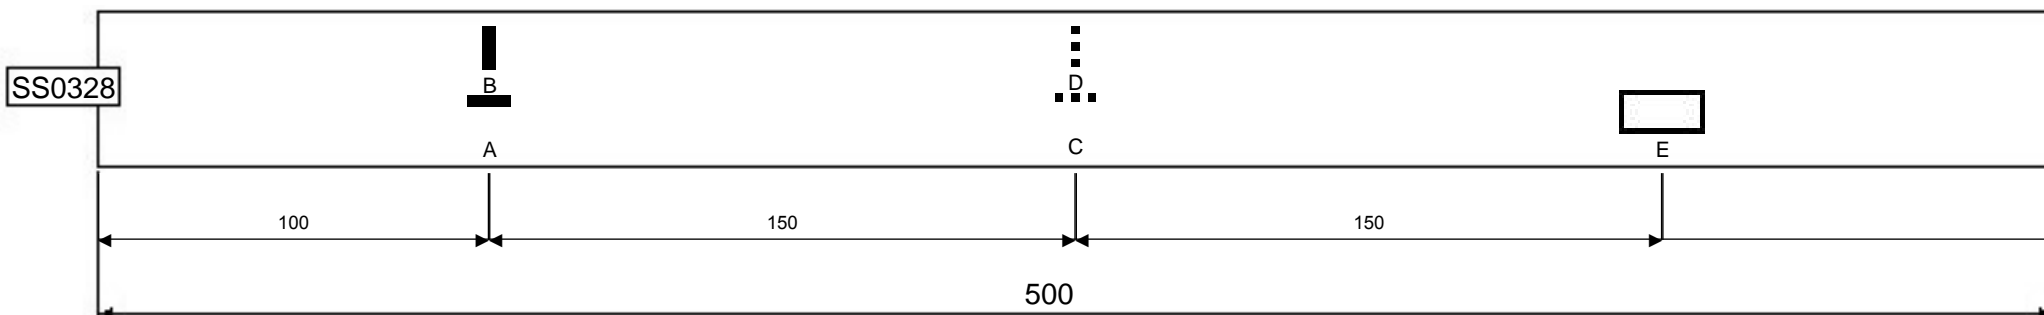

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,592	0,438	0,515	50,80	49,90	0,554	0,561	0,86	Carlos Aguilar	10/01/17
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,592	0,438	0,515	50,80	43,80	0,517	0,538	0,85	Carlos Aguilar	10/01/17
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,592	0,438	0,515	50,80	49,50	0,592	0,547	0,83	Agustin Torres	10/01/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,592	0,438	0,515	50,80	47,00	0,590	0,586	0,86	Agustin Torres	10/01/17
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	5,923	5,150	5,150	16,00	15,40	4,900	4,940	5,50	Agustin Torres	10/01/17

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

10/01/2017
02:26:14 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006