


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0214**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Total Angola	Ciclo Product	85743
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22587
Trazabilidad Traceability	8			Expediente Manufacturing Order	5/4824.04

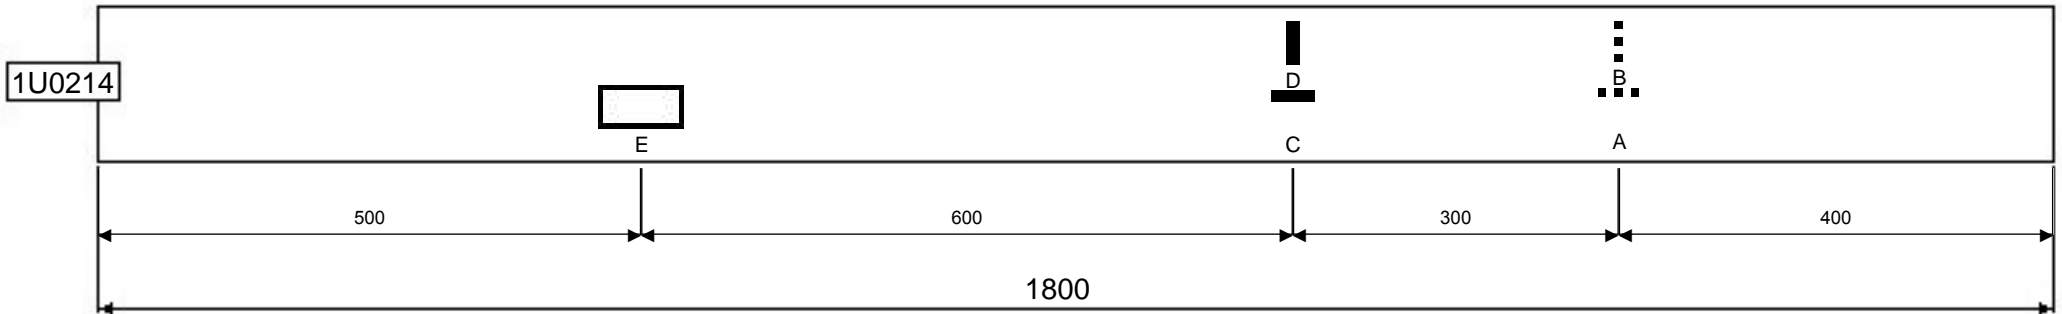

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	47,00	0,422	0,420	0,86	Nicolas Lorenzato	28/05/07
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	32,70	0,390	0,385	0,96	Nicolas Lorenzato	28/05/07
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	46,90	0,424	0,428	0,92	Nicolas Lorenzato	28/05/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	39,30	0,395	0,420	0,83	Nicolas Lorenzato	28/05/07
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,485	3,315	3,900	17,00	16,00	4,300	4,300	5,50	Nicolas Lorenzato	28/05/07

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A**

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	28/05/2007 02:18:41 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------