

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c546

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	67239				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

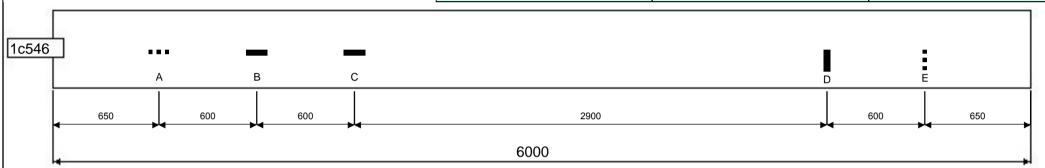

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	49,00	0,630	0,629	0,96	Sebastian Monteros	13/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,00	0,357	0,364	0,94	Sebastian Monteros	13/09/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	50,00	0,737	0,729	0,94	Sebastian Monteros	13/09/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,00	0,359	0,357	0,91	Sebastian Monteros	13/09/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	44,00	0,393	0,395	0,94	Sebastian Monteros	13/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 13/09/2004 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 05:54:47 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006 | TAND-001-05 | TAND-001-05