

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2772



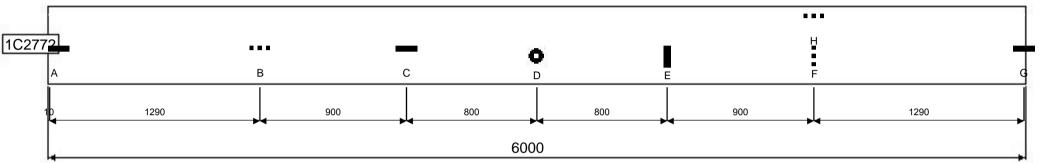

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,314	0,319	0,82	Carlos Aguilar	10/06/17
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,00	0,291	0,286	0,83	Agustin Torres	10/06/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,311	0,326	0,57	Carlos Aguilar	10/06/17
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,60	Carlos Aguilar	10/06/17
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	19,90	0,337	0,339	0,56	Carlos Aguilar	10/06/17
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	10,00	0,328	0,336	0,56	Agustin Torres	10/06/17
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,333	0,337	0,84	Carlos Aguilar	10/06/17
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	14	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,20	0,457	0,460	0,82	Agustin Torres	10/06/17

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 10/06/2017 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:41:27 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2772

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22397				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	42442				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5244301				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES