


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2i340**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	10571
Espesor [mm] Wall Thickness	18,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

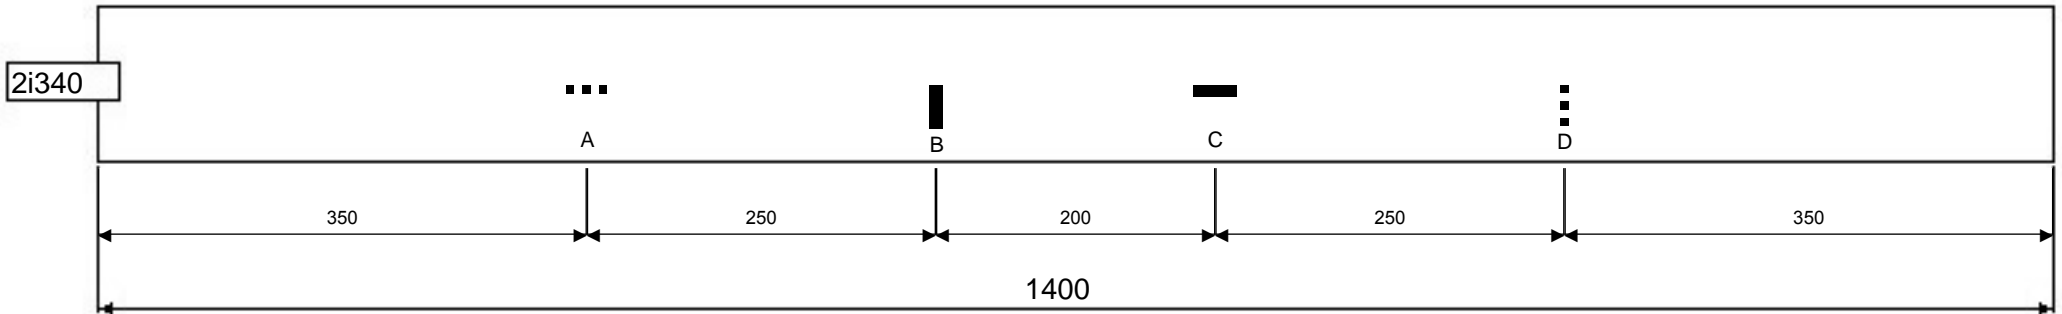

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	2	±15	0,362	0,267	0,315	50,80	48,40	0,340	0,320	0,93	Sebastian Monteros	06/08/04
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	2	±15	0,362	0,267	0,315	50,80	45,00	0,340	0,320	0,91	Sebastian Monteros	06/08/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,362	0,267	0,315	50,80	48,60	0,320	0,320	0,92	Sebastian Monteros	06/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	2	±15	0,362	0,267	0,315	50,80	38,60	0,310	0,300	0,94	Sebastian Monteros	06/08/04

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey   Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300   Codigo: 302-916E

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT	Fecha Date	06/08/2004 01:08:20 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------