


Tubo patrón número
Reference standard #

2U146

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	71645	
Espesor [mm] Wall Thickness	12,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

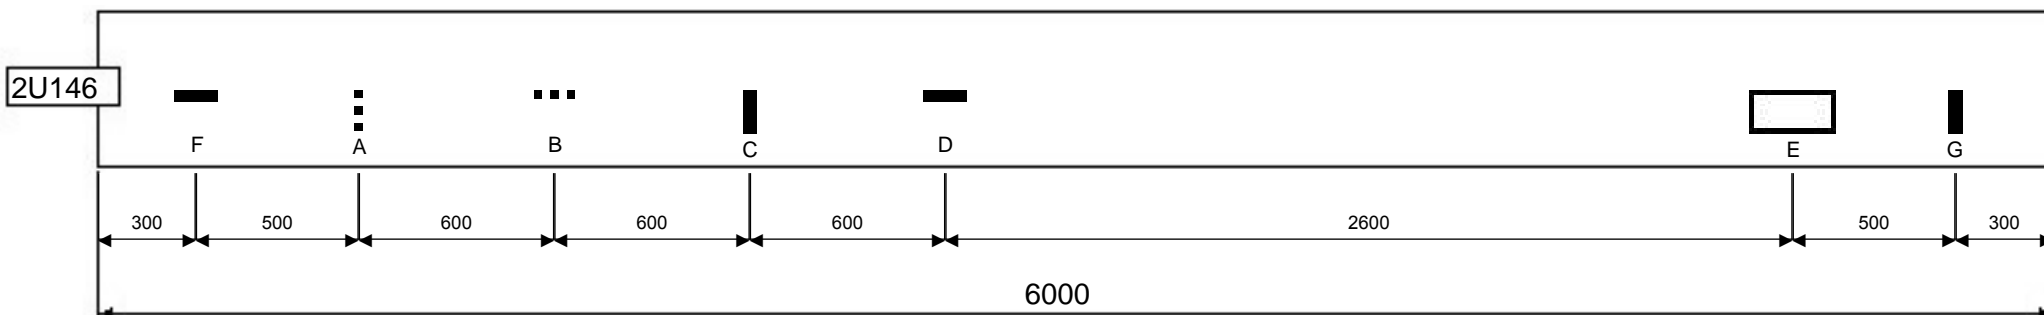

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	20,00	0,680	0,680	0,95	Sebastian Monteros	22/11/06
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	25,00	0,640	0,640	0,96	Sebastian Monteros	22/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	25,00	0,680	0,680	0,96	Sebastian Monteros	22/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	24,20	0,650	0,650	0,95	Sebastian Monteros	22/11/06
E	Chavetero Grove	10,00	50	±15	7,188	5,313	6,250	10,00	10,00	0,622	0,622	10,00	Sebastian Monteros	22/11/06
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	24,20	0,660	0,660	0,96	Sebastian Monteros	22/11/06
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	25,00	24,80	0,660	0,660	0,96	Sebastian Monteros	22/11/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U146****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	71645	
Espesor [mm] Wall Thickness	12,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES