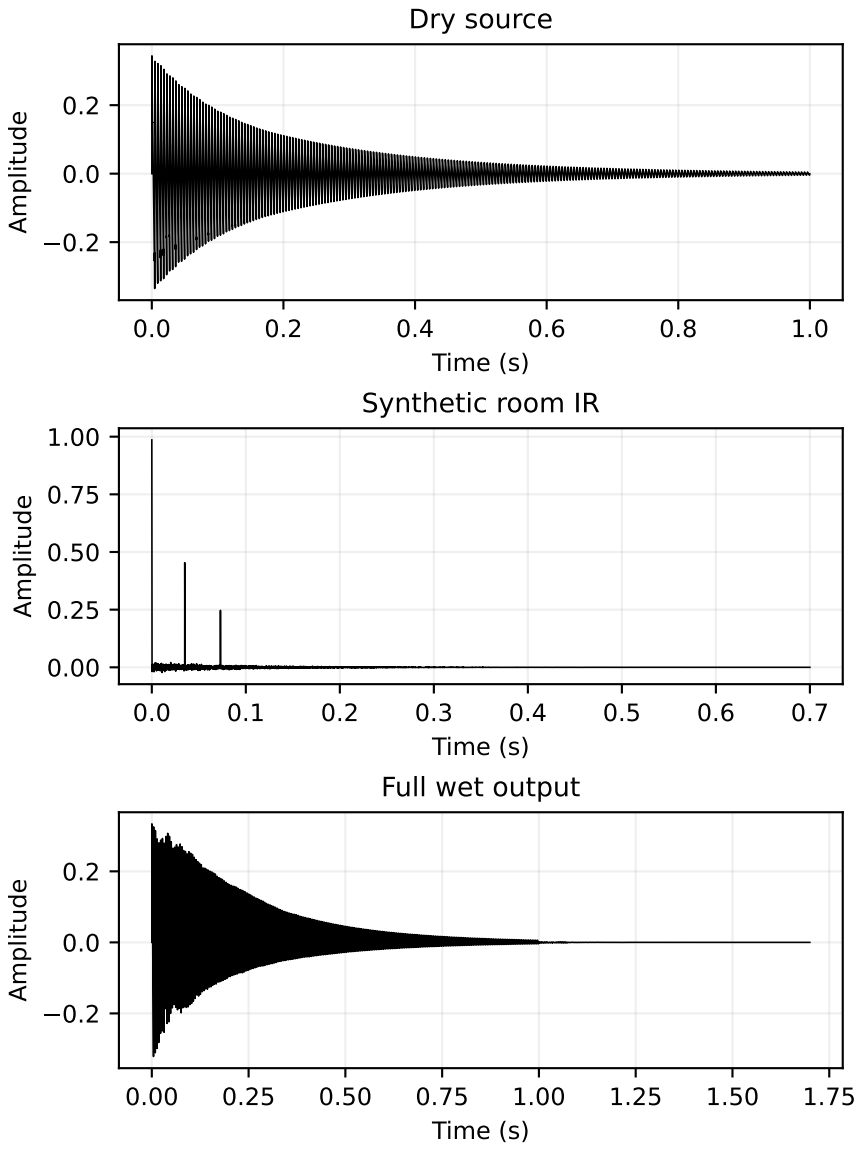

Dry source
Amplitude
0.2
0.0
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Time (s)
Synthetic room IR
Amplitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Time (s)
Full wet output
Amplitude
0.2
0.0
−0.2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
Time (s)