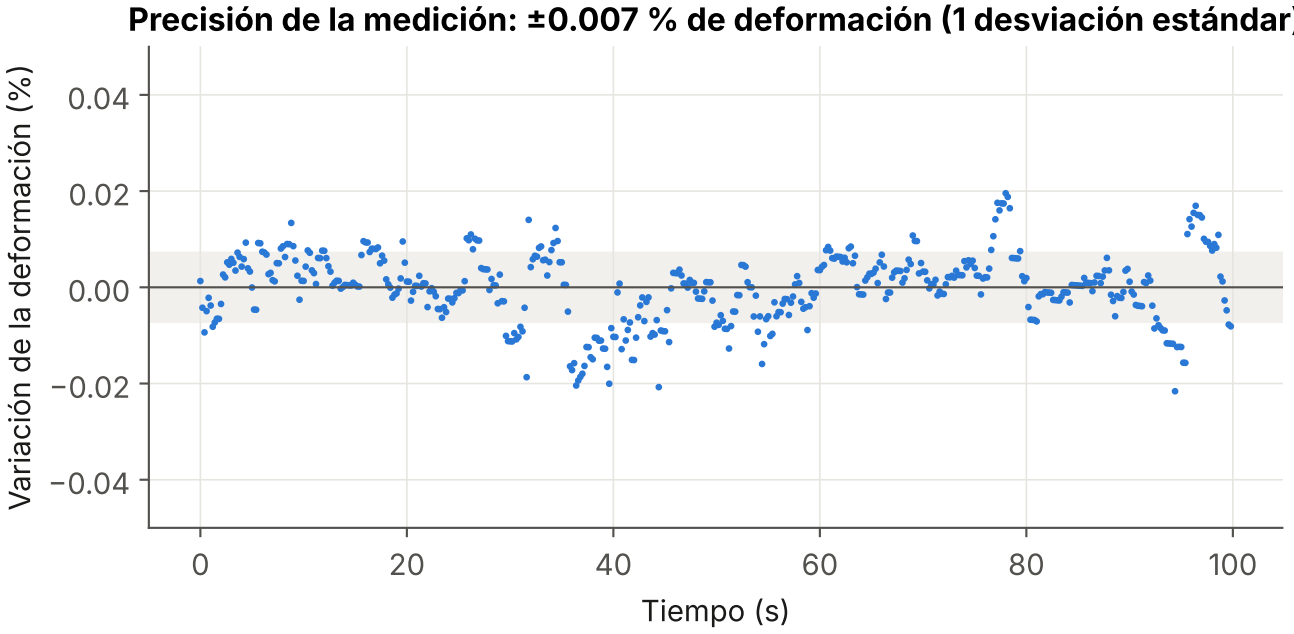
Precisión de la medición: ±0.007 % de deformación (1 desviación estándar)
Variación de la deformación (%)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
20
40
60
80
100
Tiempo (s)