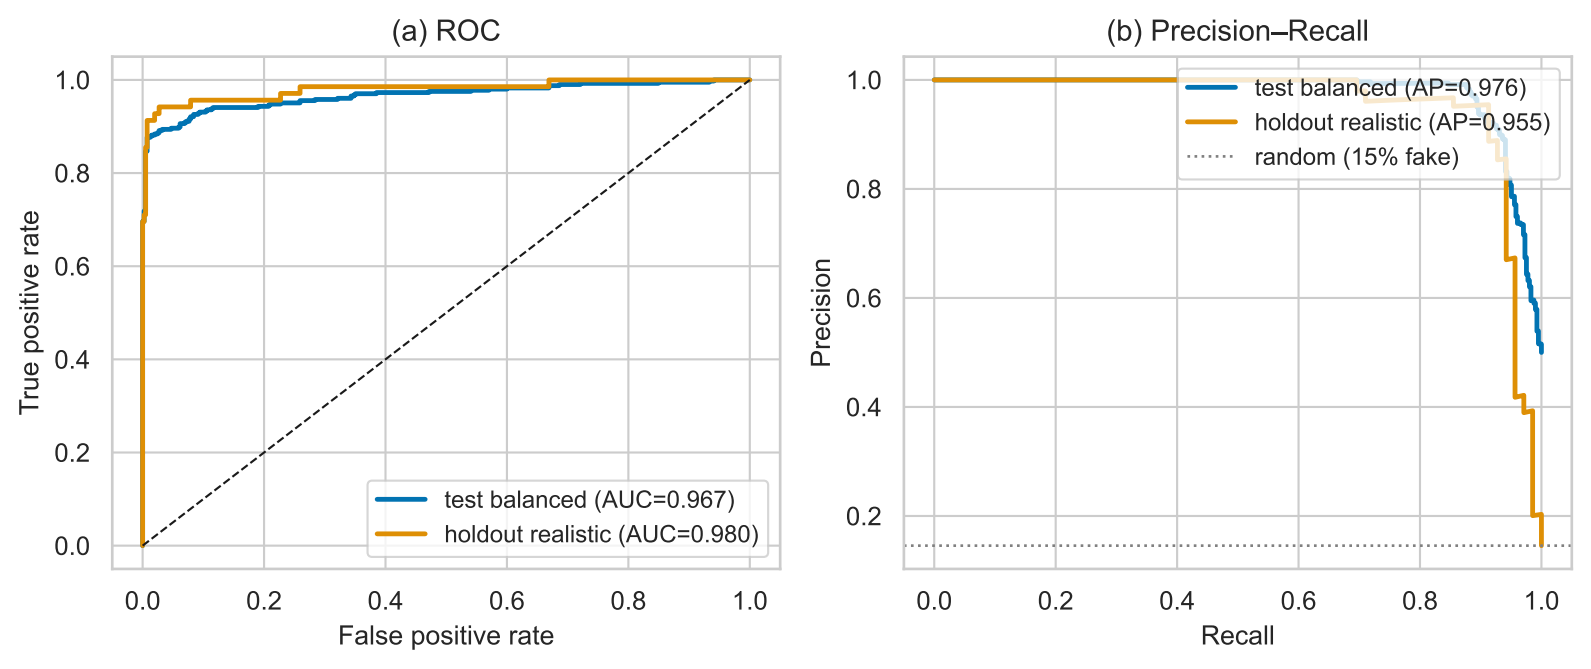
(a) ROC
True positive rate
False positive rate
test balanced (AUC=0.967)
holdout realistic (AUC=0.980)
(b) Precision–Recall
Precision
Recall
test balanced (AP=0.976)
holdout realistic (AP=0.955)
random (15% fake)