


Adquisicion de Señal Biofisiologica

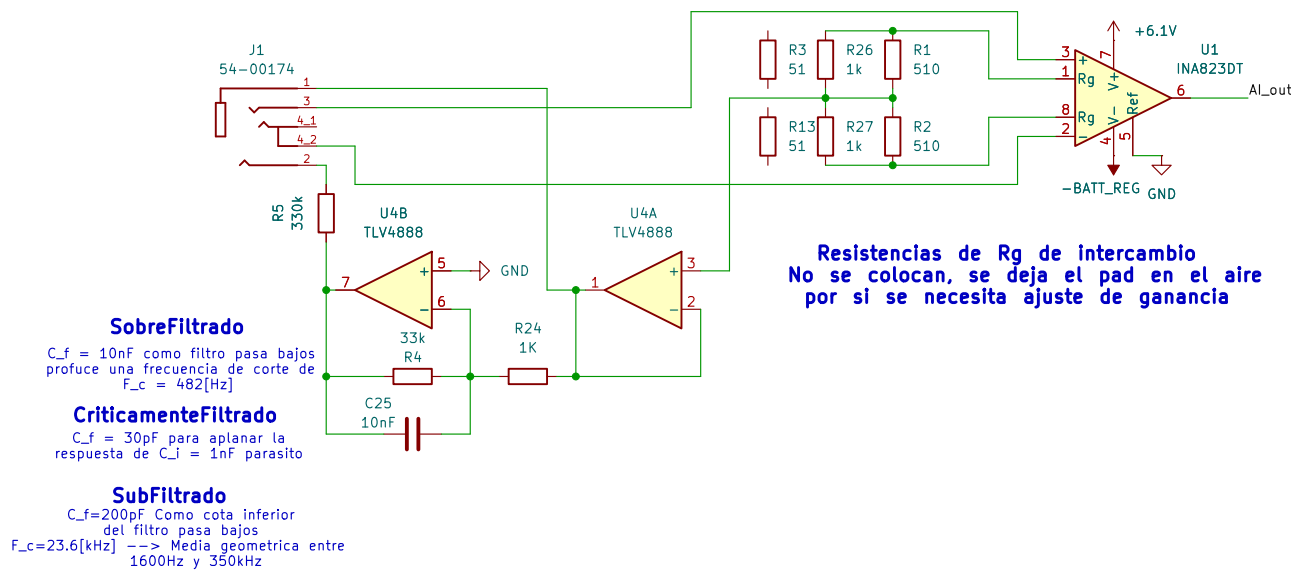


SobreFiltrado
 $C_f = 10\text{nF}$ como filtro pasa bajos
produce una frecuencia de corte de
 $F_c = 482[\text{Hz}]$

CriticamenteFiltrado
 $C_f = 30\text{pF}$ para aplanar la
respuesta de $C_j = 1\text{nF}$ parasito

SubFiltrado
 $C_f = 200\text{pF}$ Como cota inferior
del filtro pasa bajos
 $F_c = 23.6[\text{kHz}] \rightarrow$ Media geometrica entre
1600Hz y 350kHz

Resistencias de R_g de intercambio
No se colocan, se deja el pad en el aire
por si se necesita ajuste de ganancia


Alimentación

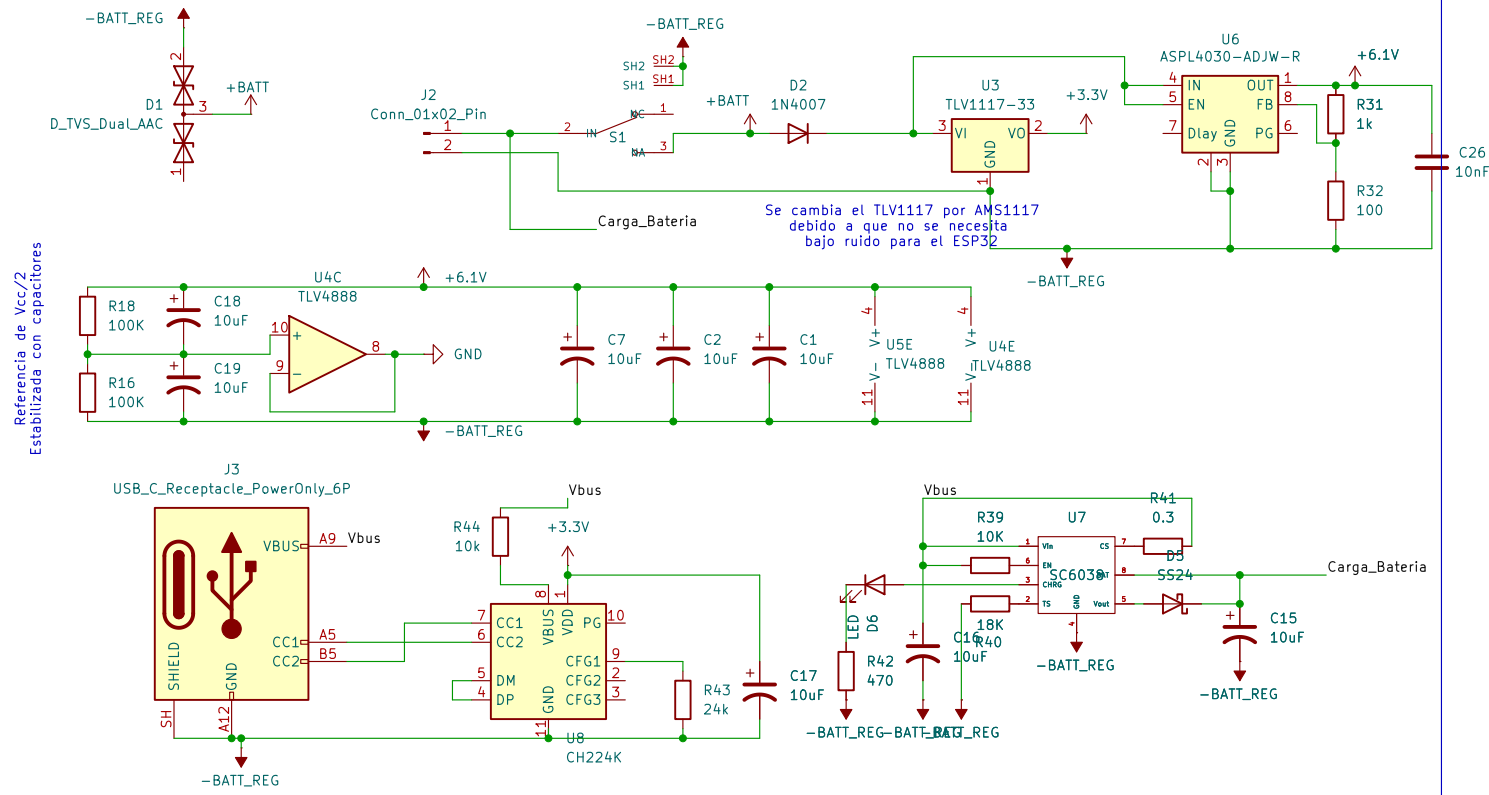


Referencia de $V_{cc}/2$
Estabilizada con capacitores

Se cambia el TLV1117 por AMS1117
debido a que no se necesita
bajo ruido para el ESP32

Adaptacion de Señal

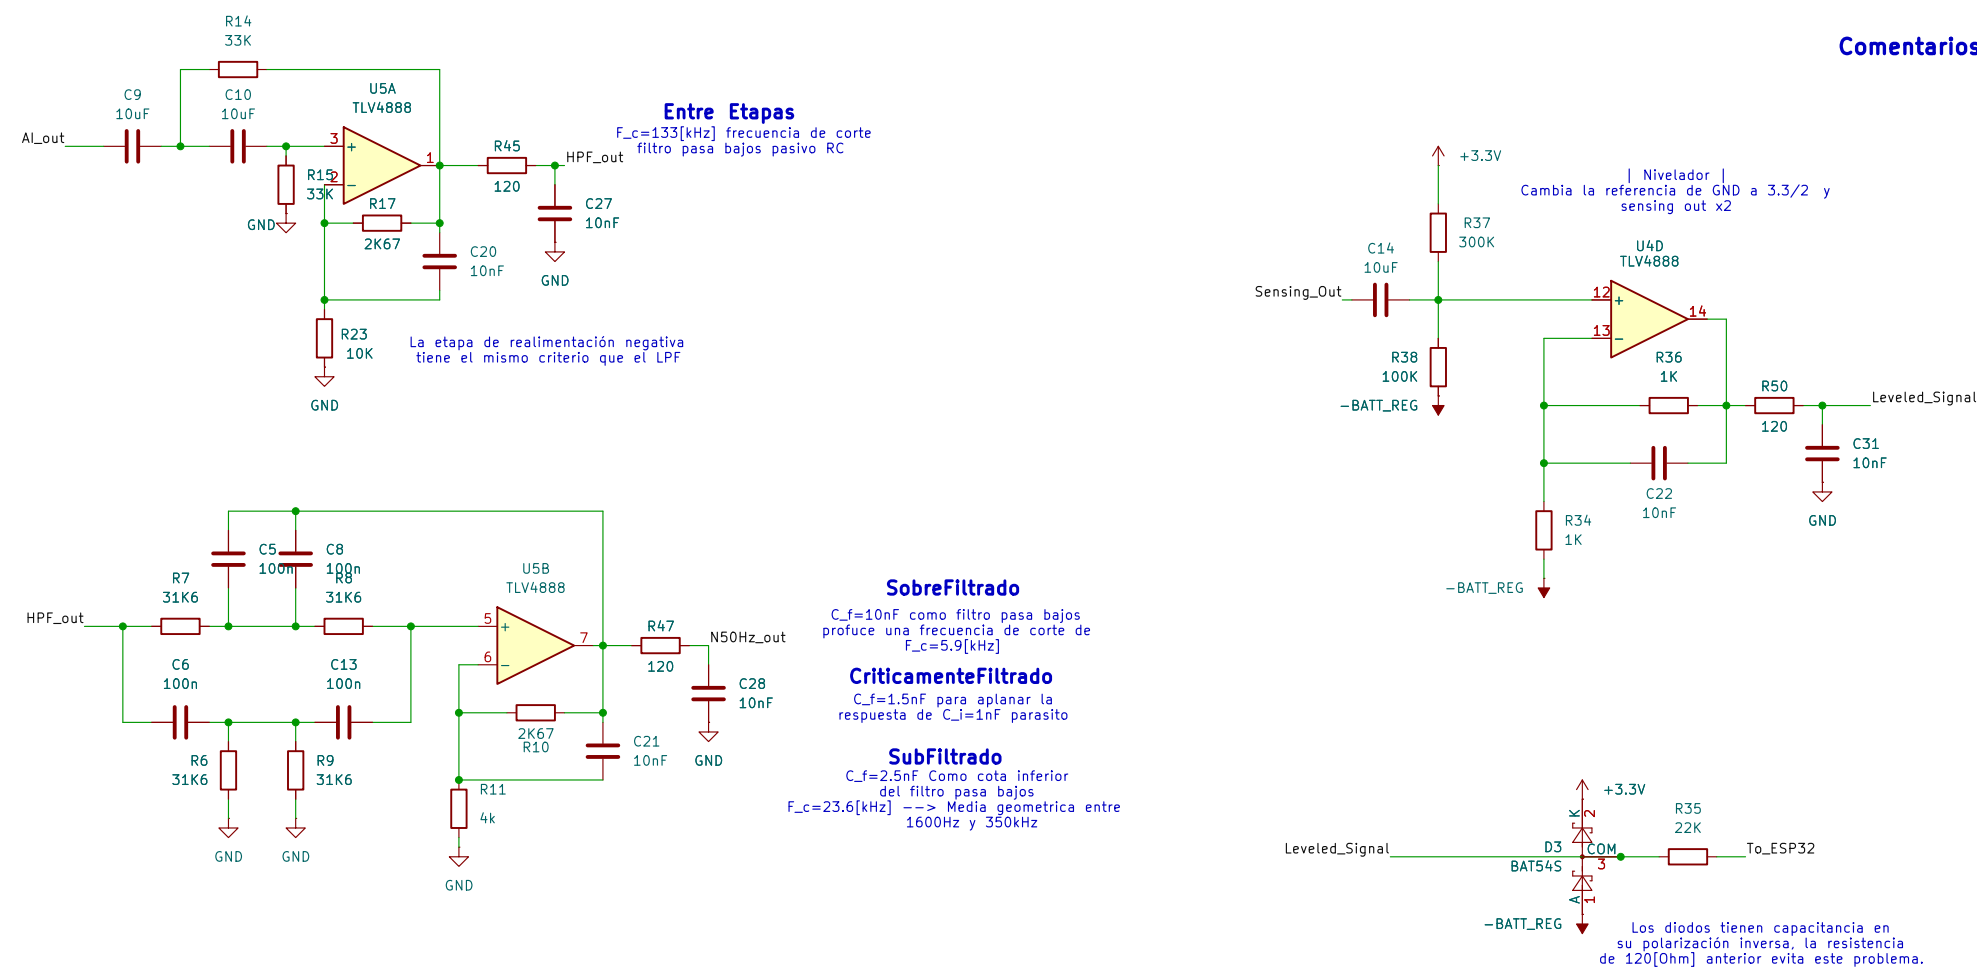

Comentarios (Cuando se discutan se eliminan):

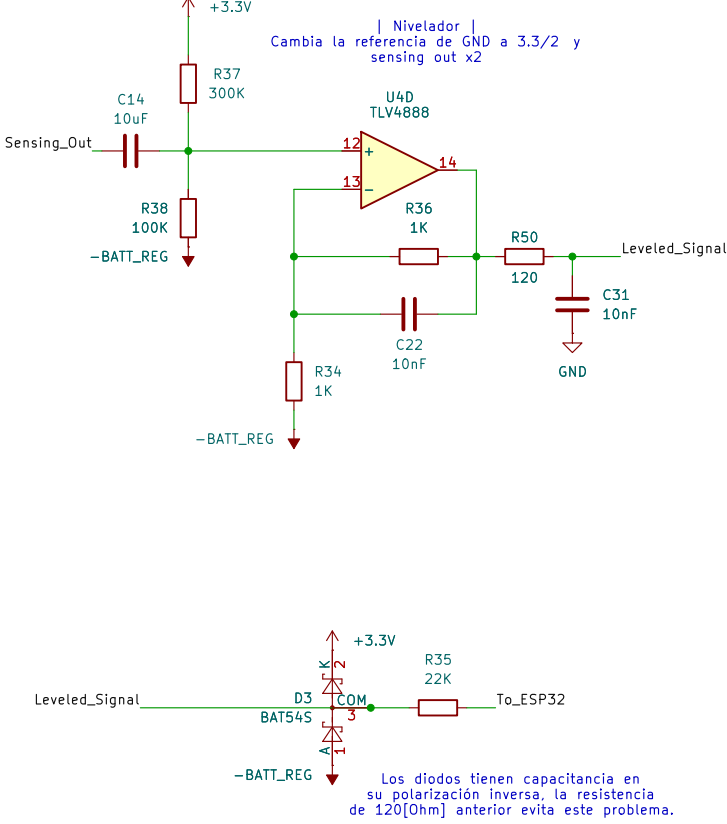

SobreFiltrado
 $C_f = 10\text{nF}$ como filtro pasa bajos
produce una frecuencia de corte de
 $F_c = 15.9[\text{kHz}]$

CriticamenteFiltrado
 $C_f = 1\text{nF}$ para aplanar la
respuesta de $C_j = 1\text{nF}$ parasito

SubFiltrado
 $C_f = 674\text{pF}$ Como cota inferior
del filtro pasa bajos
 $F_c = 23.6[\text{kHz}] \rightarrow$ Media geometrica entre
1600Hz y 350kHz


SobreFiltrado
 $C_f = 10\text{nF}$ como filtro pasa bajos
produce una frecuencia de corte de
 $F_c = 16[\text{kHz}]$

CriticamenteFiltrado
 $C_f = 1\text{nF}$ para aplanar la
respuesta de $C_j = 1\text{nF}$ parasito

SubFiltrado
 $C_f = 6.4[\text{nF}]$ Como cota inferior
del filtro pasa bajos
 $F_c = 23.6[\text{kHz}] \rightarrow$ Media geometrica entre
1600Hz y 350kHz

CORREGIDO
Pasa de tener $A_v = 3.3 = 330\text{k}/100\text{k}$
a tener $A_v = 24 = 24\text{k}/1\text{k}$
Esto hay que revisarlo y buscar alternativa
Se deja en una amplificación de $A_v = 1 = 1\text{k}/1\text{k}$

ESP32-C3

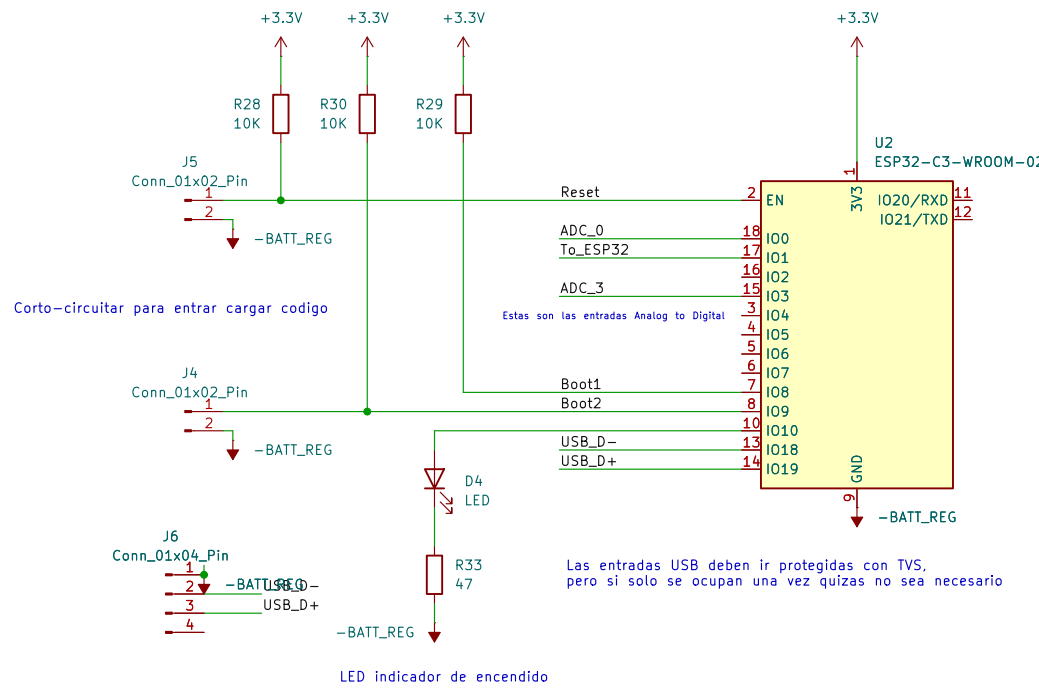

Corto-circuitar para entrar cargar codigo

Las entradas USB deben ir protegidas con TVS,
pero si solo se ocupan una vez quizas no sea necesario