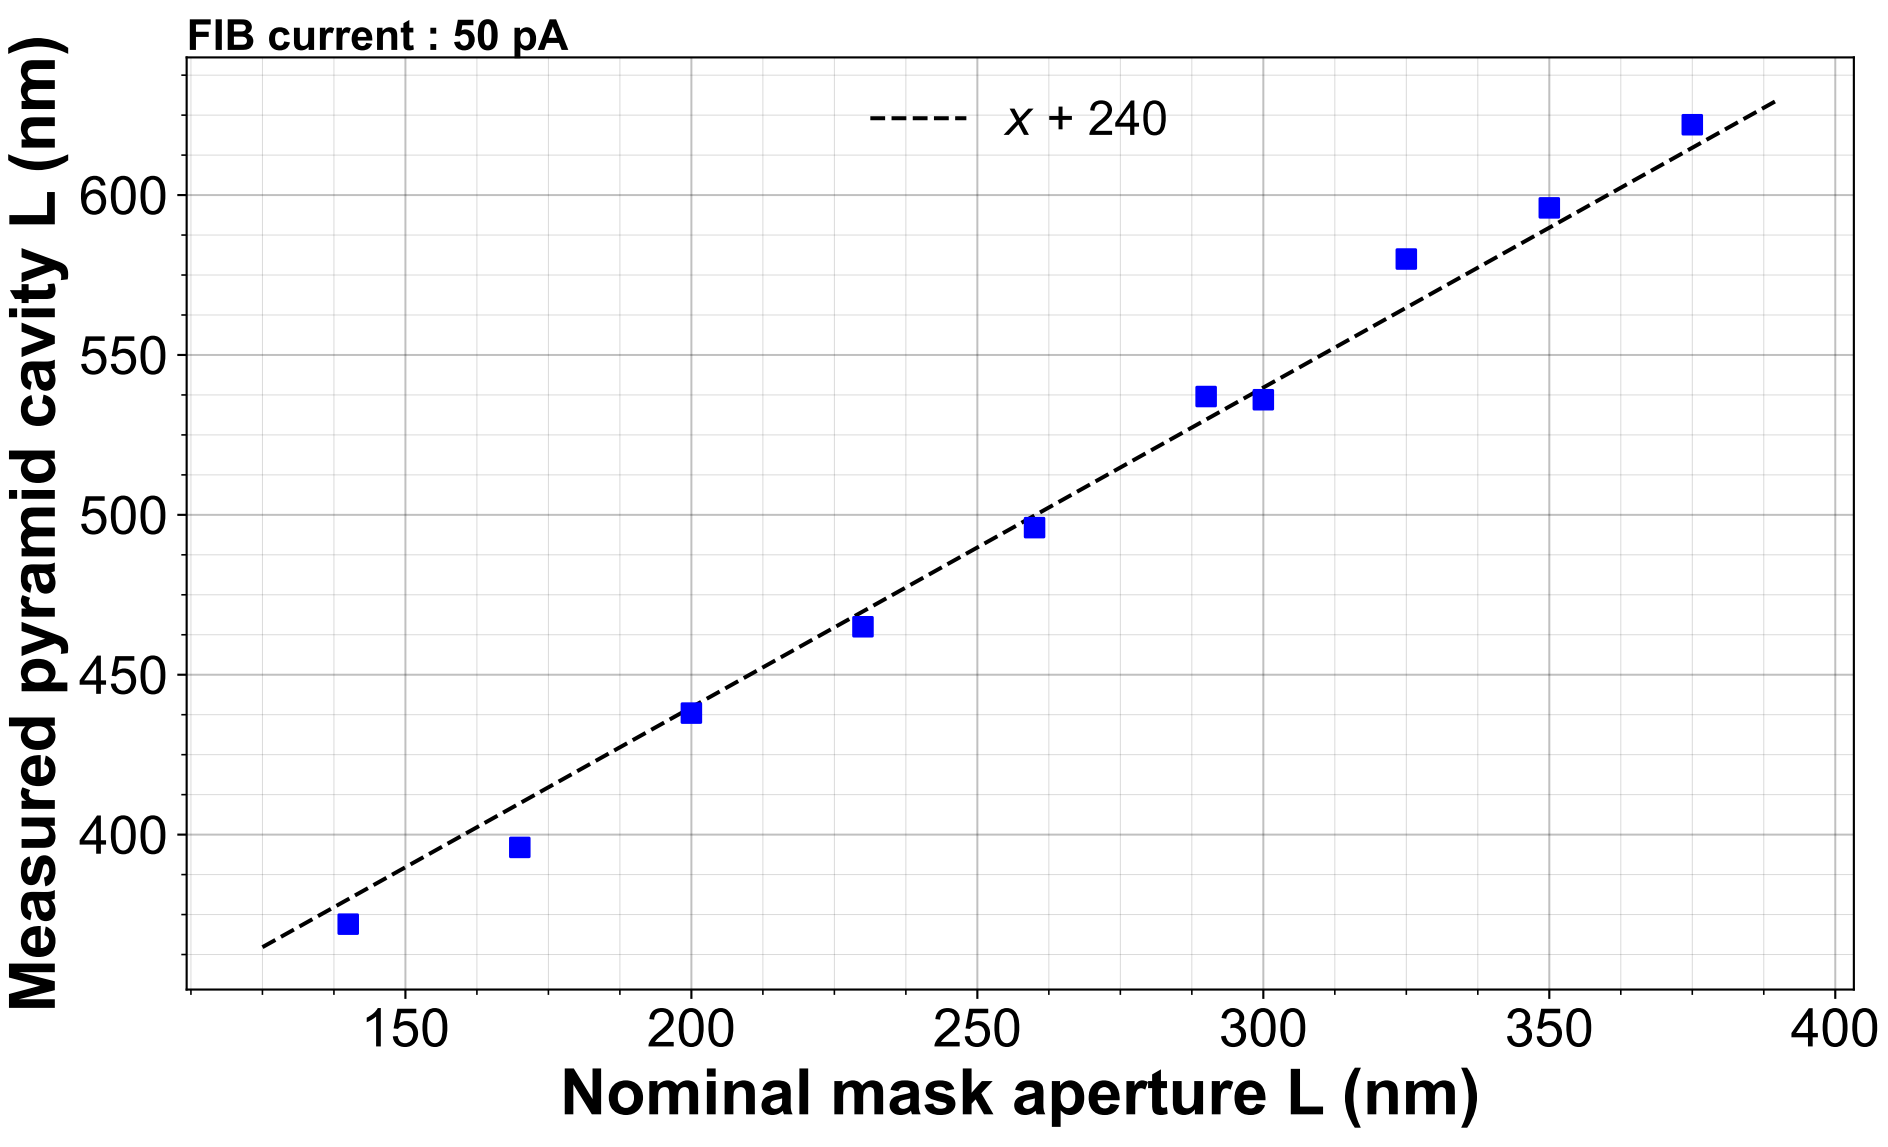
FIB current : 50 pA
----- x + 240
Measured pyramid cavity L (nm)
600
550
500
450
400
150
200
250
300
350
400
Nominal mask aperture L (nm)