



Институт Ядерной Физики имени Г.И.Будкера

Разработка детектора для цифровой рентгеновской остеоденситометрии

Олейников Владислав Петрович


Научный руководитель – Поросев Вячеслав Викторович
к.ф.-м. н., старший научный сотрудник

Содержание

1. Какие детекторы существуют?
2. Что влияет на качество снимка? ≈ 40 мин.
3. Три типа сбора сигнала
4. Спектрометрический режим
5. Остеоденситометр
6. Проблема остеопороза
7. Принцип работы денситометра (идеальный случай моноэнергий)
8. Теоретические результаты
9. Выбор сцинтиллятора
10. Выбор SiPM
11. Энергетическое разрешение
12. Энергетическое разрешение: факторы
13. Энергетическое разрешение: доминирующие факторы
14. Экспериментальные характеристики сцинтилляторов
15. Моделирование светосбора
16. Устранение неоднозначности
17. Что есть квантовая эффективность
18. Прототип детектора
19. Измерение спектра излучения рентгеновского источника
20. Вычисление толщины (переключение кВ)
21. Вычисление толщины (двугорбый спектр)
22. Заключение


Какие детекторы существуют?

Экрано-пленочные системы

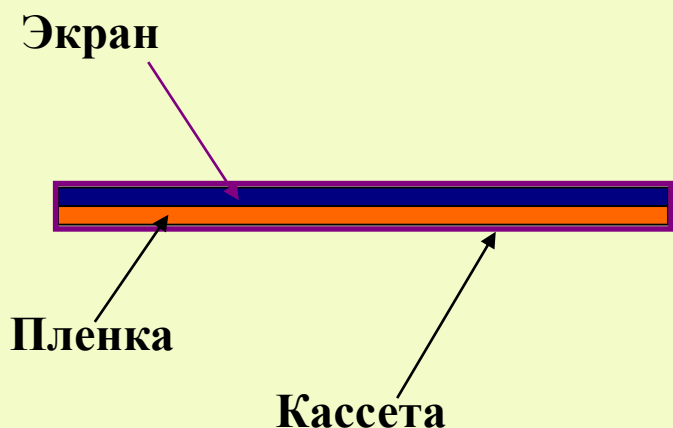

- + Хорошее координатное разрешение (лучше 100 мкм)
- Низкая кватновая эффективность (большая доза)
- ограниченный динамический диапазон < 10


Люминофор с памятью

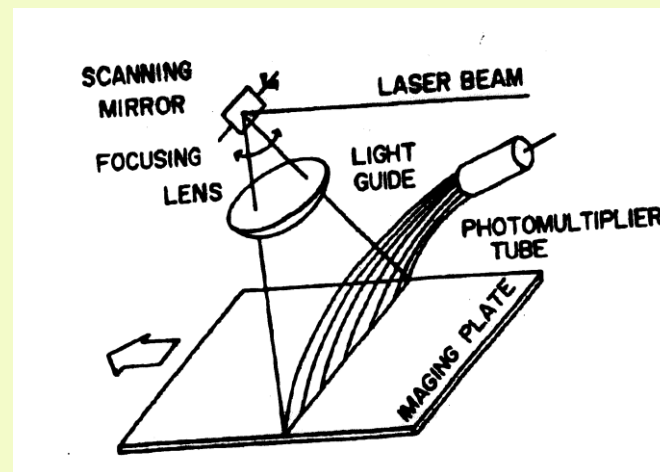

- + Хорошее координатное разрешение (лучше 100 мкм)
- Большой динамический диапазон (~ 200)
- Низкая кватновая эффективность (большая доза)

Какие детекторы существуют?

Сцинтилляционный экран + ПЗС

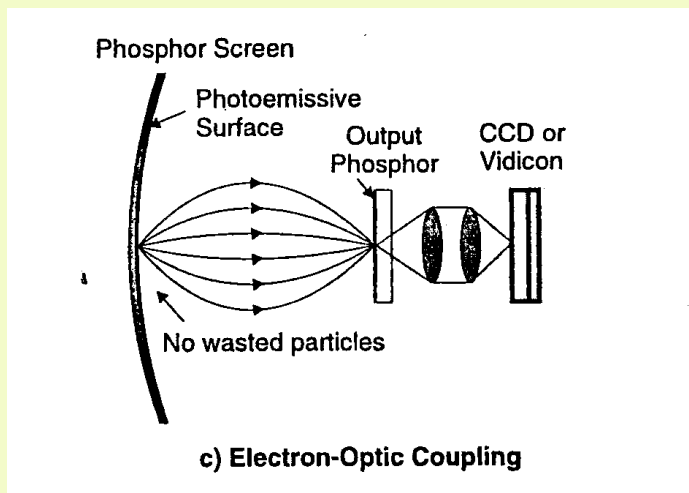

- + Хорошее координатное разрешение (лучше 100 мкм)
- Рассеянное излучение
- Потери света 99%
- Ограниченный динамический диапазон (10 - 30)

flat panel



a-Si (Direct or Indirect)
a-Se (маммография)

- + Хорошее координатное разрешение (лучше 100 мкм)
- Рассеянное излучение

Какие детекторы существуют?

Проволочная камера с Хе
(сканир. режим)



+ Хорошее координатное разрешение
(лучше 100 мкм)

Счетный режим


Динамический диапазон ~ 1000

- Низкая квантовая эффективность при
высоких энергиях (30% при 40 кэВ)

FWHM 30% при 40 кэВ

Быстродействие ~ 500 кГц

SiPM + сцинтиллятор
(сканир. режим)

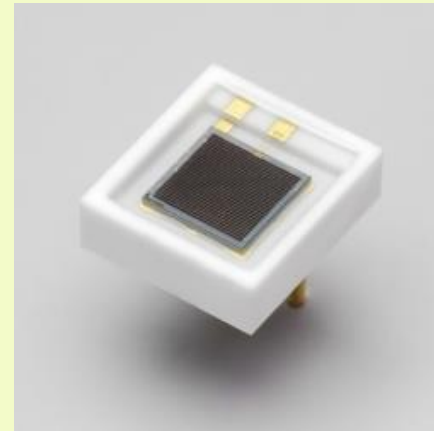


+ Квантовая эффективность $> 99\%$

Работа в спектрометрическом или
счетном режиме

- Плохое координатное разрешение
(~ 1 мм) (технологическая проблема)

Какие детекторы существуют?

Твердотельная ионизационная камера на основа CdTe

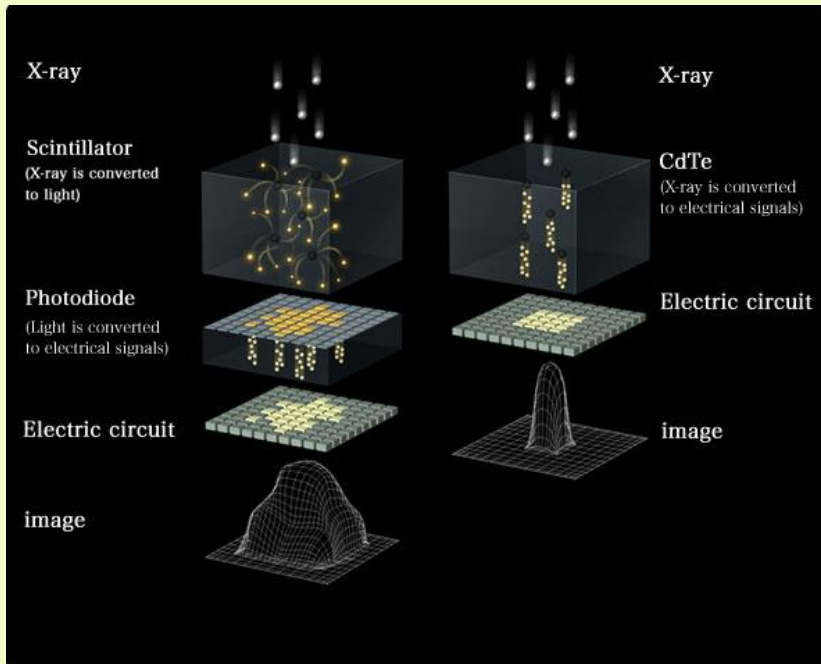

+ Хорошее координатное разрешение
(лучше 100 мкм)

Прямая регистрация рентген. излучения

Отличное энерг. разрешение (лучше 5% в диапазоне 20 -100 кэВ)

Высокая квантовая эффективность

- Время сбора носителей ~ 1 мкс


Технологические сложности:

контакты, гибридная электроника,
дефекты кристалла

Что влияет на качество снимка?

Два основных аспекта, ограничивающих качество снимка:

- 1) Рассеянное излучение
- 2) Дисперсия измеряемого сигнала

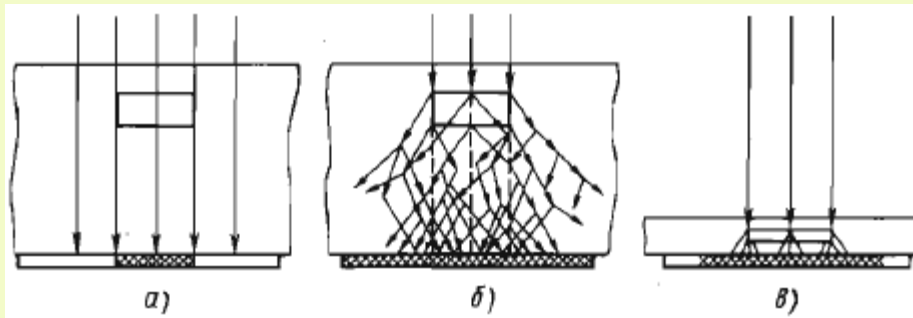


Решение: нужно использовать сканирующие системы

$$S = \sum_{i=0}^N Q_i$$

$$E[S] = E[N] * E[Q] \quad \text{Тождество Вальда}$$

$$Var[S] = Var[N] * E[Q]^2 + Var[Q] * E[N]^2$$

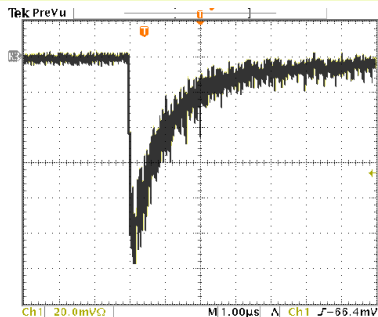

Три типа сбора сигнала

1) Интегрирующий детектор (фотоны не различимы)

$$S = \sum_{i=0}^N Q_i \quad \text{Var}[S] = \text{Var}[N] * E[Q]^2 + \text{Var}[Q] * E[N]^2$$

2) Счетный детектор (фотоны делимы, но не знаем их энергию)

$$S = Q_i \quad \text{Var}[S] = \text{Var}[Q]$$

3) Спектрометрический режим (знаем энергию каждого фотона)

$$S = Q_i \quad \text{Var}[S] = \text{Var}[Q]$$

Спектрометрический режим

Tissue Discrimination: Dual-Energy Imaging

High-Energy Image




I^H

Low-Energy Image



I^L



Bone Image



$$\ln(I^{Bone}) = -\ln(I^H) + w_b \ln(I^L)$$

9

Tissue Discrimination: Dual-Energy Imaging

High-Energy Image




I^H

Low-Energy Image



I^L



Soft-Tissue Image



$$\ln(I^{Soft}) = \ln(I^H) - w_s \ln(I^L)$$

10

Существенное увеличение информативности снимка

Уменьшение дозы

Ранняя диагностика рака

Поиск наркотиков, оружия, взрывчатки

Остеоденситометр




Остеоденситометр – самый простой случай реализации технологии, т.к. не нужно высокое координатное разрешение (достаточно 1 мм)

Флюорография – нужно координатное разрешение на уровне 0.1 мм (технически сложно реализовать)




Сцинтиллятор

SiPM

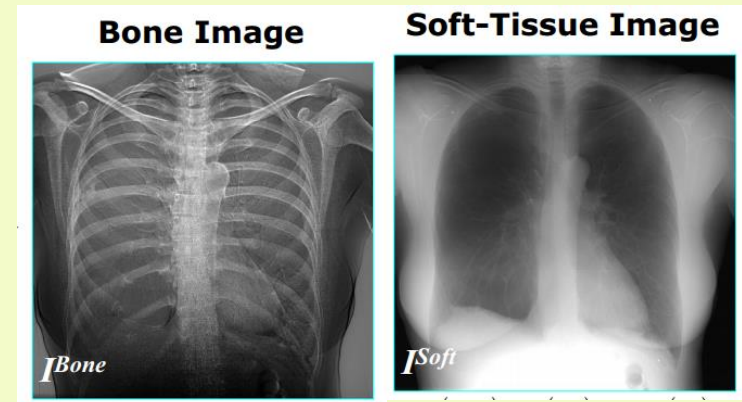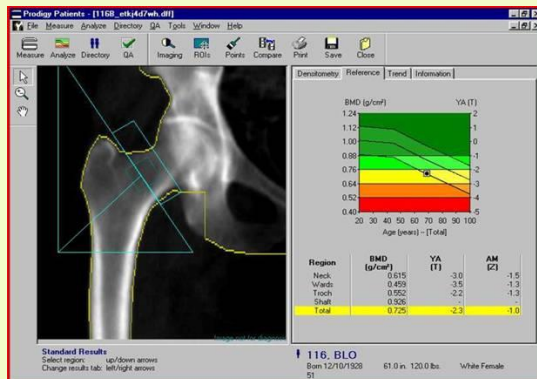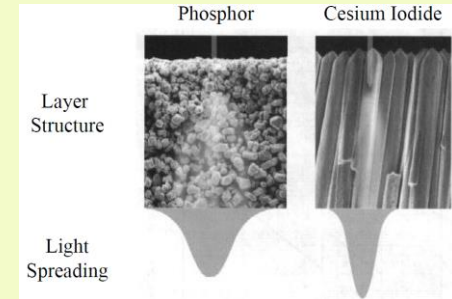


Проблема остеопороза

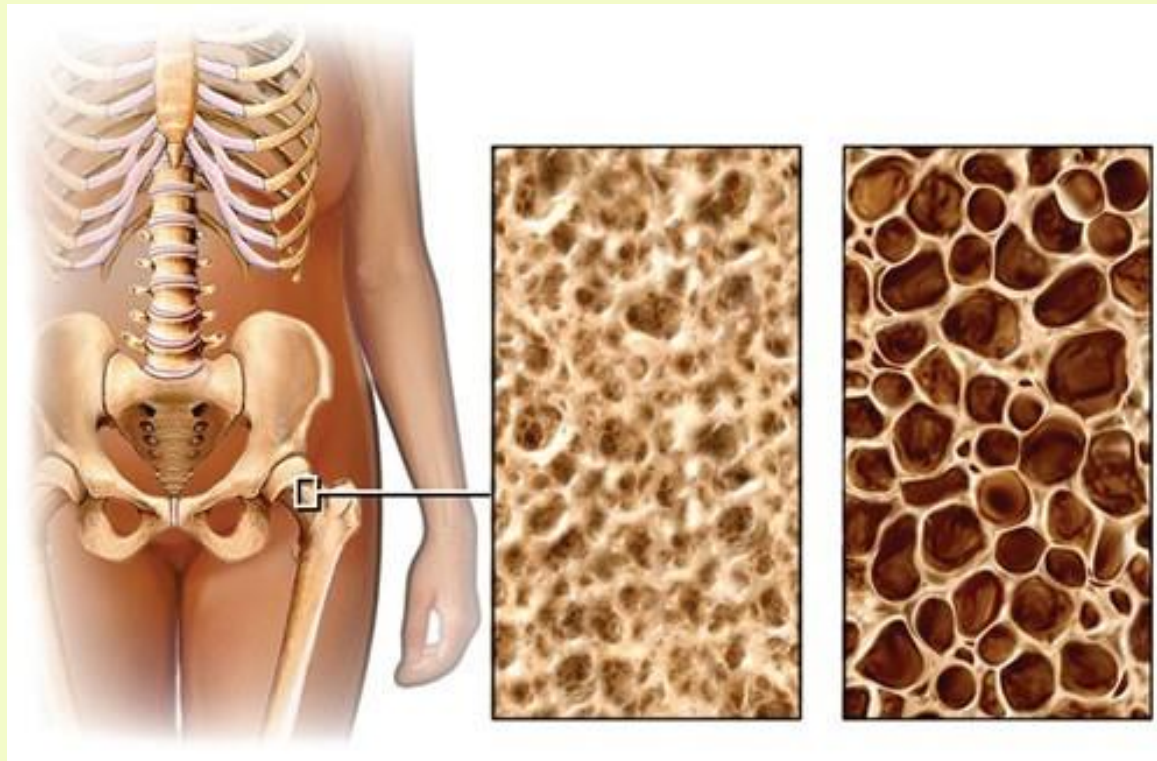

Необходимо создать денситометр, обладающий 1% точностью при дозе облучения не более 10 мкЗв

Принцип работы денситометра (идеальный случай моноэнергий)

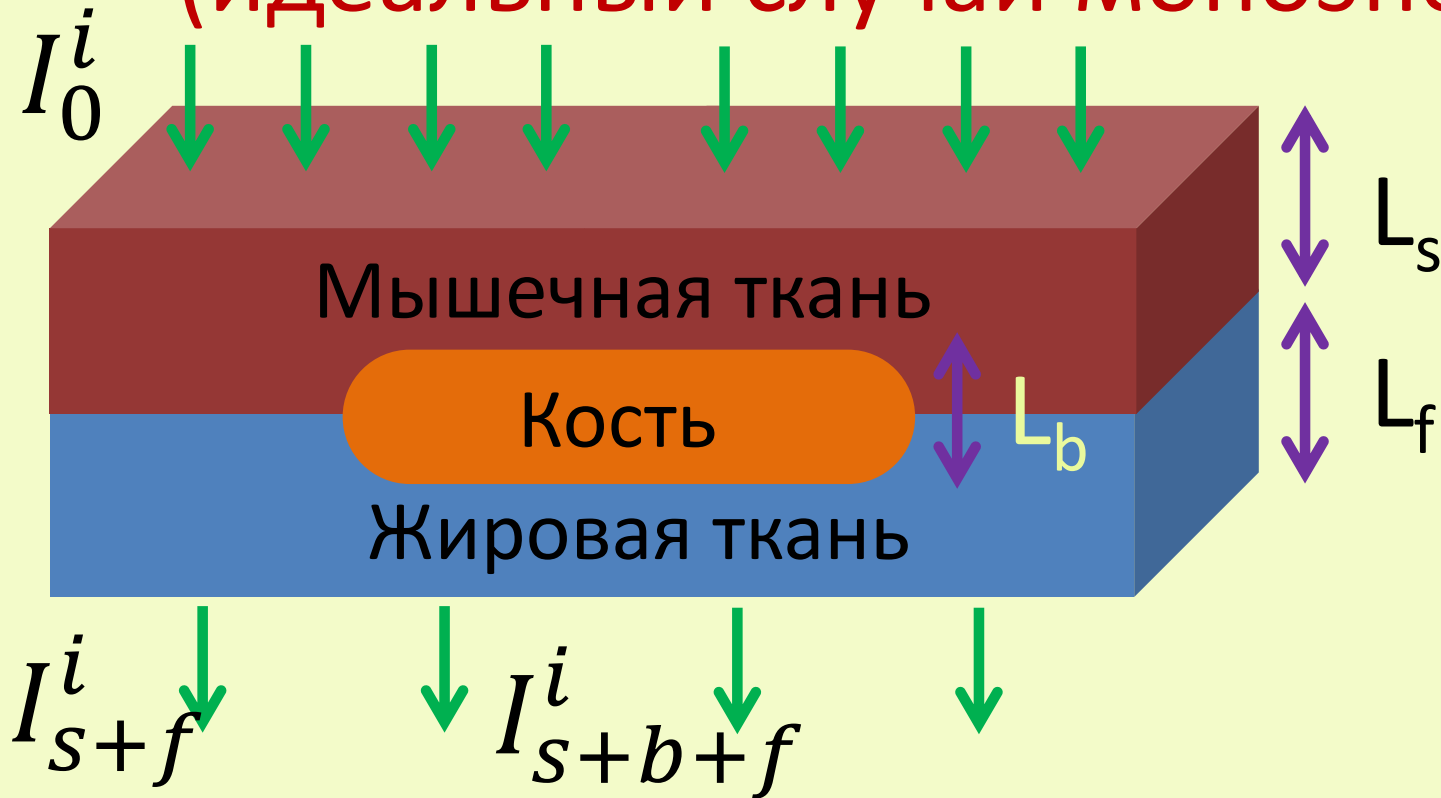


$$T_{s+b}^i = \ln \frac{I_0^i}{I_{s+b}^i}$$

$$\begin{aligned} \rho_s L_s &= \alpha \\ \rho_b L_b &= \beta \end{aligned}$$


$$\begin{cases} T_{s+f}^i = \alpha \mu_s^i + \gamma \mu_f^i \\ T_{s+f}^j = \alpha \mu_s^j + \gamma \mu_f^j \end{cases}$$

Теоретические результаты

Статистическая ошибка

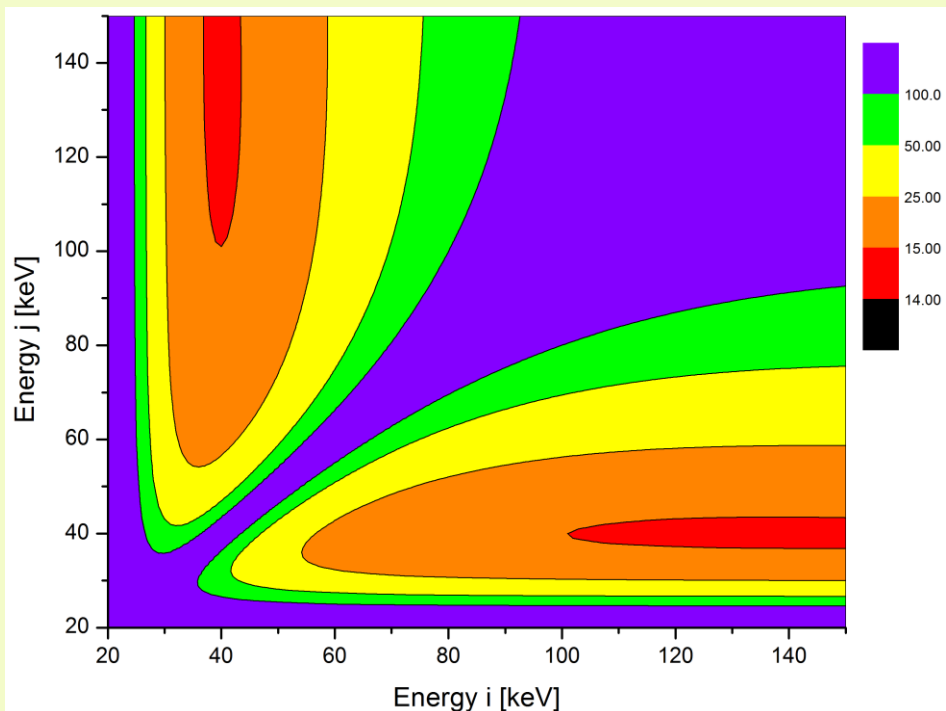

Систематическая ошибка

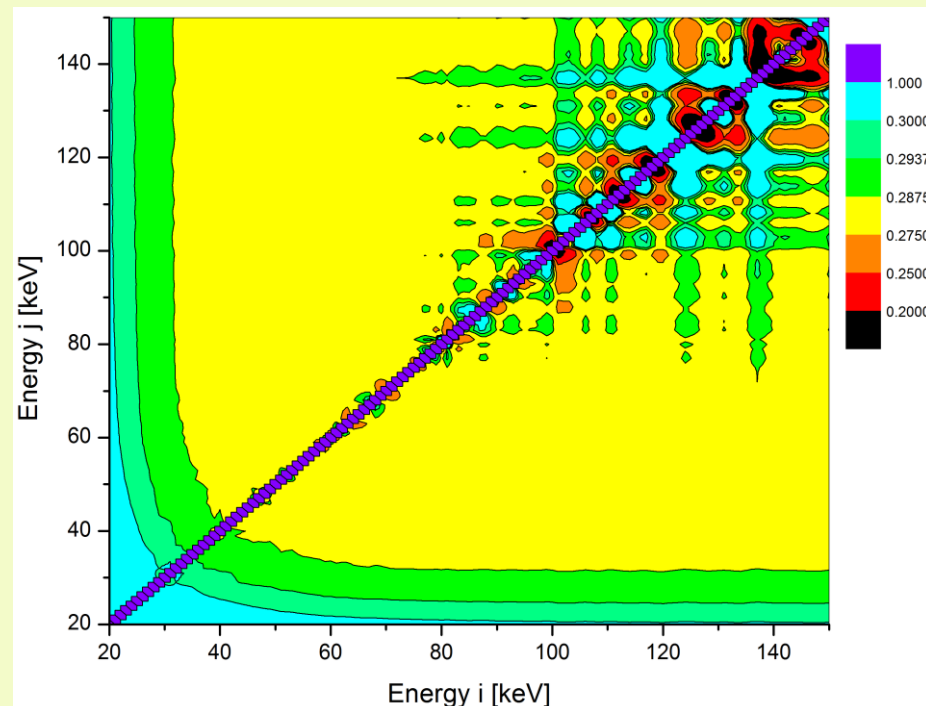

Доза 1 мР, площадь детектора 1 мм². Толщина кости 5 мм, толщина мягких тканей 20 см, 20% жира. Ошибка приведена в %.

Выбор сцинтиллятора

Требования к сцинтиллятору:

- 1) быстрый (~ 50 нс)
- 2) Яркий (~ 30 фот. / кэВ)
- 3) Тяжелый (уменьшение утечек энергии)
- 4) Негигроскопичный (надежность и тех. процесс)
- 5) Радиационная стойкость
- 6) Высокое собственное энергетическое разрешение ($\sim 10\%$)
- 7) Отлаженная технология выращивания (получение нужных размеров)

- LYSO:Ce
- LFS-3
- LGSO:Ce
- YAP:Ce
- LuYAG:Pr

Таких сцинтилляторов совсем немного

Выбор SiPM




Требования:

- 1) Большой динамический диапазон (~ 1000 пикселей на 1 мм²)
- 2) Высокая квантовая эффективность
- 3) Низкий темновой шум
- 4) Малая вероятность crosstalk
- 5) Малая вероятность послеимпульсов
- 6) Стабильность по температуре (?)

- Hamamatsu
- MIFI
- KETEC


Огромный выбор SiPM с разным набором характеристик

Энергетическое разрешение

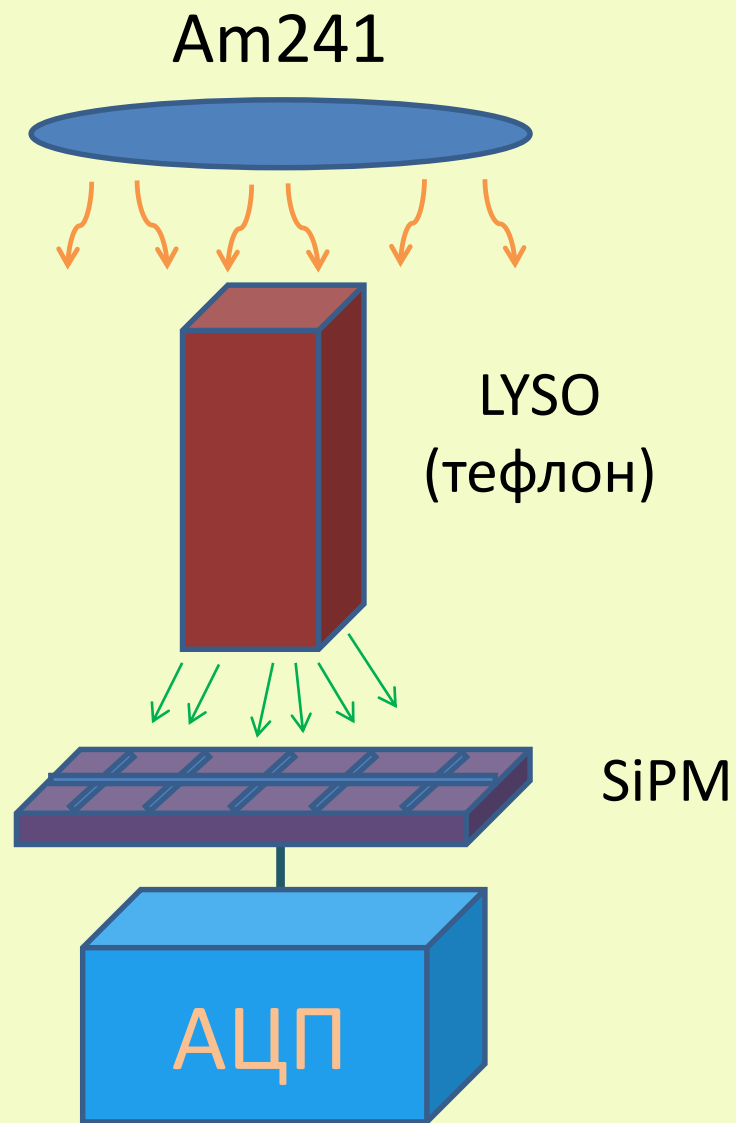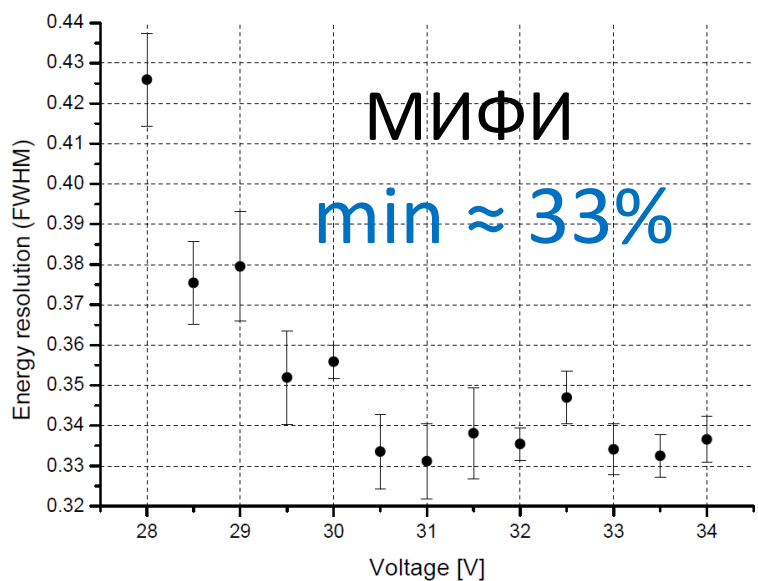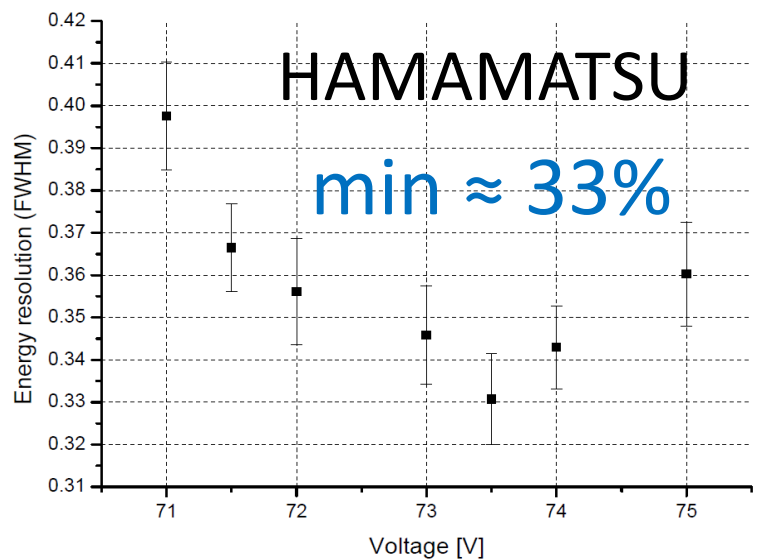


Энергетическое разрешение: факторы

$$\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 \approx \underbrace{\left(\frac{\Delta N}{N}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \chi}{\chi}\right)^2 \frac{1}{N} + \frac{1-\varepsilon}{N\varepsilon\chi}}_{26\%} + \underbrace{\left(\frac{\Delta G}{G}\right)^2 \frac{1}{N\varepsilon\chi}}_{20\%} = (33\%)^2$$

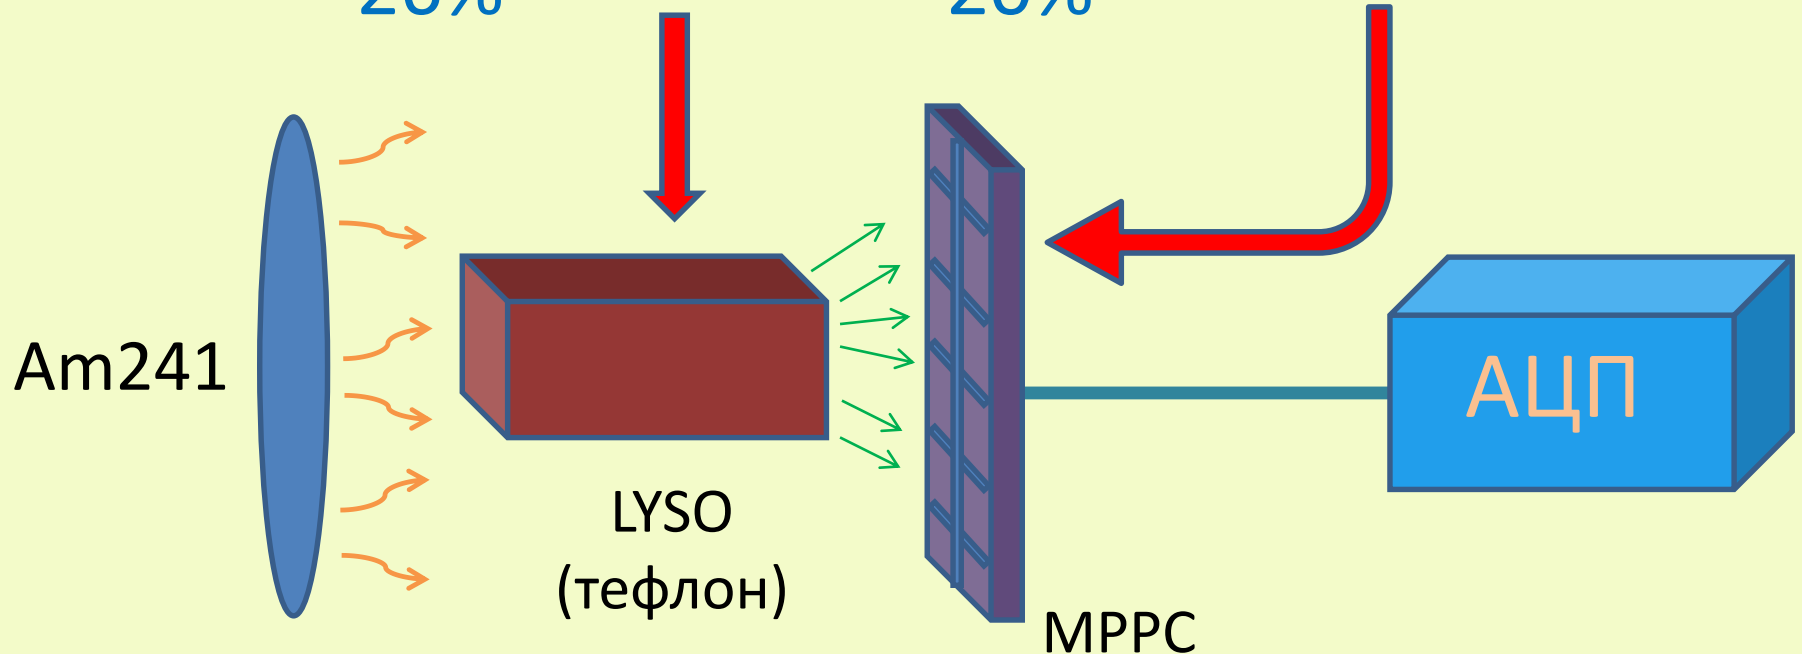

Энергетическое разрешение: факторы

$$\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 = \underbrace{\left(\frac{\Delta N}{N}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \chi}{\chi}\right)^2 \frac{1}{N}}_{26\%} + \underbrace{\frac{1-\varepsilon}{N\varepsilon\chi} + \left(\frac{\Delta G}{G}\right)^2 \frac{1}{N\varepsilon\chi}}_{20\%} = (33\%)^2$$

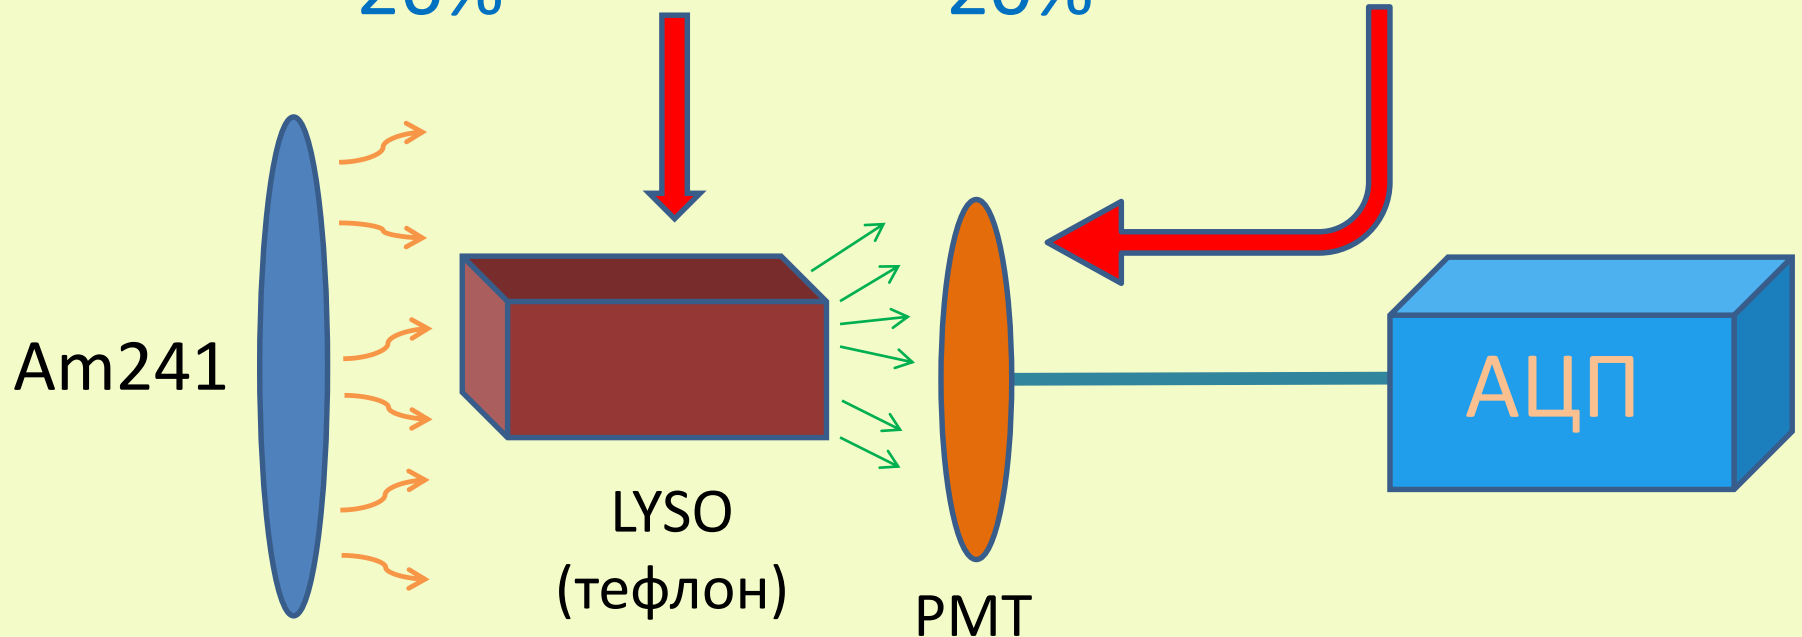

Энергетическое разрешение: доминирующие факторы

$$\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 \approx \left(\frac{\Delta N}{N}\right)^2 + \frac{1 - \varepsilon}{N\varepsilon\chi = N_{p.e.}}$$





Необходимо моделирование!

Выводы:

- 1) важно собственное энергетическое разрешение сцинтиллятора
- 2) важна квантовая эффективность регистрации и число фотоэлектронов
- 3) crosstalk, послеимпульсы и темновые шумы не имеют значения при параметрах существующих SiPM

Экспериментальные характеристики СЦИНТИЛЛЯТОРОВ

Am241 (59.5 кэВ)

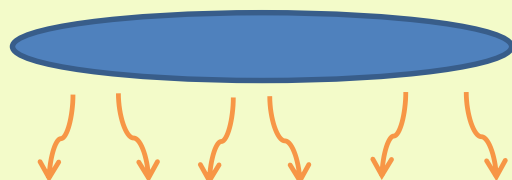

Сцинтиллятор
+ тефлон




ФЭУ

$$FWHM = \frac{Var[Q_{\text{фотопик}}]}{E[Q_{\text{фотопик}}]} * 2.355$$

$$N_{p.e.} = \frac{E[Q_{\text{фотопик}}]}{E[Q_{1e}]}$$

- LYSO:Ce (39 нс)
- LFS-3 (37 нс)
- LGSO:Ce (36 нс)
- YAP:Ce (24 нс)
- LuYAG:Pr (46 нс)

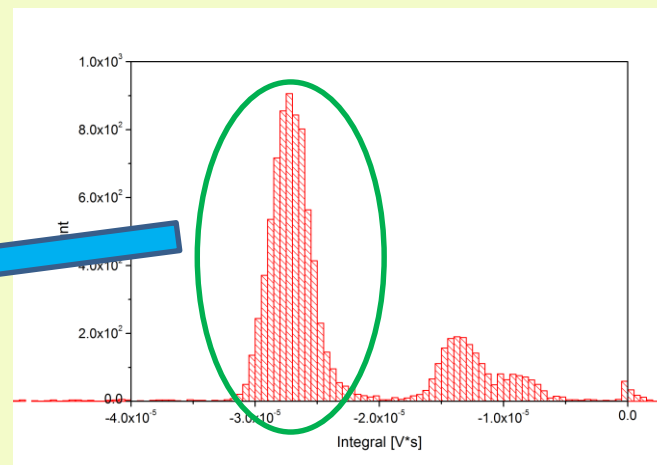

Моделирование светосбора

$$N_{p.e.} = \frac{Q_{\text{фотопик}}}{Q_{1e}} = N_{\text{рожден.}} \chi \varepsilon$$

$\varepsilon = 28\%$ – квантовая эффективность ФЭУ (на возд.)


$\chi = ?$ – светосбор

Свойства кристалла:




- Спектр излучения сцинтиллятора
- Коэф. преломления кристалла
- Длина поглощения света

Свойства поверхности:


- Коэф. отражения
- Коэф. преломления
- Полированность
- Угловая зависимость отраж. света

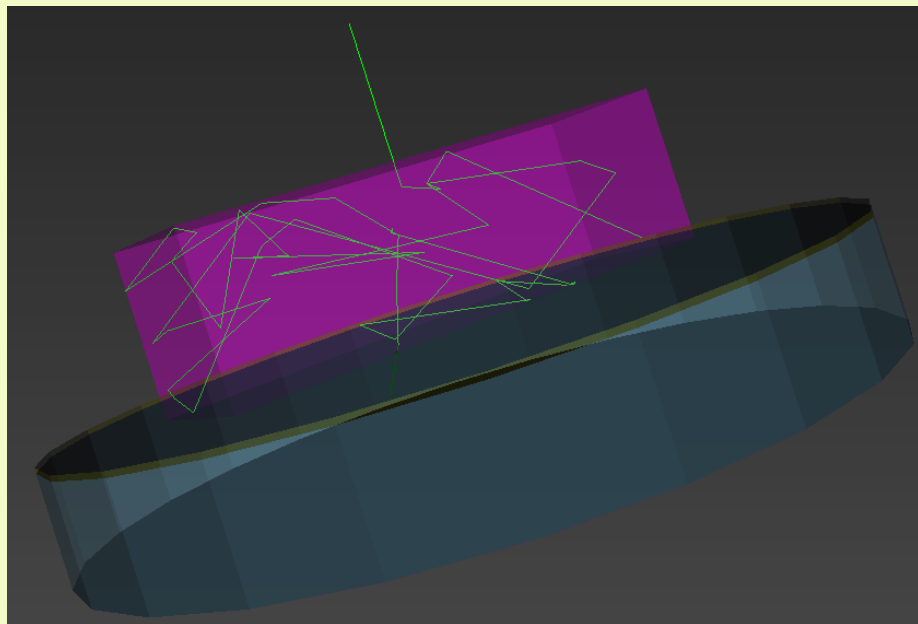


Устранение неоднозначности

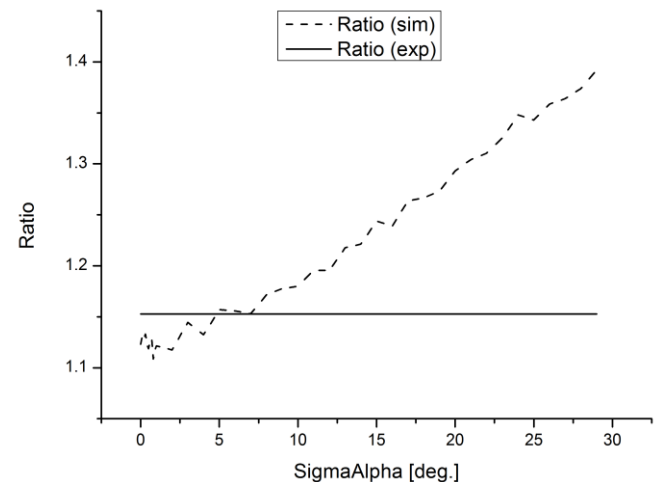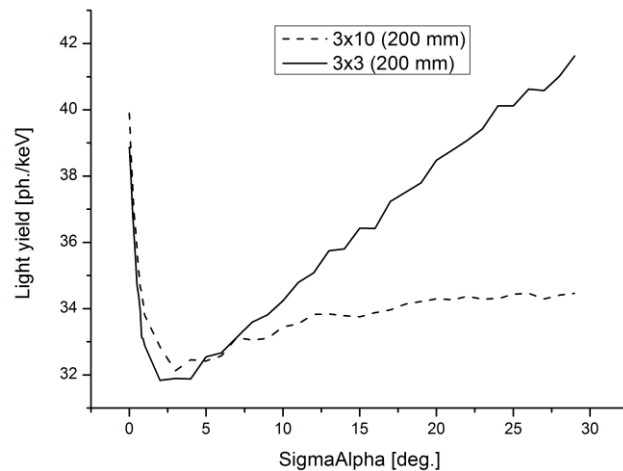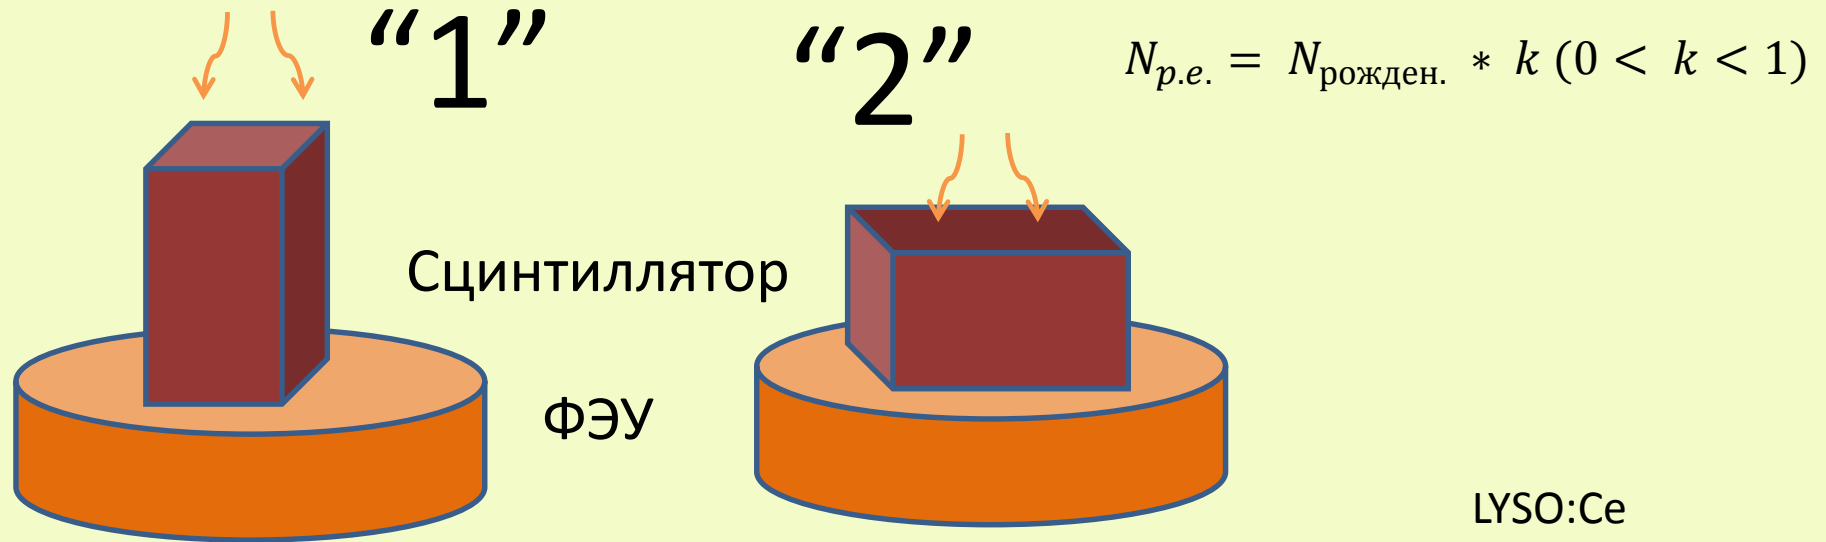

Что есть квантовая эффективность?

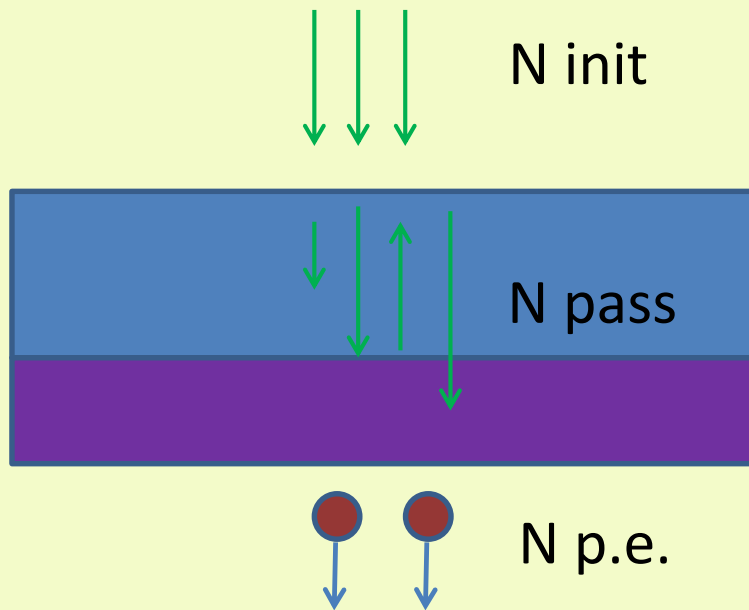


$$\epsilon = N_{p.e.}/N_{init} \approx N_{p.e.}/N_{pass}$$

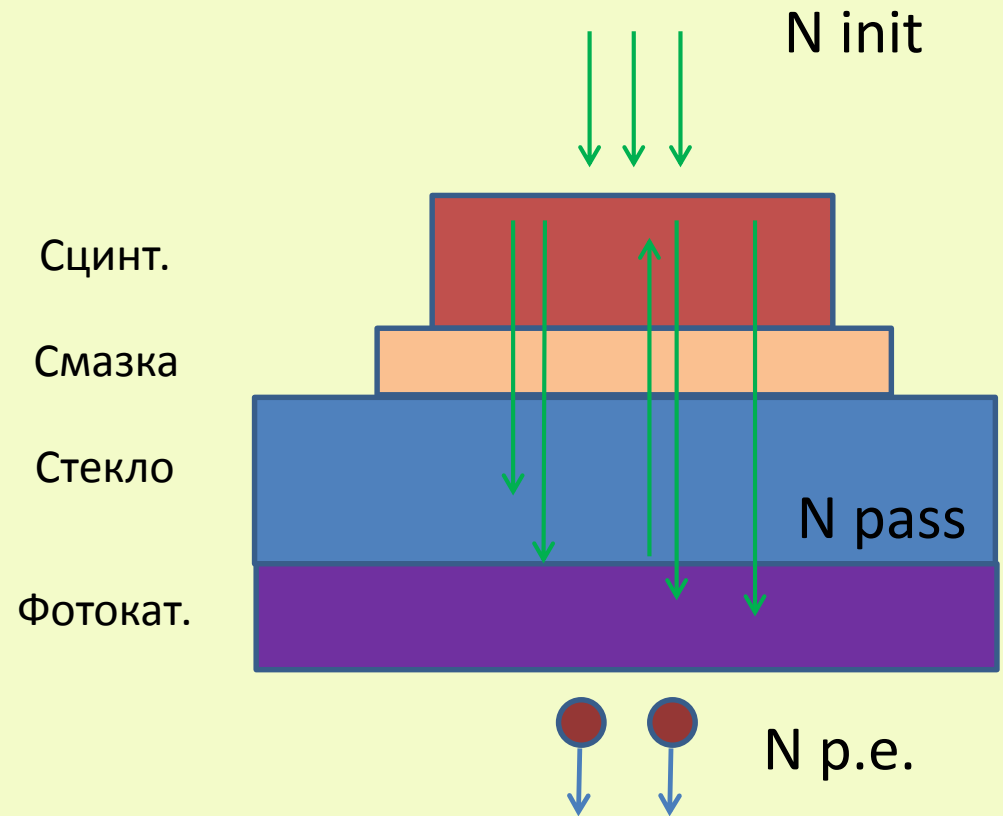

$$\epsilon = N_{p.e.}/N_{init} \neq N_{p.e.}/N_{pass}$$


Прототип детектора

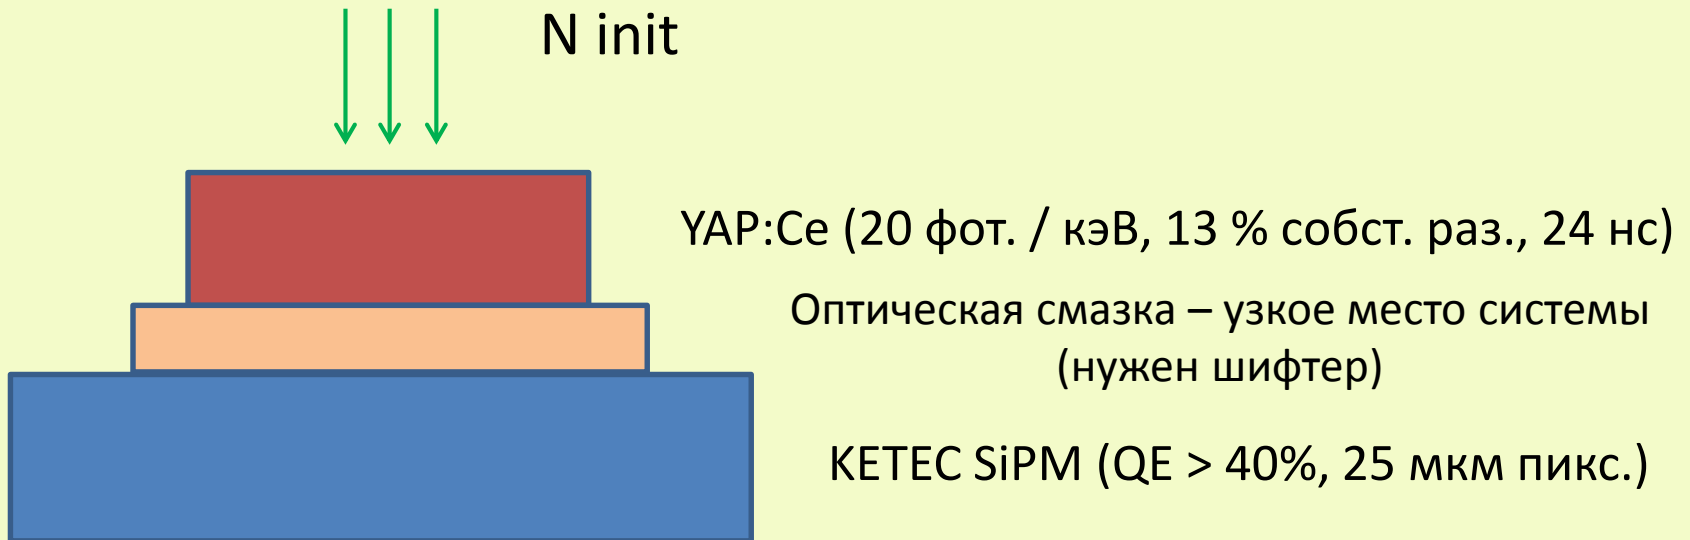

Предельное энергетическое разрешение $\sim 13\%$ (FWHM) при 59.5 кэВ (теор.)


Сейчас – 17% (FWHM)

Измерение спектра излучения рентгеновского источника

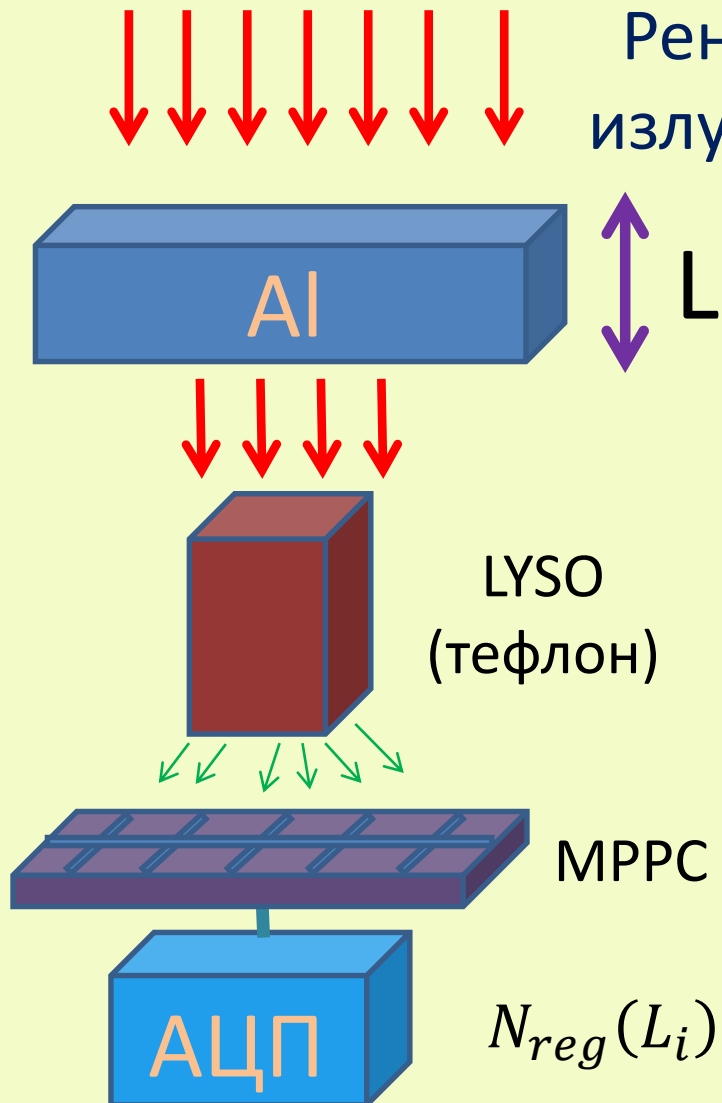


25 различных толщин

$$\sum_{i=1}^n N_{reg}(L_i) - N_{theory}(L_i; L_1, L_2, \dots, L_n) = T$$

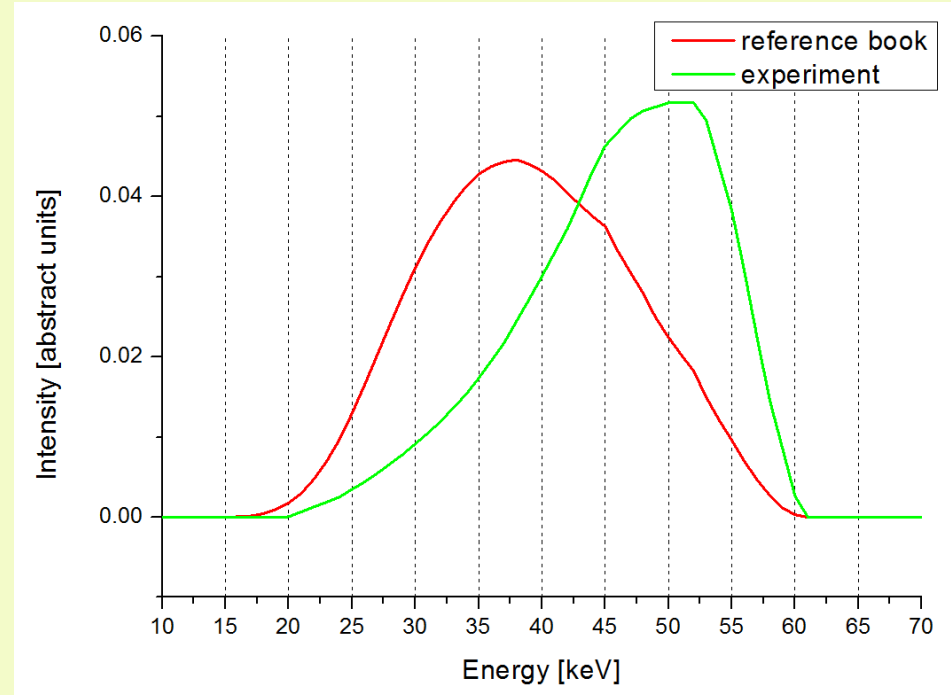

Вычисление толщины (переключение кВ)

$$N_{after} = \int_0^{\infty} N_{before} \cdot f(E) \cdot \exp [-\alpha \mu_{PMMA}(E) - \beta \mu_{Al}(E)] dE$$



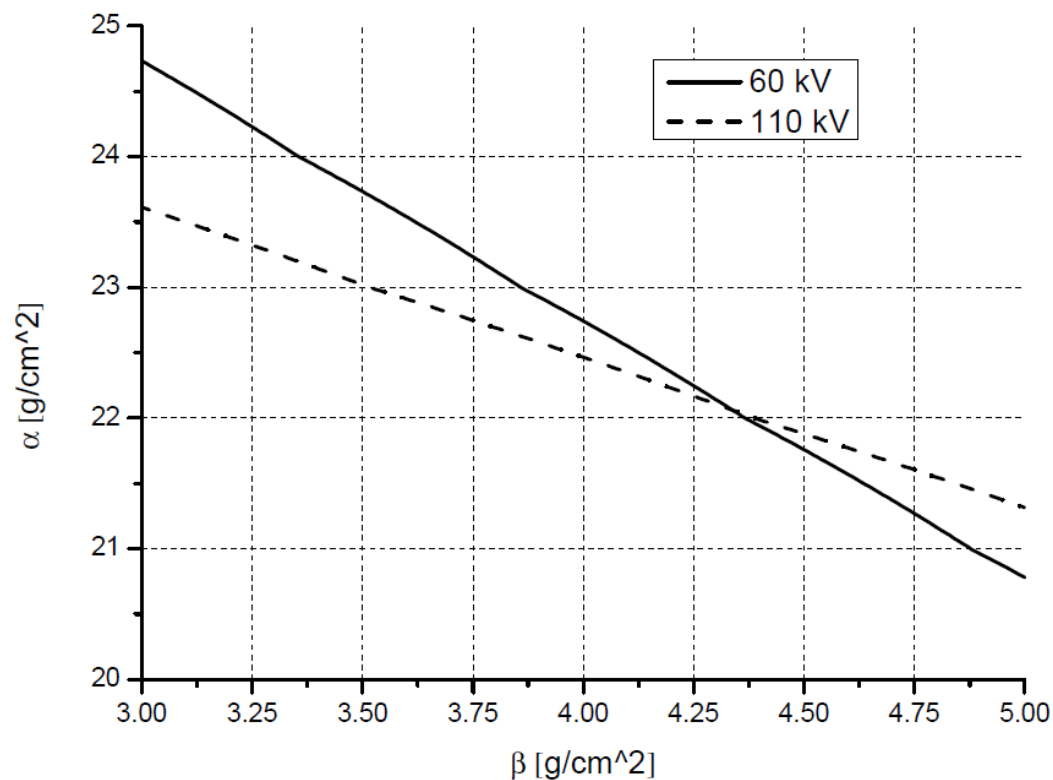


$$\frac{\beta_{measure} - \beta_{real}}{\beta_{real}} = \Delta\beta$$

ПММА - 1.7%

Алюминий - 6.6%

Вычисление толщины (двугорбый спектр)

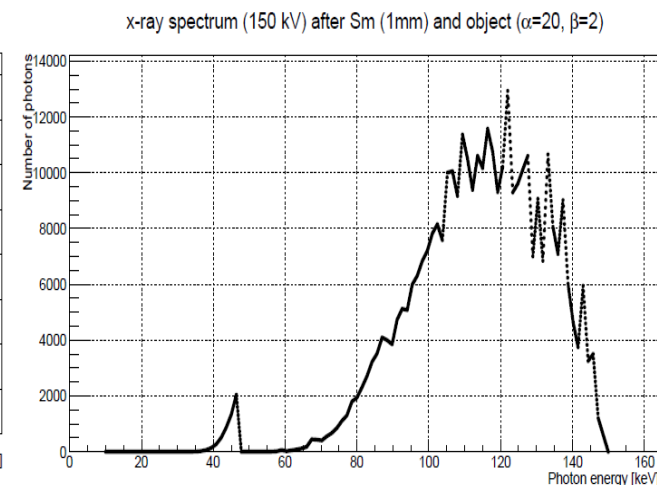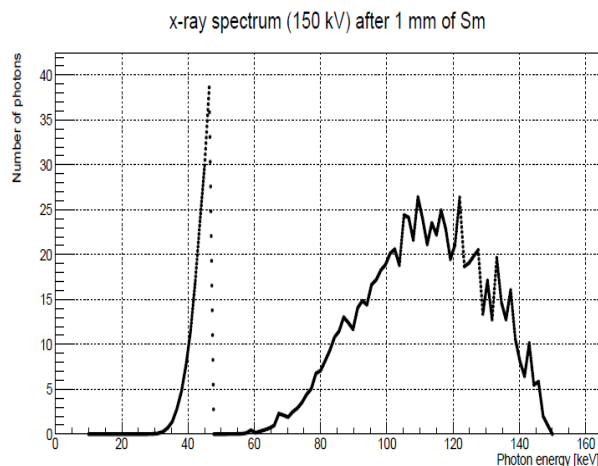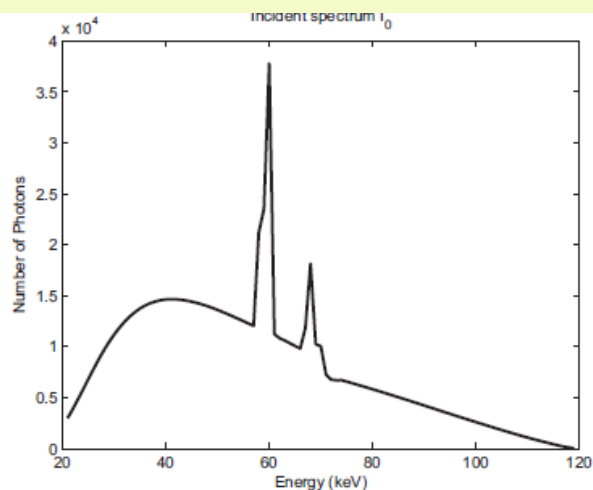

$$\mathcal{L}_P^*(t) = \log f(d | t) = \sum_i (-\gamma_i + d_i \log \gamma_i - \log d_i!).$$

$$\text{Cov}(\hat{t}_i, \hat{t}_j) \approx \sum_k \sum_l \left(\frac{\partial \hat{t}_i}{\partial d_k} \right) \left(\frac{\partial \hat{t}_j}{\partial d_l} \right) \text{Cov}(d_k, d_l)$$

Мощность трубки
Толщина фильтра
Материал фильтра
Оптимальные пороги

Нужно развивать теорию

Заключение

- Используя моделирование в GEANT4, найден светосбор сцинтилляторов и восстановлен их абсолютный световыход.
- Основными факторами, влияющими на энергетическое разрешение детектора, является флуктуации световыхода сцинтиллятора и статистики фотоэлектронов
- Проведены измерения параметров тест-объектов при работе детектора в счетном режиме. Восстановленные значения толщин для ПММА и Al имеют систематическое отклонение от реальных 1.7% и 6.6% соответственно. На данном этапе работы, основная причина отклонения заключается в недостаточной точности прямого измерения толщин калибровочных объектов и недостаточная точность измерения спектров излучения рентгеновского источника.

Планы:

- Собрать одноканальный денситометр и найти оптимальные параметры установки

Спасибо за внимание!

поверхности. (Используя ФЭУ с достаточным диаметром фотокатода и рефлексор, можно достичь значения КС, близкого к τ_v [188].) Значение τ_v вычисляли для некоторых тел правильной геометрической формы. В работе [124] вычислены значения F_a и τ_v для сферы, параллелепипеда и бесконечной пластины, в работе [94] — для цилиндра. Авторы обеих работ исходили из следующих предположений: 1) свет люминесценции (сцинтилляции) не поглощается; 2) тела однородны, изотропны, лишены рассеивающих центров; 3) поверхности идеальны; 4) отношение длины волны света λ к размеру тела настолько мало, что геометрическая оптика применима.

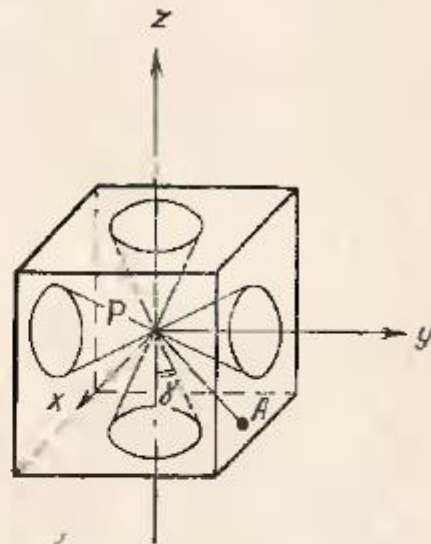


Рис. 6.1. Конусы выхода света из параллелепипеда (изображены 4 из 6 конусов).

Ю. А. ЦИРЛИН

СВЕТОСОБИРАНИЕ В СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ СЧЕТЧИКАХ