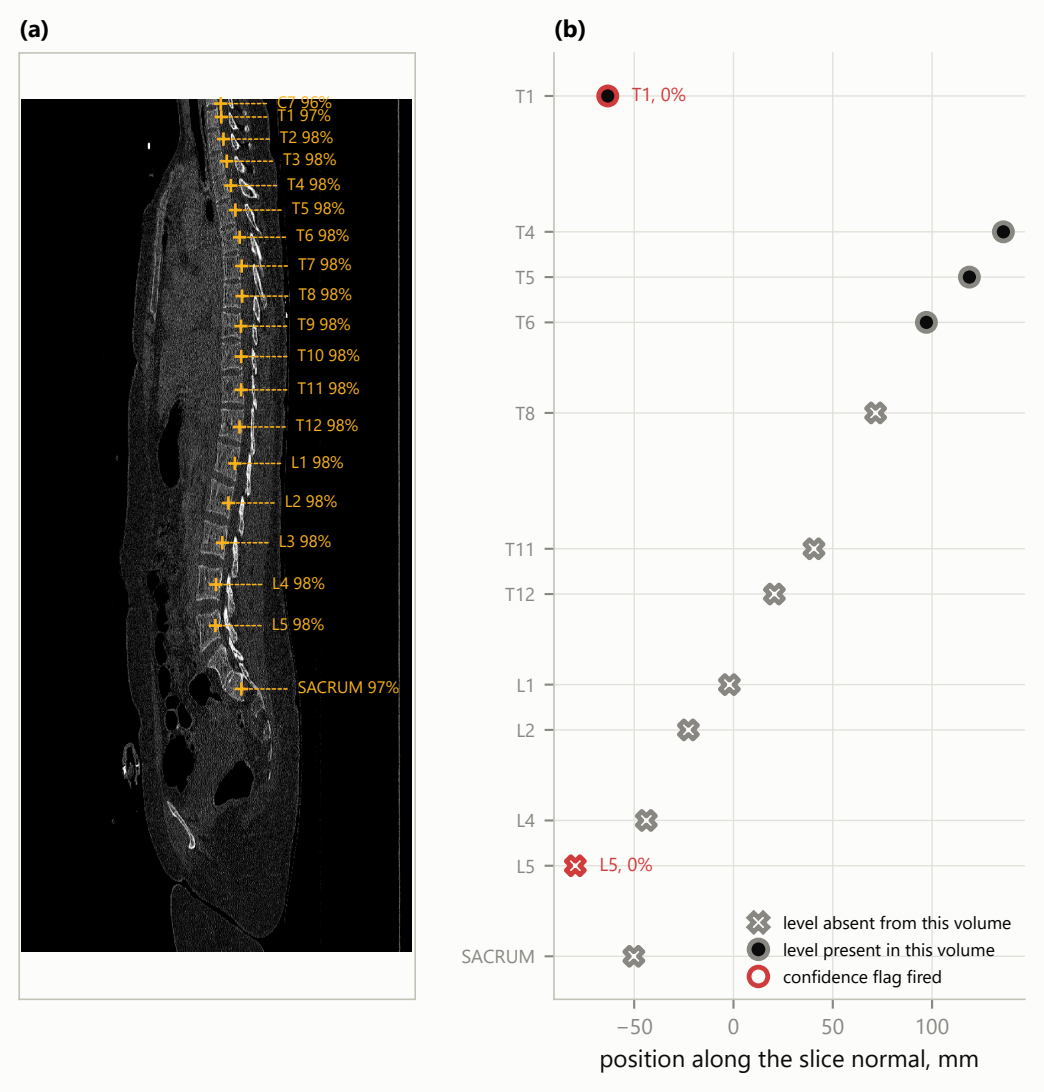

(a)
C7 96%
T1 97%
T2 98%
T3 98%
T4 98%
T5 98%
T6 98%
T7 98%
T8 98%
T9 98%
T10 98%
T11 98%
T12 98%
L1 98%
L2 98%
L3 98%
L4 98%
L5 98%
SACRUM 97%
(b)
T1
T4
T5
T6
T8
T11
T12
L1
L2
L4
L5
SACRUM
T1, 0%
L5, 0%
level absent from this volume
level present in this volume
confidence flag fired
−50
0
50
100
position along the slice normal, mm