



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số giấy chứng nhận/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

1. Khách hàng:
Customer **Công ty TNHH May Alliance One**
Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh
Vĩnh Long, Việt Nam
2. Tên thiết bị:
Instrument **Hộp thử nghiệm xước móc BS 8479**
BS 8479 Snagging Test Box
3. Nhà sản xuất:
Manufacturer **James Heal**
4. Mã quản lý
ID **QV0388113**
5. Kiểu:
Model **CROCKMASTER HD**
6. Số sản xuất:
Serial No. **TM092026**
7. Đặc trưng kĩ thuật
Spectification Phạm vi đo:
Range **Kích thước/ Dimension: 228 mm**
Góc nghiêng/ Angle: 60 °
8. Quy trình thực hiện
Procedure **LINEAR-05:2026**
ANGLE-01:2026
9. Tiêu chuẩn tham khảo
Reference Standard **BS 8479**
11. Nơi thực hiện:
Place of Performance **Công ty TNHH May Alliance One**
Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh
Vĩnh Long, Việt Nam
12. Ngày thực hiện:
Date of performance **25/06/2026**
13. Ngày thực hiện tiếp theo:
Date of next performance **25/06/2027**
14. Điều kiện môi trường:
Environment Nhiệt độ: **[22 ± 1] °C**
Temperature Độ ẩm: **[65 ± 1] %RH**
Humidity
15. Chuẩn sử dụng / *Standards Used* :

Tên thiết bị <i>Name of Standard</i>	Số quản lý <i>ID</i>	Số chứng nhận <i>Certificate No.</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceable to</i>	Hiệu lực <i>Due date</i>
Calipers	LAB-CALIPER.01			
Angle meter	LAB-ANGLE.01			

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN
HEAD OF CALIBRATION LAB.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Lê Cảnh Nhật Quang

Lưu Ngọc Thống



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG

CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số giấy chứng nhận/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

16. Kết quả/ Results:

Thông số Parameter		Giá trị đo được As found value	ĐKĐBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerane	Kết luận Consulution
Khoảng cách hai mặt song song ^(M) Diameter between opposite parallel faces (mm)	1-4		0.02	224.5	± 0.3	A
	2-5		0.02	224.5	± 0.3	A
	3-6		0.02	224.5	± 0.3	A
Chiều sâu của hộp ^(M) Depth of snagging box (mm)			0.02	228	± 0.3	A
Góc nghiêng của đỉnh ^(M) Inclined Angle of pins (°)	Pin bar 1	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 2	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 3	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 4	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 5	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 6	60.2	0.2	60	± 0.5	A
Chiều cao của đầu đỉnh ^(M) Point end of pins (mm)	Pin bar 1	1.51	0.02	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 2	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 3	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 4	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 5	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 6	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
Khoảng cách giữa các đỉnh ^(M) Space between pins (mm)	Pin bar 1	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 2	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 3	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 4	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 5	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 6	10.02	0.05	10	± 0.5	A



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số giấy chứng nhận/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

Thông số Parameter		Giá trị đo được As found value	ĐKĐBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerane	Kết luận Conslution
Số đinh trên mỗi thanh Number of pins on pin bar	Pin bar 1	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 2	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 3	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 4	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 5	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 6	20	0.1	20	± 1.0	A




GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG


CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số giấy chứng nhận/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

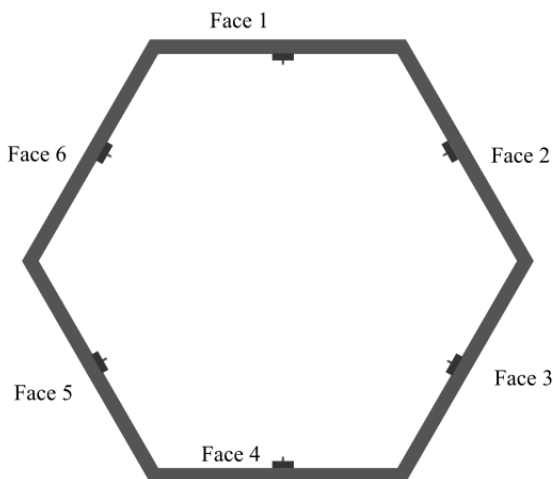

Mặt cắt ngang của hộp/
Sectional view of test chamber

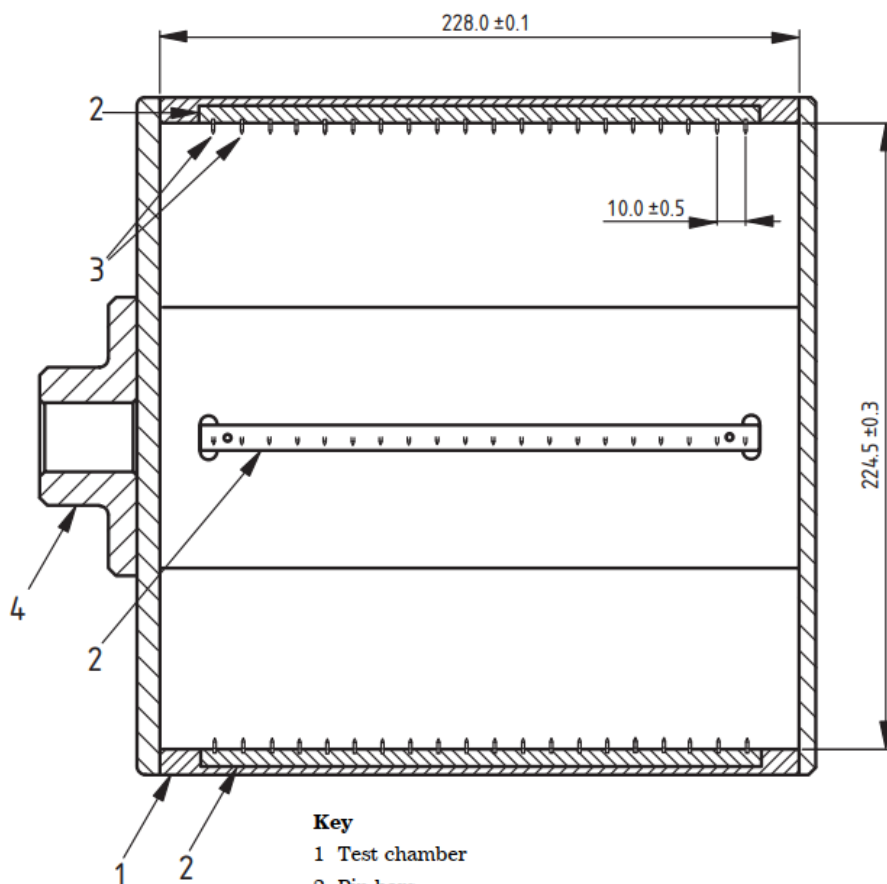

Key


- 1 Test chamber
 - 2 Pin bars
 - 3 Pins
 - 4 Device for rotating the test chamber
- a) Sectional view of test chamber



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số giấy chứng nhận/Certificate No: **345189**


Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

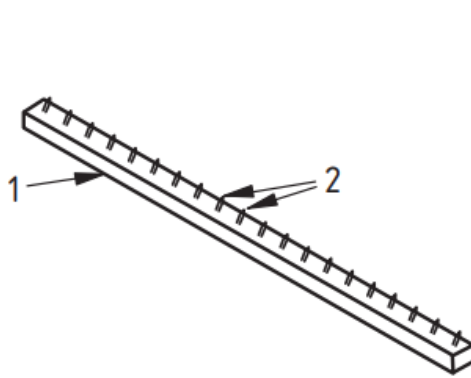

Key

- 1 Pin bar
- 2 Pins

b) Isometric view of a pin bar

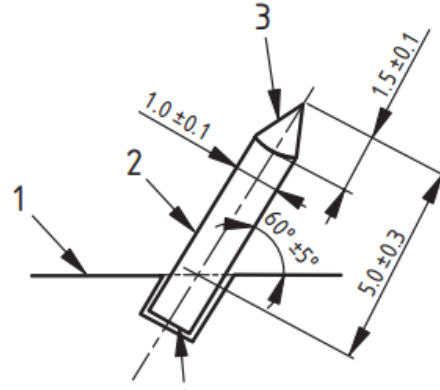

Key

- 1 Surface of pin bar
 - 2 Pin
 - 3 Pointed end of pin
 - 4 Flat end of pin fitted into blind hole in pin bar
- c) Detailed view of a pin

17. Thông tin khác/ Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy/ The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

+ **A:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.

+ **B:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.

+ **C:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này.

The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.

+ **D:** Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo.

There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.

17.3 Khác/ Other:

Các thông số được đánh dấu (*) là không đạt công nhận ISO/IEC 17025

The characteristics marked with (*) are not accredited to comply with ISO/IEC 17025

Các thông số đánh dấu ^(C) là kết quả hiệu chuẩn, các thông số đánh dấu ^(M) là kết quả đo thử nghiệm

The characteristics marked with ^(C) are results of calibration, ^(M) are results of measurement

Giấy chứng nhận này không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LabMaster./ This form shall not be reproduced, without the expressed written consent of LabMaster.

Phương tiện đo này không được để sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

This instrument do not used for quantifying goods, service in trading, payment, safety assurance, social healthcare, protecting the enviroment, inspection law and in other public service activities. This instrument shall not be used directly for the verification of group 2 instruments.

Chứng chỉ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc phép đo theo các tiêu chuẩn quốc gia được công nhận hoặc các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia được công nhận khác./This certificate provides tracerbility of measurement to recognised national standards or orther national standards laboratories.