



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000006 Ngày cấp/Date of issue: 29/08/2026

1. Khách hàng: Customer	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAEYOUNG TEXTILE VIỆT NAM Phân khu 6A, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch VI, Xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam			
2. Tên thiết bị: Instrument	Hộp thử xước móc Snagpod Snagpod			
3. Nhà sản xuất: Manufacturer	James Heal	5. Kiểu: Model	CROCKMASTER HD	
4. Mã quản lý ID	EQ-000015	6. Số sản xuất: Serial No.	TM092026	
7. Đặc trưng kĩ thuật Spectification	Phạm vi đo: Range	Độ phân giải: Resolution	8. Quy trình thực hiện Procedure	9. Tiêu chuẩn tham khảo Reference Standard
	228 mm 60 °	-----	LINEAR-05:2026	BS
		-----	ANGLE-01:2026	8479

11. Nơi thực hiện: Place of Performance	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAEYOUNG TEXTILE VIỆT NAM Phân khu 6A, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch VI, Xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam			
12. Ngày thực hiện: Date of performance	29/08/2026		13. Ngày thực hiện tiếp theo: Date of next performance	25/06/2027
14. Điều kiện môi trường: Environment	Nhiệt độ: Temperature	[25 ± 2] °C	Độ ẩm: Humidity	[63 ± 5] %RH
15. Chuẩn sử dụng / Standards Used :				
Tên thiết bị Name of Standard	Số quản lý ID	Số chứng nhận Certificate No.	Liên kết chuẩn Traceable to	Hiệu lực Due date
	LAB-CALIPER.01			
	LAB-ANGLE.01			

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN
HEAD OF CALIBRATION LAB.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Lê Cảnh Nhật Quang

Lưu Ngọc Thống



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000006 Ngày cấp/Date of issue: 29/08/2026

16. Kết quả/ Results:

Thông số Parameter		Giá trị đo được As found value	ĐKĐBBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerane	Kết luận Conslution
Khoảng cách hai mặt song song ^(M) Diameter between opposite parallel faces (mm)	1-4		0.02	224.5	± 0.3	A
	2-5		0.02	224.5	± 0.3	A
	3-6		0.02	224.5	± 0.3	A
Chiều sâu của hộp ^(M) Depth of snagging box (mm)			0.02	228	± 0.3	A
Góc nghiêng của đỉnh ^(M) Inclined Angle of pins (°)	Pin bar 1	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 2	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 3	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 4	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 5	60.2	0.2	60	± 0.5	A
	Pin bar 6	60.2	0.2	60	± 0.5	A
Chiều cao của đầu đỉnh ^(M) Point end of pins (mm)	Pin bar 1	1.51	0.02	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 2	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 3	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 4	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 5	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
	Pin bar 6	1.51	0.05	1.5	± 0.1	A
Khoảng cách giữa các đỉnh ^(M) Space between pins (mm)	Pin bar 1	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 2	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 3	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 4	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 5	10.02	0.05	10	± 0.5	A
	Pin bar 6	10.02	0.05	10	± 0.5	A



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT


Số GCN/Certificate No: 000006 Ngày cấp/Date of issue: 29/08/2026

Thông số Parameter		Giá trị đo được As found value	ĐKĐBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerane	Kết luận Conslution
Số đinh trên mỗi thanh Number of pins on pin bar	Pin bar 1	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 2	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 3	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 4	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 5	20	0.1	20	± 1.0	A
	Pin bar 6	20	0.1	20	± 1.0	A



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000006 Ngày cấp/Date of issue: 29/08/2026


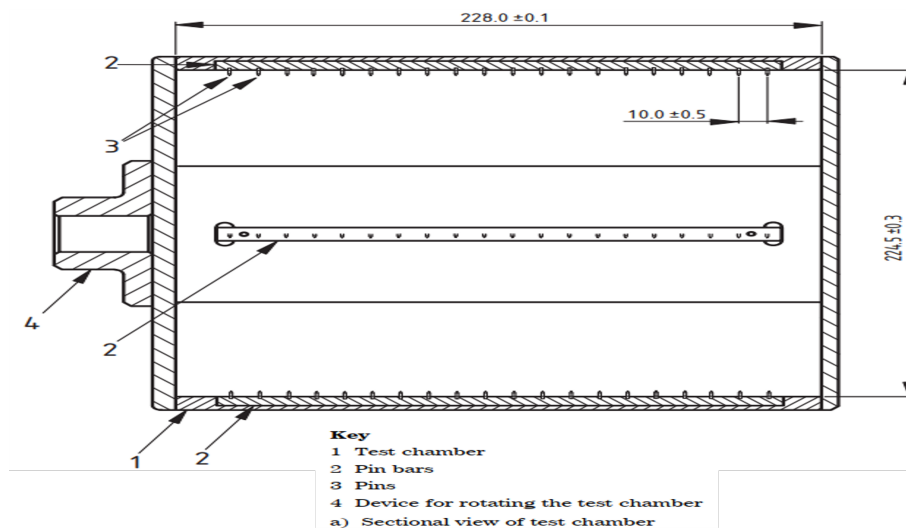


Mặt cắt ngang của hộp/
Sectional view of test chamber




GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000006 Ngày cấp/Date of issue: 29/08/2026

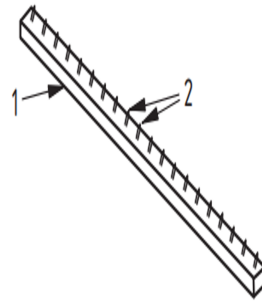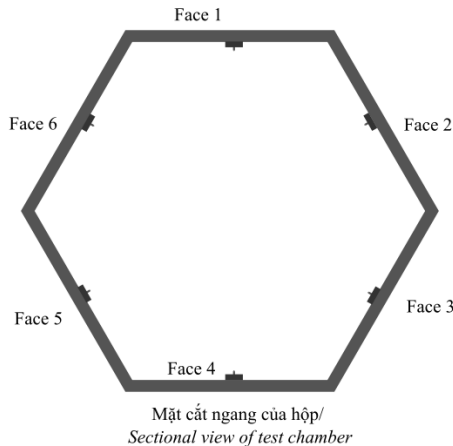

Key
1 Pin bar
2 Pins
b) Isometric view of a pin bar

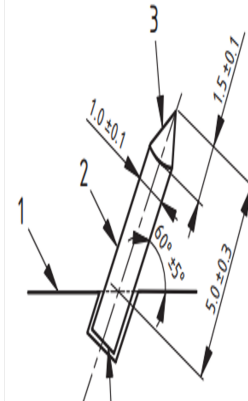

Key
1 Surface of pin bar
2 Pin
3 Pointed end of pin
4 Flat end of pin fitted into blind hole in pin bar
c) Detailed view of a pin

Ghi chú/ Note:

- * Đánh giá theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/ Acceptance limit base on Manufactuter's specitifications.
- * Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng/ Acceptance limit base on Customer request.

17. Thông tin khác/Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo/ Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy/

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2. Công bố về sự phù hợp/ Statements of conformity:

+ A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.

+ B: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.

+ C: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này.

The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.

+ D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo.

There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.

17.3 Khác/ Other:

Các thông số được đánh dấu (*) là không đạt công nhận ISO/IEC 17025

The characteristics marked with () are not accredited to comply with ISO/IEC 17025*

Các thông số đánh dấu (C) là kết quả hiệu chuẩn, các thông số đánh dấu (M) là kết quả đo thử nghiệm

The characteristics marked with (C) are results of calibration, (M) are results of measurement

Giấy chứng nhận này không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LabMaster./ This form shall not be reproduced, without the expressed written consent of LabMaster.

Phương tiện đo này không được để sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

This instrument do not used for quantifying goods, service in trading, payment, safety assurance, social heathcare, protecting the enviroment, inspection law and in other public service activities. This instrument shall not be used directly for the verification of group 2 instruments.

Chứng chỉ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc phép đo theo các tiêu chuẩn quốc gia được công nhận hoặc các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia được công nhận khác./This certificate provides tracerbility of measurement to recognised national standards or orther national standards laboratories.