



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 0)

1. Titreşim Zaman Serisi

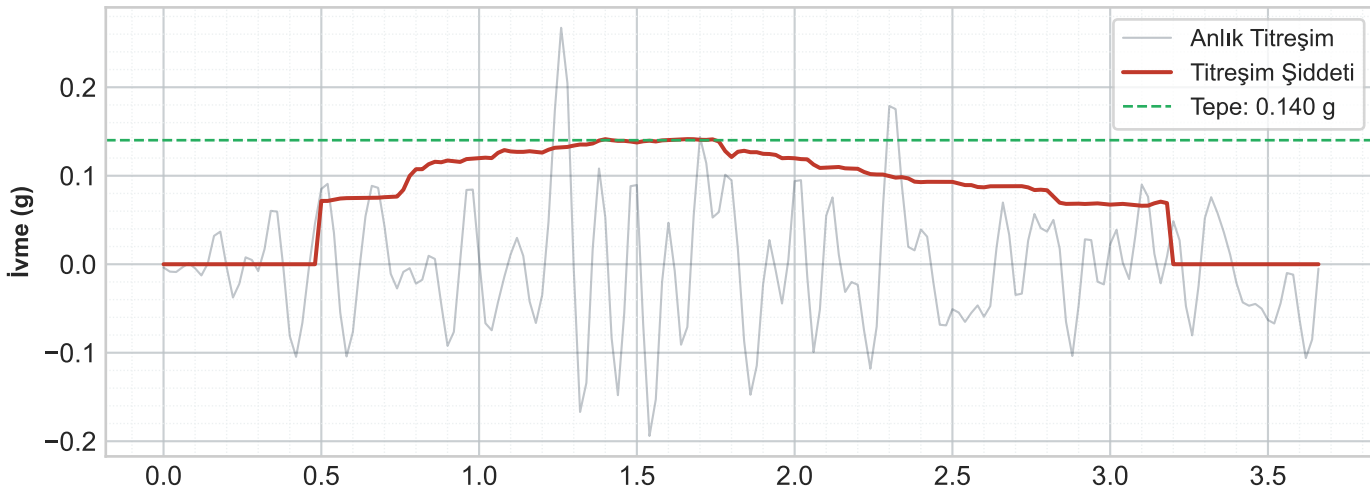

2. Frekans Analizi

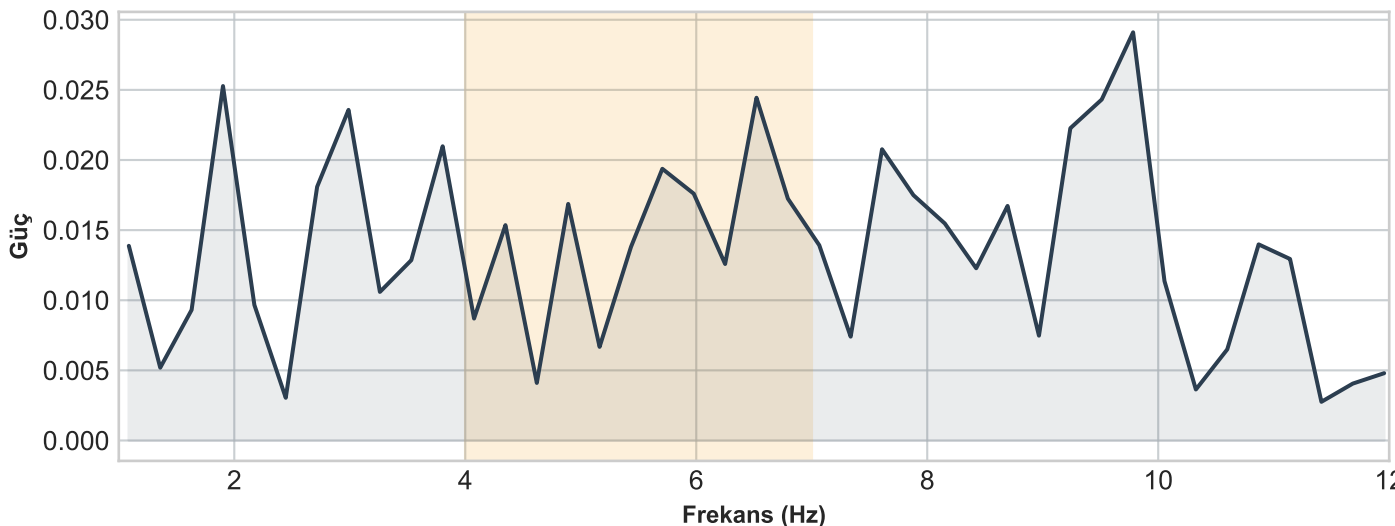

TIBBİ TANII: NORMAL - Fizyolojik Titreme (9.8 Hz)

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 9.8 Hz

DURGUNLUK



TİTREME ŞİDDETİ



UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.