



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 0)

1. Titreşim Zaman Serisi

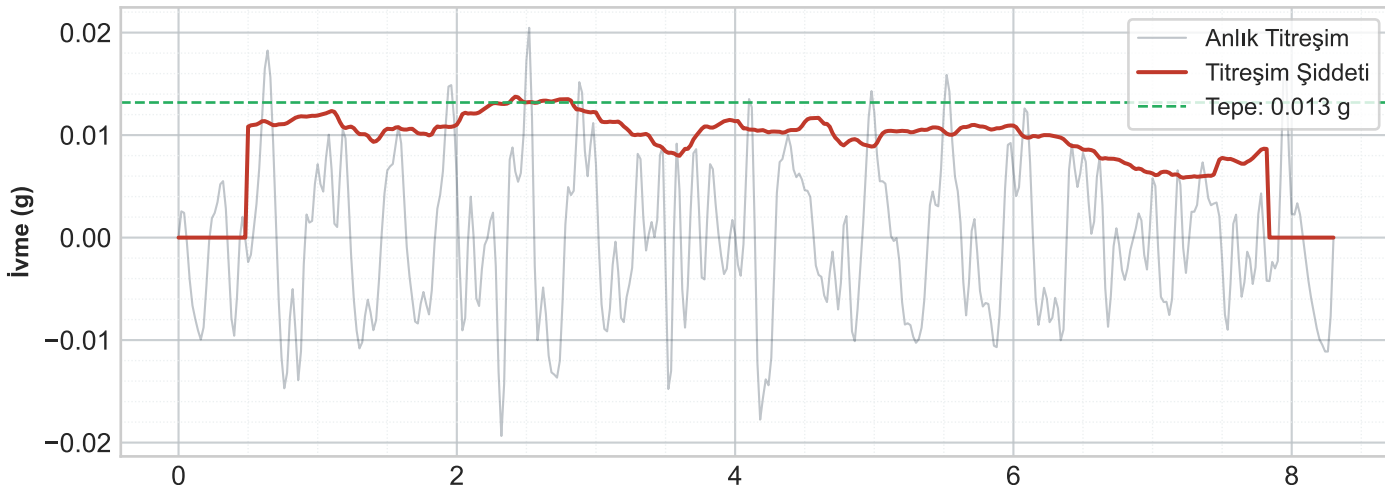

2. Frekans Analizi

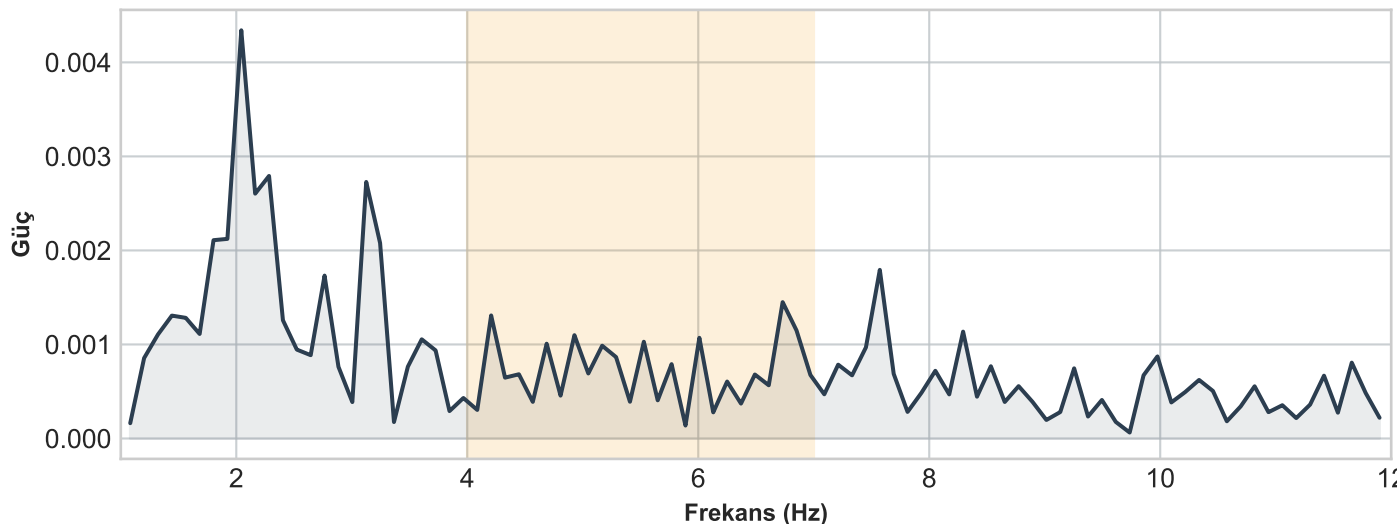

TIBBİ TANI: NORMAL - İstemli Hareket (2.0 Hz)

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 2.0 Hz

DURGUNLUK

%91

TİTREME ŞİDDETİ

%4

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.