


MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 3) - PARKİNSON TİPİ BULGU

1. Titreşim Zaman Serisi



2. Frekans Analizi

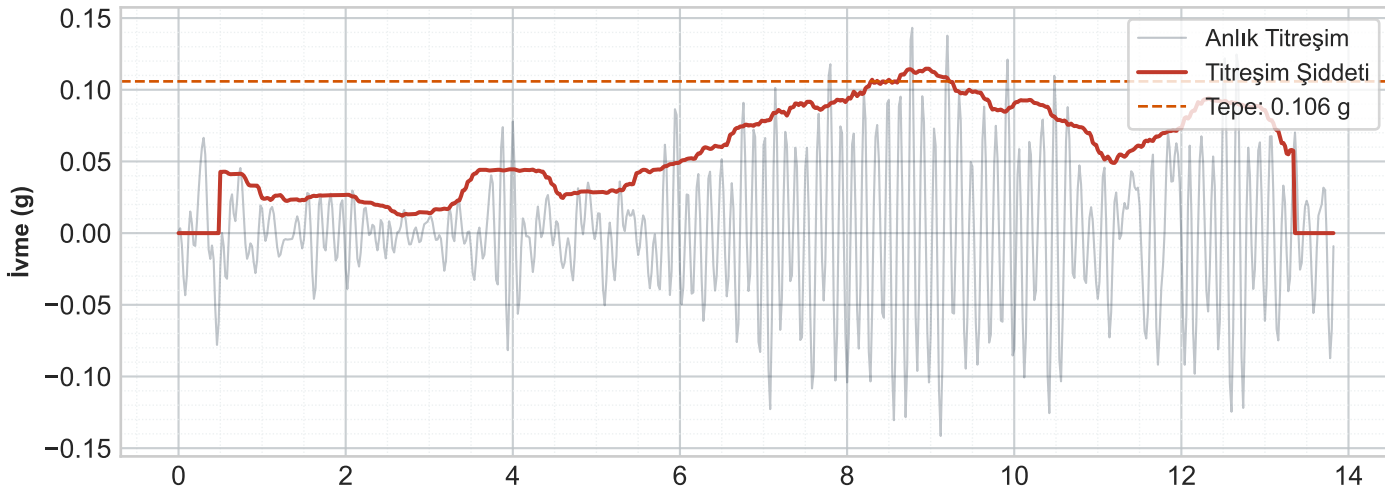

TIBBİ TANİ: ORTA-CİDDİ (3) - (6.9 Hz)
ÖNEMLİ: Titreme frekansı Parkinson (4-7 Hz) ile uyumludur.

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 6.9 Hz

DURGUNLUK



%29

TİTREME ŞİDDETİ



%35

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.