



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 0)

1. Titreşim Zaman Serisi

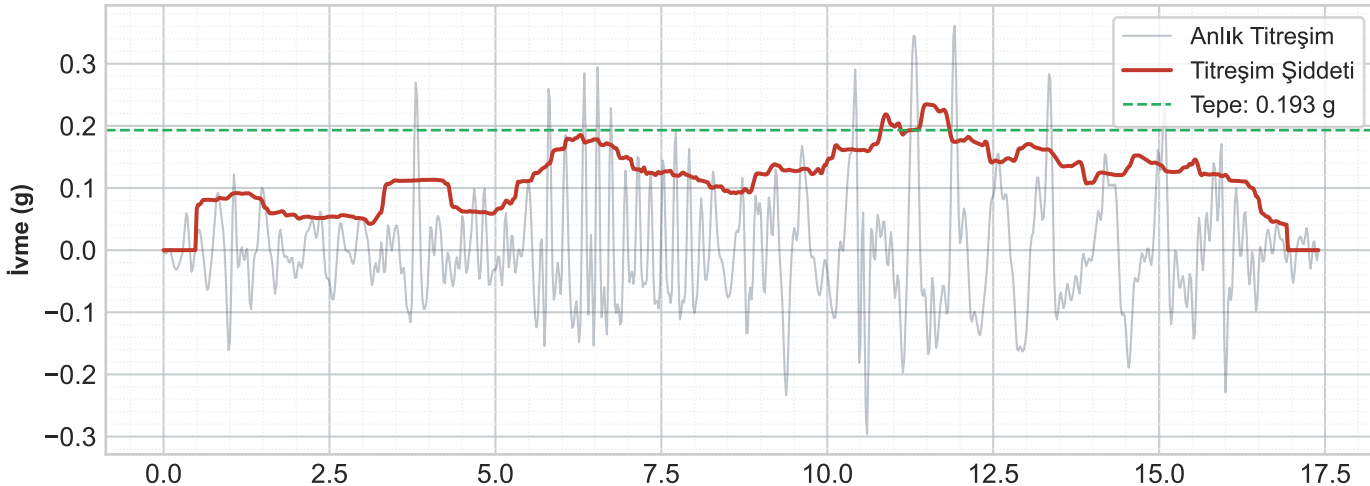

2. Frekans Analizi

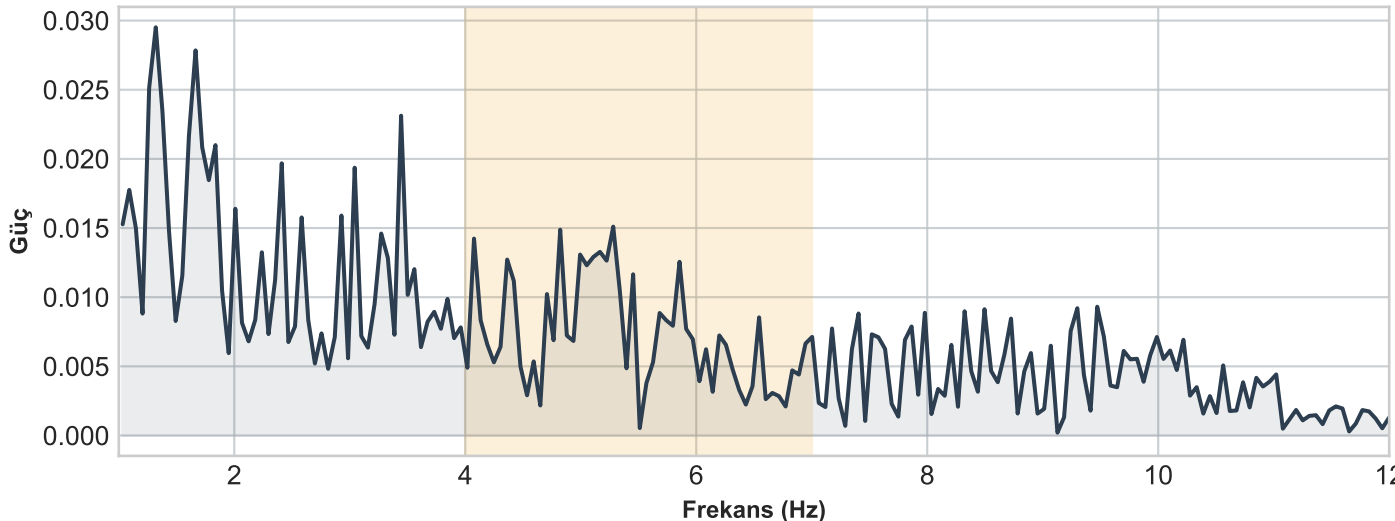

TIBBİ TANİ: NORMAL - İstemli Hareket (1.3 Hz)

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 1.3 Hz

DURGUNLUK

%0

TİTREME ŞİDDETİ

%64

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.