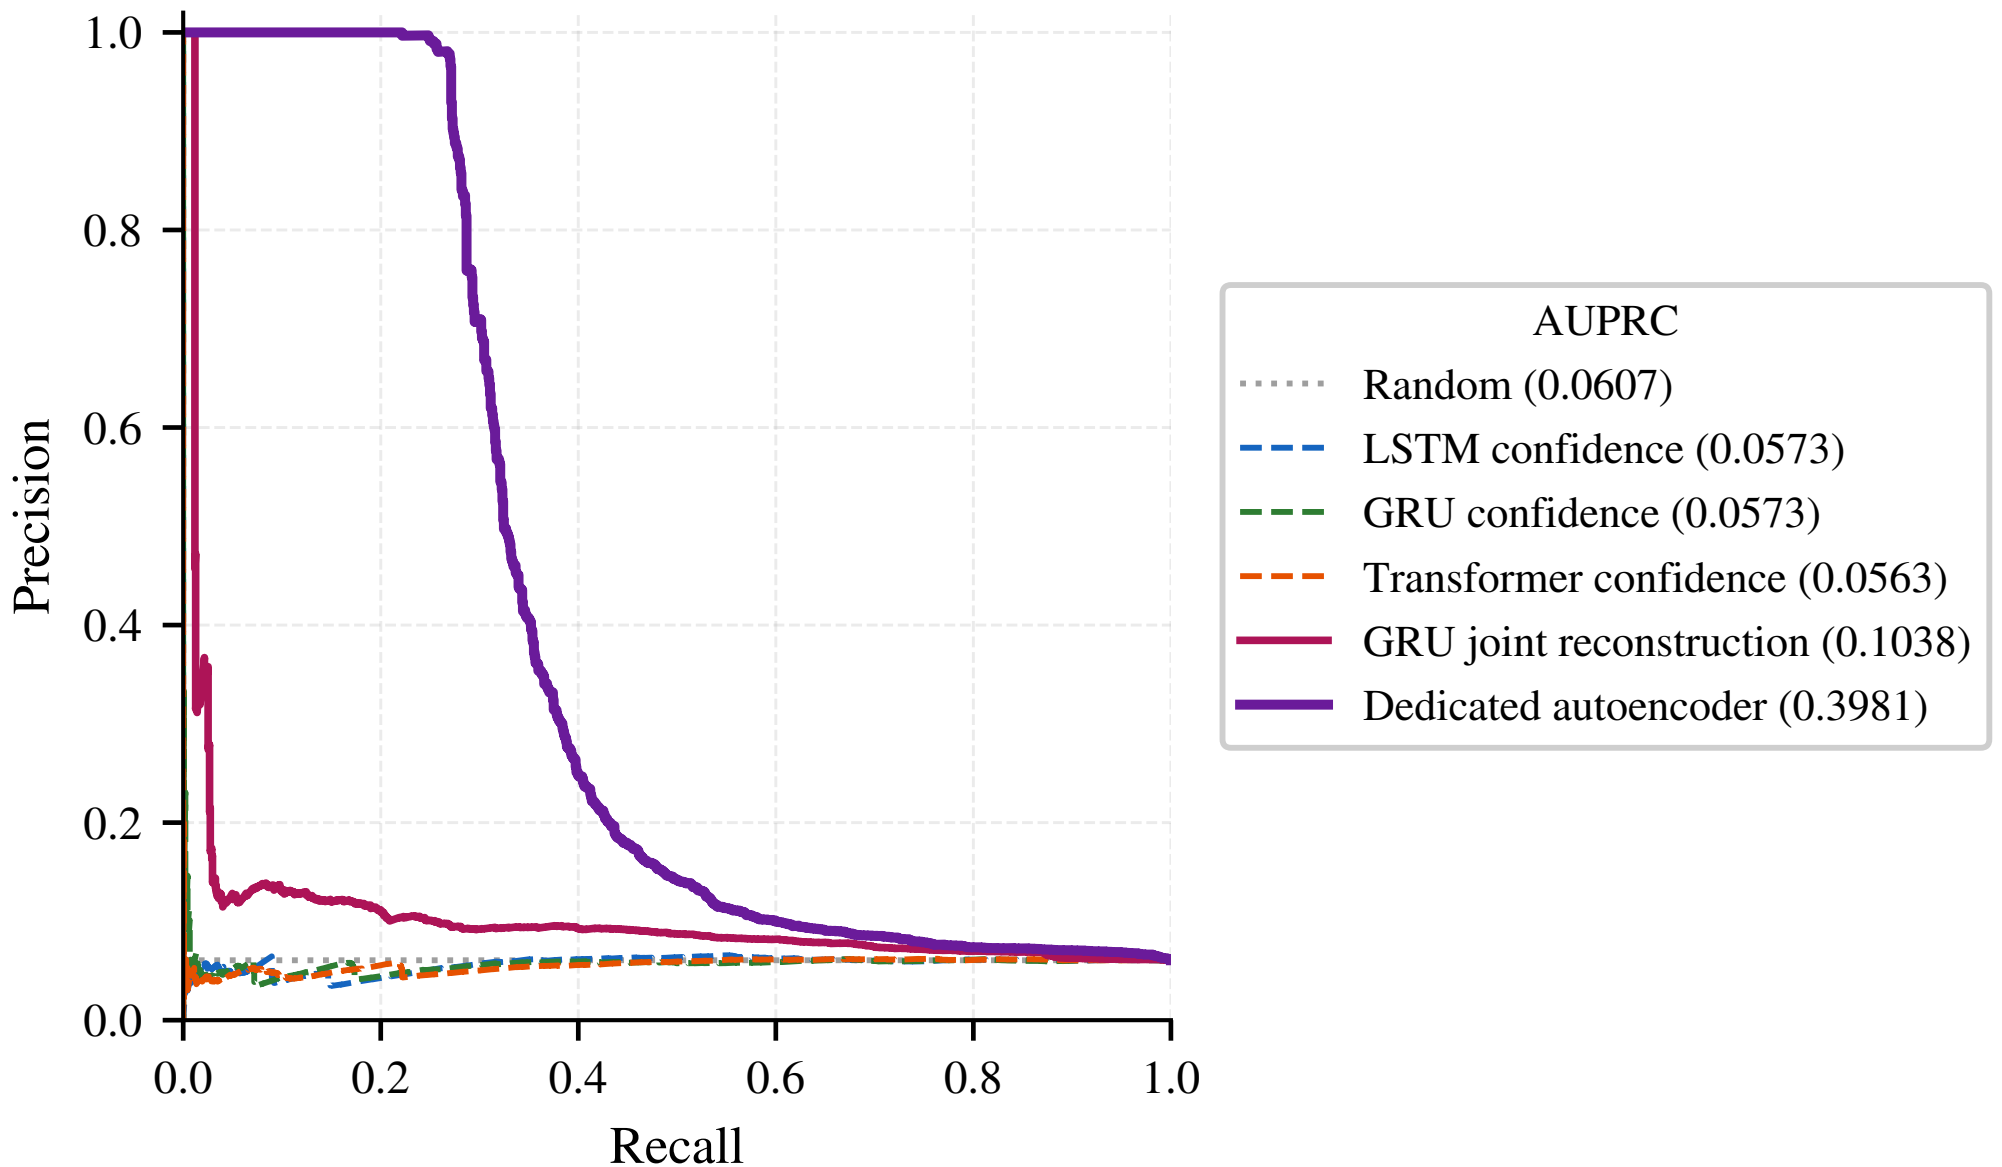
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUPRC
Random (0.0607)
LSTM confidence (0.0573)
GRU confidence (0.0573)
Transformer confidence (0.0563)
GRU joint reconstruction (0.1038)
Dedicated autoencoder (0.3981)