


01.06.2026 Debug & Test Notes

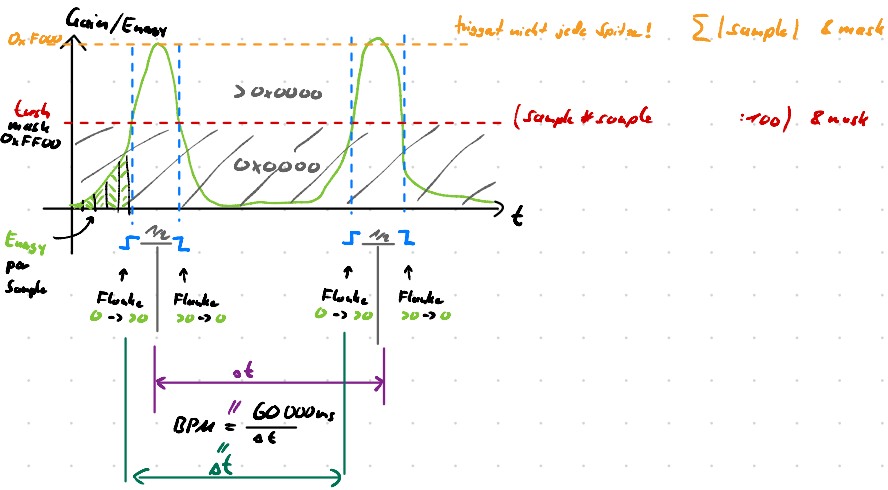


$$\Rightarrow \frac{60s}{2} = 0t \quad \Rightarrow N = \frac{60000ns}{0t}$$

60 BPM $\Rightarrow$ 1000 ms

100 BPM $\Rightarrow$ 600ms

720 BPM $\Rightarrow$ 500ms

200 RPM $\Rightarrow$ 300ms

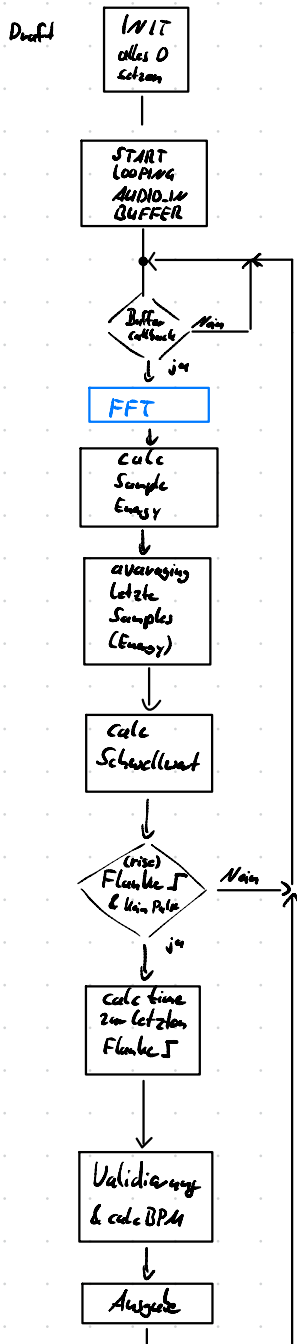

* FFR selektiv nicht frequenzsensitiv
wird Energie über kompl. Spektrum
gesteuert. Beim Implantat genau
gewünschte Frequenzbereich selektiv

Butte fill Time

$$t = \frac{\frac{N}{2}}{f_s \cdot C}$$

N: Sample element 6036

c: Kana(anzu) (1) Mawo

f_s : Sample Freq 44100 Hz

$$t = \frac{\frac{4096}{2}}{44100 \cdot 1} = \underline{\underline{46,46 \text{ ms}}}$$

$$BPM_{max} = \frac{60s}{64\mu s} = \underline{\underline{7292 BPM}}$$