

CÓPIA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

PROPOSTA TÉCNICA & FINANCEIRA

Data: 24/09/2026

Concurso Público N° 35A003641/CP/03/2026

**FORNECIMENTO DE DIVERSO
EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO**



Infinity Health, SA
Rua de França, nº273, Bairro da Coop - Maputo
Nuit:401550216
Tel.: +258 848770340/ 870867668
Email: comercial@infinityhealth.co.mz

ÍNDICE GERAL

Nº	TÓPICO	PÁGINA
1.0	INFORMAÇÕES DO CONCORRENTE	4
2.0	APRESENTAÇÃO DA INFINITY HEALTH, SA	5
3.0	DESCRIÇÃO DOS PARCEIROS E MARCAS	6
4.0	OBJECTO DA PROPOSTA	8
5.0	PROPOSTA TÉCNICA E METODOLOGIA	10
5.1	Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade	10
5.2	Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade	11
5.3	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	17
6.0	PROPOSTA FINANCEIRA	21
7.0	REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ANEXOS	25

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

REF.	DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Tabela 1	Informações do Concorrente	4
Tabela 2	Exemplos de fornecimento de equipamento	9
Tabela 3	Resumo do objecto da proposta	8
Tabela 4	Tabela de conformidade técnica	11
Tabela 5	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	17
Tabela 6	Planilha de preços dos bens	22
Figura 1	Marcas e representações	7

Tabelas

Tabela	Significado
Tabela 1	Resumo do objecto da proposta
Tabela 2	Alguns exemplos de fornecimento de equipamentos
Tabela 3	Conformidade técnica e especificações técnicas do modelo a fornecer

Abreviaturas

Abreviaturas	Significado
Infinity Health	Infinity Health, SA
N/A	Não Aplicável
IQ	Installation Qualification

1. Informações do Concorrente

Tabela 1. Informações do Concorrente

Denominação Social: Infinity Health, SA
No caso de Consórcio, informar a denominação social de cada membro integrante do Consórcio: N/A
Número de Registo Comercial do Concorrente na Conservatória competente:
Data de Registo do Concorrente na Conservatória:
1. Endereço oficial do Concorrente: Rua da França, n.º 273, Bairro da Coop Telefone: + 258 848770340 Cel: (+258) 870867668 E-mail: info@infinityhealth.co.mz / comercial@infinityhealth.co.mz
Informações sobre o Representante Autorizado do Concorrente Nome: E-mail: comercial@infinityhealth.co.mz
2. Encontram-se anexas cópias dos originais dos seguintes documentos: • Certificado de Inscrição no Cadastro Único de Fornecedores de Bens ao Estado (n.º 8.1); • Facturação em actividades similares ao objecto da contratação, no mínimo 3 (n.º 8.2); • Declaração comprovativa das instalações e equipamentos adequados e disponíveis, com dados para verificação (n.º 8.2); • Declaração comprovativa da equipa profissional e técnica, acompanhada dos respectivos currículos (n.º 8.2); • Declaração de experiência em actividades similares, emitida por pessoa de direito público ou privado, no mínimo 3 (n.º 8.2); • Comprovativo de capital social não inferior a 500.000,00 MT (n.º 8.2); • Catálogos dos bens a fornecer, com as descrições das especificações técnicas (n.º 8.2); • Autorização do fabricante (n.º 15.1.2) e certificado de origem (n.º 8.2); • Declaração de Garantia Provisória reconhecida em notário, com validade de 150 dias (n.º 23).

2. Apresentação

A Infinity Health, SA é uma empresa moçambicana, de capitais nacionais, cujo objecto social consiste em contribuir para o melhoramento da saúde pública em Moçambique, através de:

- 2.1. Importação, exportação e comércio geral de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais;
- 2.2. Estabelecimento de uma Unidade de Consultoria de Monitoria e Controlo de Qualidade de Laboratórios Clínicos, bem como a organização de formações técnicas na área de saúde pública.

Desde o estabelecimento da empresa, em 2023, todos os esforços e recursos estiveram sempre centrados na criação de parcerias internacionais e no aperfeiçoamento das nossas capacidades de importação e distribuição de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Este exercício assenta na definição de estratégias que visam disponibilizar produtos e equipamentos de qualidade a preços mais acessíveis.

Por isso, a definição das marcas a representar obedece ao padrão internacional de qualidade, procurando-se sempre alternativas de fornecimento adequadas às capacidades financeiras do cliente.

Estamos convictos de que podemos contribuir para o melhoramento da saúde em Moçambique, minimizando o impacto que as condições sociais dos cidadãos têm sobre o acesso aos serviços de saúde.

Há muito a dizer sobre a nossa visão e estratégia de apoio ao sector da saúde, sendo impossível esgotar o tema num texto ou numa conversa. Convidamos, por isso, V. Ex.as a contactar-nos a qualquer momento para explorar a gama de produtos e serviços que disponibilizamos. Poderão também, sempre que necessário, enviar qualquer pedido de cotação, esclarecimento ou reclamação para o nosso e-mail comercial@infinityhealth.co.mz.

3. Parceiros

Somos representantes oficiais e exclusivos da **MGI Tech Co., Ltd. (MGI)** para soluções de sequenciação genética DNBSEQ, automação MGISP e reagentes laboratoriais; da **Haier Biomedical** para cadeia de frio ultra-baixa (-86 °C), refrigeração médica, cabines de biossegurança e tanques de nitrogénio líquido; da **Dräger** para estações de anestesia, ventiladores, monitorização de pacientes e incubadoras neonatais; e da **Adams Equipment** para centrifugação, analisadores de hematologia e balanças laboratoriais de precisão.


Somos distribuidores oficiais, autorizados por acordo, da **Olympus** para microscopia, sistemas de endoscopia e imagiologia de ciências da vida; da **BD – Becton Dickinson** para diagnósticos, biosciências e dispositivos médicos; da **Elabscience** para kits ELISA, anticorpos, proteínas e reagentes de investigação; e da **Zeiss** para sistemas de microscopia, oftalmologia e metrologia industrial, entre outras marcas de referência internacional.

Definimos a origem das aquisições a partir das referências indicadas pelos nossos clientes; na ausência destas, baseamo-nos na experiência técnica da nossa equipa para aconselhar a melhor marca, de acordo com os objectivos e as capacidades financeiras.

3.1. Nossas Marcas

CORPORATE BRAND HIERARCHY


Parent Companies & Subsidiary Branches

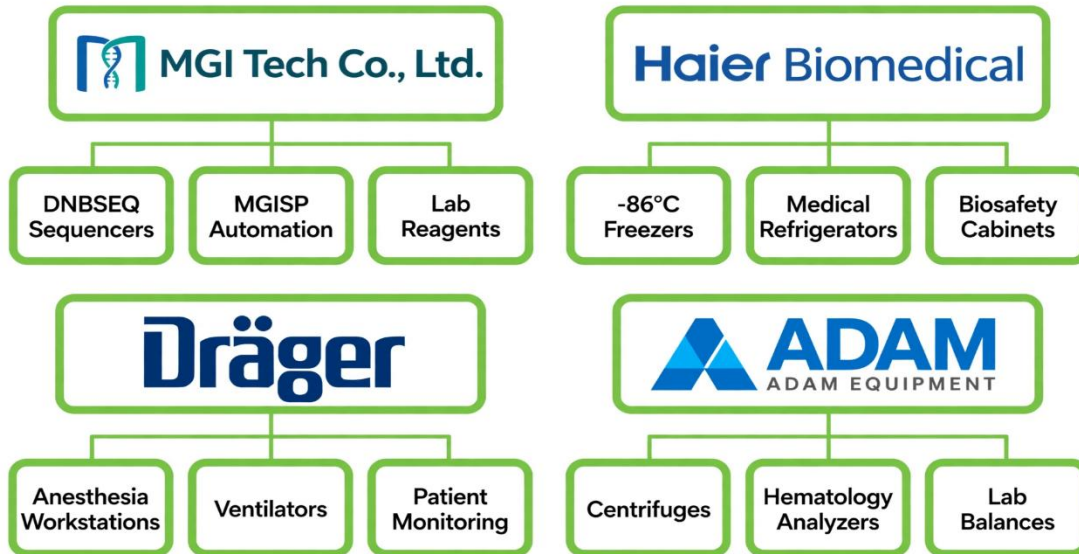

Corporate Brand Structure • Medical & Laboratory Equipment Portfolio • 2024

CORPORATE BRAND HIERARCHY

Parent Companies & Child Branch Divisions

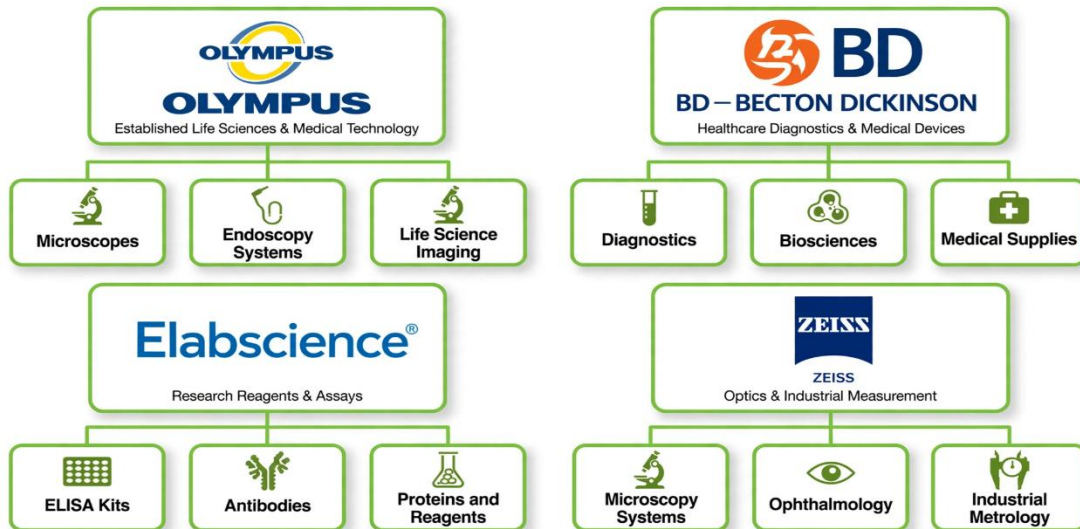

Corporate Hierarchy — Overview for Medical Proposal | Generated for Strategic Partnership Review | 2024

4. Objecto da Proposta

A presente proposta tem por objecto o fornecimento de **diverso equipamento de laboratório** destinado ao **Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)**, no âmbito do concurso abaixo resumido.

Concurso	Concurso Público N° 35A003641/CP/03/2026
Entidade Contratante	Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
Objecto	Fornecimento de diverso equipamento de laboratório para o IIAM
Âmbito do fornecimento	28 rubricas: cabine de biossegurança, centrífugas, autoclaves, microscópio, ultra-congeladores, biofermentador, entre outros
Modalidade	Concurso Público — Lote Único
Regime de contratação	
Critério de avaliação	Menor Preço Avaliado
Prazo de entrega	Mínimo 15 dias, máximo 3 meses
Local de entrega	IIAM — Direcção de Ciências Animais (DCA), Km 1.5 — Maputo
Validade da proposta	120 dias

Tabela 3. Resumo do objecto da proposta

A Infinity Health, SA compromete-se a fornecer a totalidade dos itens em conformidade com as especificações técnicas constantes da Parte II.1 — Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo a montagem, a testagem dos equipamentos e o treinamento dos técnicos, com garantia mínima de 12 meses.

Tabela 2. Alguns exemplos de fornecimento de equipamento

Instituição	Período	Modelo Fornecido
Universidade Eduardo Mondlane	2025-HZS-60 - Drying Oven	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-30L520F -30°C Biomedical Freezer (Forced Air Cooling)	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-40L568J -40°C Biomedical Freezer (Upright)	

5. Proposta Técnica e Metodologia

A presente proposta técnica foi elaborada com base no **Concurso Público Nº 35A003641/CP/03/2026** e nas Especificações Técnicas da Parte II.1 do Caderno de Encargos, para o fornecimento de diverso equipamento de laboratório ao IIAM.

5.1. Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade

A Infinity Health, SA fornecerá equipamento de laboratório de fabricantes internacionais reconhecidos, com sistemas de gestão da qualidade certificados (**ISO 13485** e **ISO 9001**) e marcação **CE**. Todos os bens são acompanhados de **catálogos** e **fichas técnicas**, conforme exigido no Documento de Concurso (n.º 8.2).

A empresa apresenta **autorização do fabricante e certificado de origem** dos equipamentos propostos (n.º 8.2 e 15.1.2), e dispõe de documento autorizado para a importação dos equipamentos.

Metodologia de Fornecimento

- **Seleção e conformidade:** cada item cumpre integralmente as especificações da Parte II.1 (temperaturas, capacidades, dimensões e normas aplicáveis).
- **Aquisição e importação:** as encomendas são colocadas junto de fabricantes/fornecedores qualificados, com documentação de origem e autorização de importação.
- **Controlo de qualidade:** verificação de conformidade com as fichas técnicas e integridade das embalagens antes da expedição.
- **Entrega e instalação:** transporte, montagem, testagem e treinamento dos técnicos no IIAM — Direcção de Ciências Animais, Km 1.5, Maputo, no prazo máximo de 3 meses.
- **Garantia e peças de reposição:** garantia mínima de 12 meses e manutenção/peças asseguradas em Moçambique.

Enquadramento da Proposta

- Cotação correspondente a **100% do lote único** especificado (n.º 12.1).
- Regime de contratação por **Preço Global** (Decreto nº 79/2022, de 30 de Dezembro).
- Proposta apresentada em **língua portuguesa** (n.º 16.1); preços cotados em Metical (n.º 14.1).
- Validade da proposta **120 (cento e vinte) dias**
- Apresentação de 1 original e 1 cópia, em invólucro opaco selado (n.º 11.1).

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

As especificações técnicas dos bens propostos foram elaboradas em estrita conformidade com as exigências constantes da **Parte II.1 — Especificações Técnicas** do Caderno de Encargos do Concurso N° 35A003641/CP/03/2026. O quadro seguinte demonstra a conformidade item a item.

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
01	Cabine de biossegurança classe II	Nível de biossegurança: BSL-2. Sistema de fluxo de ar: Comutável entre 70 % de recirculação/30 % de exaustão (A2) e 100 % de exaustão (B2). Conversão de modo: Comutação automática com um único toque entre A2 e B2. Controle do fluxo de ar: Tecnologia de motor EC para ajustes precisos do fluxo de ar. Ambiente de trabalho: Norma ISO 5 para salas limpas. Sistema de filtração: Filtração HEPA para remoção de 99,99% das partículas em suspensão no ar. Conceção do plenum: Pressão negativa para evitar a contaminação ambiental. Utilização específica: Amostras biológicas, produtos químicos perigosos, fármacos citotóxicos e ensaios farmacêuticos.	Cabine de biossegurança classe II ref. HR1200-IIA2-G — fluxo comutável A2 (70 % recirculação / 30 % exaustão) / B2 (100 % exaustão), comutação automática por um toque; motor EC; ambiente ISO 5; filtração HEPA 99,99 %; plenum de pressão negativa. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE
02	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL	Velocidade máxima 22.000 rpm RCF máxima 52.050 x g Capacidade máxima 6 x 500 ml Faixa de temperatura - 20°C a +40°C Precisão de temperatura ±1°C Precisão de velocidade ±10 rpm Ajuste de tempo 1 s a 99 h 59 min 59 s Nível de ruído ≤65 d B(A) Consumo de energia 5.000 W Dimensões 740 x 720 x 900 mm Peso 250 kg.	Centrífuga refrigerada ref. LX-210L750R com rotor de ângulo fixo 6x500 ml — 22 000 rpm; RCF 52 050xg; -20 °C a +40 °C (±1 °C); precisão ±10 rpm; temporizador 1 s-99 h 59 min 59 s; ruído ≤ 65 dB(A); 250 kg. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE
03	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL	Tipo: Centrífuga refrigerada de bancada Sistema de refrigeração: Compressor isento de CFC ou equivalente ecológico Motor: Brushless (sem escovas), livre de manutenção Velocidade máxima: ≥15.000 rpm Força centrífuga máxima (RCF): ≥20.000 x g Controle de temperatura: De -10 °C ou inferior até +40 °C Precisão da temperatura: ±2 °C ou melhor Rotor: Rotor de ângulo fixo para tubos de 15 mL Capacidade mínima do rotor: 12 x 15 mL ou superior Material do rotor: Alumínio anodizado ou material equivalente resistente à corrosão Programação: Ajuste independente de velocidade, tempo e temperatura Temporizador: 1 segundo a 99 horas e 59 minutos ou superior Pannel de controlo: Display LCD ou TFT digital Bloqueio da tampa: Eletrónico, com abertura apenas após paragem completa Nível de ruído: ≤65 d B Alimentação eléctrica: 220-240 V AC, 50/60 Hz Certificações CE, ISO 9001 e ISO 13485 (ou equivalentes)	Centrífuga refrigerada de bancada ref. LX-500R com rotor de ângulo fixo 12x15 ml (alumínio anodizado) — ≥ 15 000 rpm; RCF 26 322xg; -20 °C a +40 °C (±1 °C); display LCD/TFT; bloqueio eletrónico da tampa; 220-240 V; CE, ISO 9001 e ISO 13485. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
04	Máquina de enchimento semiautomática	Máquina de enchimento semiautomática em aço inoxidável (SX-50 Speed Fill), Bomba peristáltica de bancada 2 peristaltic heads in AISI 316L stainless steel, Sem contaminação cruzada / Envasamento de 0,1 a 1.050 ml / Vazão de até 6,4 l/min / Precisão de dosagem de $\pm 0,5\%$ / Troca de produto em 1 minuto / Função antigotejamento / Recalibração automática / Trilha de auditoria. Fornecido com três tubos de silicone com pontas de válvula anti-gotejamento em vidro nos diâmetros 3x7, 5x9 e 8x12 mm. indicada para líquidos farmacêuticos e biológicos, com fácil desmontagem para limpeza e conformidade com normas GMP/BPF. https://www.dara-pharma.com/en/machinery-selector/1-dara-pharma-aseptic-filling-machinery/13-sx-50-speedfill-tabletop-peristaltic-pump .	Bomba peristáltica de bancada SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5–500 ml; precisão $\pm 1\%$; servomotor; conforme cGMP / US FDA) + tubos e conectores duplos em Y de silicone Ø 3,2 / 6,4 / 8,0 mm; instalação, arranque e treinamento executados por técnico DARA.	CUMPRE
05	Máquina de capsulagem semiautomática	Tipo de equipamento: Máquina automática de bancada para capsulagem (fechamento) de frascos e garrafas. Aplicação: Indicada para laboratórios farmacêuticos, produção piloto, vacinas, produtos biológicos, medicamentos injectáveis e biotecnologia. Capacidade de produção: Até 1.500 frascos por hora (UPH). Material: Estrutura em aço inoxidável AISI 304, alumínio anodizado e componentes técnicos em POM (Polioximetileno). Sistema de capsulagem: Cabeçote pneumático de crimpagem de alta precisão Tipos de fechamento compatíveis: Cápsulas de alumínio O fornecimento (crimp caps), tampas Flip-Off®, Tear-Off® e outros sistemas de fechamento farmacêutico. Tipos de recipientes: Frascos e garrafas de vidro, plástico ou metal. Dimensões dos recipientes: Diâmetro entre 60-75 mm e altura máxima de 210 mm. Sistema de alimentação: Posicionamento manual das tampas, com opção de alimentador vibratório automático. Tempo de mudança de formato: Aproximadamente 2 minutos, sem necessidade de ferramentas especiais. Ajuste da altura: Sistema de ajuste rápido com indicador digital. Alimentação elétrica: 120/230 V AC, 50/60 Hz. Potência instalada: 150 W. Sistema pneumático: Ar comprimido limpo e seco, pressão de trabalho de 6 bar e consumo aproximado de 20 L/min. Peso aproximado: 40 kg. Conformidade: Desenvolvida de acordo com os requisitos c GMP, FDA e adequada para utilização em salas limpas (Clean Rooms). https://www.dara-pharma.com/en/machinery-selector/1-dara-pharma-aseptic-filling-machinery/17-sx-140-c-tabletop-machine-for-automatic-closing-of-vials-and-bottles .	Máquina de bancada SX-140-C para fecho automático de frascos — crimpagem pneumática; estrutura AISI-304; até 1 000–1 500 uph; preparada para 1 formato de frasco 5 ml + kit de changeover; inclui documentação de validação IQ/OQ.	CUMPRE

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
06	Máquina de rotulagem	Máquina automática de rotulagem em aço inoxidável AISI 304/316, destinada à aplicação de rótulos autoadesivos em frascos laboratoriais e farmacêuticos, equipada com sistema PLC touchscreen, sensores fotoelétricos, ajuste automático de velocidade, esteira motorizada e elevada precisão de rotulagem. Compatível com normas GMP/BPF e adequada para linhas de produção de vacinas, produtos biológicos e farmacêuticos.	SYSTEM 1 PHARMA PLC SIEMENS — sistema automático de rotulagem para produtos cilíndricos: cabeça ENERGY 100, conveyor 2500×142 mm, impressora térmica Videojet DataFlex 6530, controle OCV/OCR Cognex IS7800, PLC Siemens S7-1511, painel ASEM 8,4" com UPS, interface em português. Inclui kit de sobressalentes, software Clarisoft, disaster recovery, validação GAMP5 nível 2, tradução PT e instalação/SAT/treinamento no local. GMP/BPF.	CUMPRE
07	Máquina automática de enchimento e envasamento	Linha automática (enchimento + tampagem) Aplicação: vacinas e líquidos farmacêuticos estéreis Volume de enchimento: 50 – 250 ml (ajustável) Precisão: $\pm 0,5\%$ a $\pm 1\%$ Capacidade: 20 – 60 frascos por minuto (varia por modelo) Material: Aço inoxidável 316L (grau farmacêutico) Normas: compatível com GMP / produção farmacêutica Tampagem: automática (rolha + cápsula ou tampa roscada) Controle: sistema PLC com painel touch screen Energia: 220V ou 380V trifásico Opcional: sistema CIP/SIP (limpeza e esterilização automática).	Máquina automática ref. ZS-AFY1 para enchimento e envasamento — 50–250 mL; 20–60 frascos/min; acessórios incluídos: esteira e distribuidor.	CUMPRE
08	Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri de laboratório	Capacidade da câmara 200 L ($\pm 10\%$); Material da câmara Aço inoxidável AISI 316L; Material externo Aço inoxidável AISI 304; Tipo de instalação Piso (Floor standing); Tipo de porta Porta frontal em vidro temperado ou aço inox; Sistema de lavagem Braços rotativos superior e inferior; Sistema de secagem Ar quente filtrado por filtro HEPA H14; Temperatura de lavagem 30–95 °C Temperatura de desinfecção térmica até 93–95 °C; Programas 20–40 programas programáveis; Controle Tela tátil LCD ou Touch Screen; Sistema de dosagem 2–4 bombas automáticas para detergente e neutralizante; Consumo de água 15–30 L/ciclo; Tempo de ciclo 30–120 minutos; Alimentação elétrica 380–415 V, trifásica, 50/60 Hz; Potência instalada 8–12 kW; Nível de ruído < 65 dB; Certificações ISO 9001, CE.	Lavadora de vidraria de laboratório MIELE PLW 8693 com Dry Plus (DSS), caixa em inox — inclui conjunto de cestos "Basic" (A101, A150, módulos injector A300/3 e A301/5, 2× AK12/1, bocal A802), inserto para 38 placas de Petri E 118, detergente ProCare Lab 10MA e neutralizante ProCare Lab 30C.	CUMPRE
09	Tripés	Tripé metálico galvanizado ou em aço inoxidável, altura aproximada de 20 cm, resistente ao calor, para suporte de recipientes durante aquecimento	Tripé de aço para laboratório ref. CON-TRIPOD, altura 200 mm — suporte para recipientes durante o aquecimento.	CUMPRE
10	Aagitador magnético 22 litros	Painel de controlo: LCD com caracteres brancos, 115 × 30 mm Placa superior: 26 × 26 cm Intervalo de velocidade: 50 – 1800 rpm Intervalo de temperatura: 30 – 500 °C Capacidade: 22 litros Material da placa superior: cerâmica".	Aagitador magnético com aquecimento IKA C-MAG HS 10 (ref. 4240400) — placa cerâmica, até 15 L H ₂ O, segurança 550 °C, LED, DIN 12878.	CUMPRE
11	Aagitador magnético 5 litros	Aagitador magnético digital com aquecimento, 5 litros, alto desempenho. Potência: 500 W, Capacidade: até 5 litros, Velocidade: 50–1500 rpm, Placa de base: 16×16 cm (temperatura ambiente a 310 °C), Sensor: PT1000 interno e externo, Tensão: 220 V, Dimensões: 285×180×90 mm.	Aagitador magnético com aquecimento IKA C-MAG HS 7 (ref. 3581200) — placa cerâmica, até 10 L H ₂ O, segurança 550 °C, LED, DIN 12878.	CUMPRE

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
12	Barras de agitador magnéticas	Soluções viscosas, agitação a alta velocidade, alta temperatura Agitação Tamanho: 50-60 mm Formato octogonal/poligonal Com anel pivotante, caixa de 10 unidades Tipo: Núcleo de Alnico V Revestimento: Teflon PTFE"	Barras de agitação magnética BRAND ref. 137618 — PTFE, formato octogonal com anel pivotante, comprimento 51 mm, Ø 8 mm.	CUMPRE
13	Incubadora CO ₂	"Temperatura: temperatura ambiente +5 °C até ~60 °C CO ₂ : 0-20 % (controlado por sensor de infravermelhos) Humidade: até ~95 % Volume típico: 180 L Esterilização: 140 °C (alguns modelos até 180 °C) Controlo digital (PID + ecrã tátil) com filtro HEPA (ambiente limpo, tipo Classe 5 da ISO). Recuperação rápida após a abertura da porta".	Incubadora de CO ₂ ref. HCP-168 — ambiente +5 °C a ~60 °C; CO ₂ 0-20 % (sensor IR); humidade até ~95 %; volume 180 L; esterilização 140 °C; controlo PID + touch screen; filtro HEPA (ISO Classe 5).	CUMPRE
14	Microscópio	Microscópio digital integrado Am Scope MD82ES10 OMAX de 1,3 MP com iluminação LED, 40X-2000X.	Microscópio digital composto VISISCOPE BL224PL T1 (ref. 630-3290) — contraste/fundo claro, câmara digital T1; inclui instalação, arranque e treinamento no local por técnico.	CUMPRE
15	Centrífuga de microhematócrito	Controlo preciso da velocidade e do tempo separadamente. Operação fácil com menu intuitivo e ecrã de fácil leitura. Motores DC sem escovas e sem manutenção. Funcionamento por impulsos para rotações rápidas. Capacidade do rotor: Rotor de hematócrito. Rotor de hematócrito: 24 capilares; velocidade máxima: 12000 rpm. Rotor de tubos: 1.5/2m Lx24; Velocidade máxima: 14000rpm. Para bancada, com performance de alta velocidade (MÍN: 200 rpm (1.256,6 rad.min-1) - MÁX: 12.000 rpm (75.398,2 rad.min-1)). RCF máx. (força g) 13.680 unit. Com 8,5 kg, 10,5 kg (18,7 lb, 23,1 lb). Medidas 364 mm (14,3 in) * 280 mm (11 in) * 274 mm (10,8 in).	Centrífuga de microhematócrito ref. LX-165T2-J + rotor de ângulo fixo 24x1,5/2,0 ml (tampa plástica) + rotor de hematócrito 24 capilares — 200-12 000 rpm; RCF máx. 13 680xg; motor DC sem escovas; 364x280x274 mm. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE
16	Autoclave horizontal rectangular	Esterilizador em autoclave retangular horizontal, modelo de laboratório, Capacidade (em litros): 1000 L, Volume da câmara: 800 L, Orientação: horizontal, Tipo de montagem: horizontal, Nível de automatização: totalmente automático, Material: aço inoxidável, Nível de automatização: totalmente automático, Material da câmara: aço inoxidável 316, Forma: retangular, Temperatura máxima: 121 °C, Tipo de porta: porta única, Intervalo de pressão: 15-20 psi, Intervalo de temperatura: 121-134 °C, Dimensões: 600 mm x 900 mm x 1500 mm, Alimentação: 415 VCA, Modo de aquecimento: Elétrico, Vácuo P/	Autoclave vertical de bancada 50 L ref. HRLM-60A — programável, eléctrica, inox, com secagem; 105-134 °C; LCD; ciclo totalmente automático (pré-aquecimento, exaustão por impulsos, esterilização e secagem); filtro de ar 0,22 µm. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE
17	Autoclave vertical	Autoclave de bancada, vertical, programável, eléctrica, em aço inoxidável, com secagem. Capacidade de 50 litros, intervalo de temperatura MÁX.: 134 °C (273,2 °F) e MÍN.: 105 °C (221 °F). Ecrã LCD. Todo o processo de pré-aquecimento, substituição, exaustão por impulsos, aquecimento, esterilização e secagem é realizado automaticamente. Filtro de ar de esterilização de alta eficiência de 0,22 µm.	Autoclave vertical de laboratório ref. HRLM-45 — 45 L nominal; câmara em aço inox 316L (344x500 mm); até 140 °C e 4 bar; 220-240 V; controlo por microprocessador; opções de documentação digital. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
18	Vortex mixer (agitador de tubos tipo vortex)	"Gama de velocidades* 230 V, 300 a 2500 rpm Temporizador 1 segundo a 160 horas Orbits 4,9 mm Comandos: Interruptor basculante Auto/Standby/On, LED Visores de velocidade/tempo, botões para cima/para baixo Botões para controlo do ponto de regulação Ciclo de funcionamento: Funcionamento intermitente Dimensões (C x L x A) 21,1 x 12,2 x 16,5 cm Peso de envio: 4,5 kg".	Vortex digital multi-tubos ref. MSV-3500 — 300–3 500 rpm; tubos 0,2–50 ml; inclui plataforma SV-4/30 para 4x50 ml (30 mm).	CUMPRE
19	Painéis de pressão	Painel de controlo eletrónico com comandos digitais; Tampa equipada com sistema de bloqueio de segurança e válvula para libertação manual de vapor; Painel digital com visor de fácil leitura; Função automática de manutenção da temperatura ("Keep Warm"); Capacidade nominal: 6 litros; Corpo fabricado em aço inoxidável de elevada resistência à corrosão e durabilidade.	Painel de pressão 6 L inox ref. Duo 60 (7-in-1) — painel digital, função «Keep Warm», válvula de segurança; inclui painel interior inox e grelha de vapor.	CUMPRE
20	Autoclave vertical de laboratório	Autoclave vertical Systec DE-45, 45 L nominal, câmara inox 316L (344 x 500 mm), operação até 140 °C e 4 bar, alimentação 220–240 V, com controlo microprocessado e opções de documentação digital.	Autoclave vertical de laboratório 45 L ref. DE-45 (ref. fabr. 1545) — 140 °C / 4 bar; câmara em 316L; inclui cesto inox adicional e kit de documentação digital.	CUMPRE
21	Banho-maria	Faixa de temperatura: -30°C a 100°C; Constância de temperatura: ±0,1°C; Controle de temperatura, Sensor de temperatura: PT-100Q; Bomba de circulação: 27L/min, altura manométrica máxima: 3m; Aquecedor: 2500W; Refrigerador: 1 HP; Capacidade de refrigeração: 1000 Watts/3412 BTU/hora Dispositivos de segurança: Disjuntor de curto-circuito, protetor contra superaquecimento, sensor de anomalia, protetor de sobrecarga. Dimensões da banheira: L300 x P210 x A180 mm; Dimensões da banheira: L300 x P360 x A180 mm; Dimensões externas: L420 x P530 x A800 mm; Volume: 19,4L Entrada/Saída: 12,5mm; Peso: 63kg.	Banho circulante refrigerado/aquecido GRANT LTC4R (TX150-R4R) — -30 °C a +100 °C; 20 L; constância ±0,1 °C; 18 L/min; 1,84 kW; com mangueiras e clips.	CUMPRE
22	Contador de colónias	Equipamento utilizado para contagem de colónias bacterianas e fúngicas em placas de Petri; Possui sistema digital com display LCD/LED; Compatível com placas de 50–150 mm; Inclui iluminação LED e lente de aumento para melhor visualização; Faixa de contagem até 999 colónias; Alta precisão e fácil operação; Alimentação elétrica 220–240 V;	Contador digital de colónias ref. E-CC90-D — placas de Petri Ø 50–90 mm; sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável; visor LED; dupla iluminação LED (faixa + lupa); ampliação 3x/9x.	CUMPRE
23	Bomba de vácuo	Tipo rotativa de palhetas, vazão de 40–60 L/min, pressão final ≤10 Pa, motor 220 V, baixo ruído, adequada para filtração e liofilização.	Bomba de vácuo rotativa de palhetas ref. VP125 — vazão 40–60 L/min; pressão final ≤ 10 Pa; 220 V; inclui filtro de entrada e carga de óleo.	CUMPRE
24	pHmetro	pHmetro digital de bancada, faixa de medição 0–14 p H, resolução 0,01 p H, compensação automática de temperatura (ATC), calibração em 3 pontos.	pHmetro de bancada Apera PH800 — calibração 1–3 pontos; monitorização do eletrodo; memória GLP de 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eletrodo 201T-F com ATC.	CUMPRE

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade dos Equipamentos Apresentados	Conformidade
25	Ultra-congelador (-70 °C)	Ultra congelador laboratorial vertical com faixa de operação até -86 °C e temperatura de trabalho ajustável para -70 °C, capacidade aproximada de 500 L, construção interna em aço inoxidável, controle digital microprocessado, sistema de alarme audiovisual, portas internas isoladas, sistema de refrigeração de alta eficiência e compatível com armazenamento de vacinas, amostras biológicas e culturas microbiológicas.	Ultra-congelador vertical ref. DW-86L579 — faixa até -86 °C, ajustável para -70 °C; ~500 L; interior em aço inoxidável; controlo digital microprocessado; alarme audiovisual; portas internas isoladas. Inclui montagem e treinamento.	CUMPRE
26	Cuba de coloração	Recipiente de vidro com tampa, ideal para armazenamento seguro e prático em laboratórios, ambientes clínicos e demais espaços que exigem organização e proteção de materiais. O design transparente permite fácil visualização do conteúdo, otimizando o controle e a rotina diária. Fabricado em vidro resistente, garante durabilidade e higiene, suportando processos de limpeza e esterilização frequentes.- Vidro transparente de alta qualidade para máxima visibilidade; - Tampa que assegura fechamento eficiente, protegendo contra contaminações;- Design compacto e versátil, adequado para múltiplas aplicações; - Resistência a variações térmicas e químicos comuns em laboratórios; - Facilita a organização e o manuseio seguro de materiais sensíveis	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa ref. CNW-TYI304 — vidro resistente, design compacto, fácil visualização do conteúdo.	CUMPRE
27	Pipetadores automáticos 1-10 mL	Equipamento utilizado para medir e transferir líquidos com alta precisão em laboratório; Faixa de volume ajustável de 1 a 10 mL; Compatível com ponteiros descartáveis; Corpo leve, resistente e ergonômico; Possui ajuste manual de volume e visor indicador; Partes autoclaváveis para esterilização; Alta precisão e repetibilidade nas medições; Indicado para laboratórios de microbiologia, vacinas, química Fácil limpeza e manutenção;	Micropipeta mecânica monocal VWR EHP ref. 613-7138 — volume variável 1 000-10 000 µl; autoclavável; resistente a UV.	CUMPRE
28	Biofermentador anaeróbico	Biofermentador anaeróbico em aço inoxidável AISI 316L, destinado ao cultivo de Clostridium chauvoei para produção de vacina veterinária contra blackleg. Equipado com sistema de controle de anaerobiose por gases inertes, controle automático de temperatura, pH e agitação, sistema CIP/SIP, portas assépticas para inoculação e amostragem, vedação hermética e painel digital programável. Adequado para produção de vacinas bacterianas em condições controladas de biossegurança. capacidade do tanque, 6.000-7.000 L.	Biofermentador anaeróbico 7 000 L ref. BAILUNBIO-7000SJA-GMP — aço inoxidável 316L; PLC; inclui documentação de validação FAT, SAT, IQ, OQ e PQ e instalação, arranque e treinamento no local por 2 técnicos do fabricante (15 dias; viagens, vistos, alojamento e transporte incluídos).	CUMPRE

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Apresenta-se em seguida a relação dos bens propostos, com a descrição, especificações técnicas, marca, modelo ou referência e país de origem de cada bem. As referências completas constam da planilha de preços.

Cabine de biossegurança classe II (6 un.)	BSL-2. Switchable airflow 70% recirculation/30% exhaust (A2) and 100% exhaust (B2); one-touch automatic mode change. EC motor; ISO 5 workspace; HEPA 99.99%; negative-pressure plenum. Use: biological samples, hazardous chemicals, cytotoxics and pharma assays. Includes assembly and training.	HR1200-IIA2-G	China
Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL (2 un.)	Refrigerated centrifuge for 500 mL bottles(Max speed 22,000 rpm; 21,000rpm max RCF 52,050 × g; 47,400 × g;capacity 6 × 500 mL; Comply;-20 °C to +40 °C; ±1 °C; Comply;speed accuracy ±10 rpm; Comply,1 s-99 h 59 min 59 s; Comply;noise ≤ 65 dB(A); Comply ≤ 56 dB(A);5,000 W; 3400W;740×720×900 mm; 740*920*990mm 250 kg. 375kg Includes assembly and training.)	LX-210L750R+LX-10L750R fixed-nge rotor 6×500ml	China
Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL (1 un.)	Refrigerated centrifuge for 15 mL tubes(Benchtop, Comply CFC-free compressor, brushless motor.Comply;≥ 15,000 rpm; Comply;155,500rpmRCF ≥ 20,000 × g; Comply, 26.322xg, -10 °C or lower to +40 °C; -20~40°C,±2 °C Better, ±1 °C; fixed-angle rotor ≥ 12 × 15 mL, anodised aluminium; Comply;LCD/TFT; electronic lid lock; Comply;noise ≤ 65 dB; 220-240 V 50/60 Hz; Comply;CE, ISO 9001 and ISO 13485. Includes assembly and training.Comply)	LX-500R+155T500R fixed-angle rotor 12×15ml	China
Máquina de enchimento semiautomática (2 un.)	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5-500 ml; ±1%; servomotor; cGMP-US FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos);Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 3,2 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 3,2 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 6,4 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 6,4 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 8 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 8 mm;Serviço — Instalação, arranque e treinamento executados por técnico DARA (1 dia; vias e alojamento incluídos	SX-50 SpeedFill & Tubo-SIL-3.2 & DY-SIL-3.2 & Tubo-SIL-6.4 & DY-SIL-6.4 & Tubo-SIL-8.0 & DY-SIL-8.0	Espanha

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Máquina de capsulagem semiautomática (2 un.)	Máquina de bancada para fecho automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática crimping; AISI-304; rodeta estrela POM; bimanual; até 1.000–1.500 uph; preparada p/ 1 formato frasco 5 ml + 1 formato tampa alu); Kit de changeover (rodeta/peças de adaptação) para formato adicional de frasco; Serviço — Documentação de validação IQ/OQ (Installation/Operational Qualification — entrega de protocolos)	SX-140-C & CO-5ml	Espanha
Máquina de rotulagem (1 un.)	1 PHARMA PLC SIEMENS (Sistema automático de rotulagem para produtos cilíndricos: cabeça ENERGY 100, conveyor 2500×142mm, impressora térmica Videojet, DataFlex 6530, controlo OCV/OCR, Cognex IS7800, dispositivo de rotação, expulsor, PLC Siemens S7-1511, CFR21, painel ASEM 8,4" com UPS; manual e interface em português)	SYSTEM 1 PHARMA PLC	Italy
Máquina automática de enchimento e enfrascamento (1 un.)	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50–250 mL, 20–60 frascos/min) — acessórios incluídos: esteira, distribuidor	ZS-AFY1	RSA
Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri de laboratório (1 un.)	Máquina de lavar vidro de laboratório MIELE PLW 8693 com Dry Plus (DSS), caixa em inox; inclui dispensador de líquido e lança de aspiração com deteção de nível vazio; Conjunto de cestos "Basic" p/ PLW 8693: A101 cesto superior, A150 cesto inferior, módulos injector A300/3 (vidraria 250–1000 ml) e A301/5 (50–250 ml), 2× AK12/1 e bocal de rinse A802 p/ doseador de pó; Inserto MIELE p/ 38 placas de Petri semi-tampas 100 mm, nível superior, Detergente ProCare Lab 10MA, 5 L; Neutralizador ProCare Lab 30C, 5 L	MIELE PLW 8693 & Basket set Basic & Inserto MIELE E 118 & ProCare Lab 10MA & ProCare Lab 30C	RSA
Tripés (3 un.)	Suporte tripode de aço para laboratório (altura 200 mm)	CON-TRIPOD	RSA
Agitador magnético 22 litros (2 un.)	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 l H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	4240400	RSA
Agitador magnético 5 litros (1 un.)	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 l H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	3581200	RSA

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Barras de agitador magnéticas (5 un.)	Magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring L 51 mm, bar diam. 8 mm	BRAND® 137618	RSA
Incubadora CO ₂ (1 un.)	CO ₂ incubator(Ambient +5 °C to ~60 °C; CO ₂ 0–20% (IR sensor); humidity up to ~95%; typical volume 180 L; sterilisation 140 °C (some up to 180 °C); PID + touch screen; HEPA (ISO Class 5); fast)	HCP-168	China
Microscópio (1 un.)	VISISCOPE BL224PL T1(Microscópio digital VISISCOPE BL224PLT1)&Instalação, arranque e treinamento no local por técnico	630-3290	RSA
Centrífuga de microhematócrito (1 un.)	Microhaematocrit centrifuge(Independent speed and time; intuitive menu; brushless DC; pulse. Haematocrit rotor 24 capillaries / 12,000 rpm; tube rotor 1.5/2 mL × 24 / 14,000 rpm; 200–12,000 rpm; max RCF 13,680; 8.5–10.5 kg; 364×280×274 mm. Includes assembly and training.)	LX-165T2-J+fixed-angle rotor (Plastic cover)24×1.5/2.0ml +Hematocrit rotor 24 Capillaries	China
Autoclave horizontal rectangular (1 un.)	Vertical benchtop autoclave 50 L(Programmable, electric, stainless steel, with drying. 50 L; 105–134 °C; LCD; fully automatic cycle (preheat, replace, pulse exhaust, heat, sterilise, dry); 0.22 µm air filter. Includes assembly and training.)	HRLM-60A	China
Autoclave vertical (1 un.)	Vertical laboratory autoclave(Systec DE-45 or equivalent. 45 L nominal; 316L chamber (344×500 mm); up to 140 °C and 4 bar; 220–240 V; microprocessor control; digital documentation options. Includes assembly and training.)	HRLM-45	China
Vortex mixer (agitador de tubos tipo vortex) (1 un.)	Vortex digital multi-tubos 300–3500 rpm (tubos 0,2–50ml; plataformas não incluídas)&Plataforma SV-4/30 para 4×50 ml (30 mm) — acessório do vortex MSV-3500	MSV-3500&SV-4/30	RSA
Panelas de pressão (2 un.)	Panela de pressão 6 L inox, painel digital, função «Keep Warm», válvula de segurança — inclui panela interior inox e grelha de vapor	Duo 60 (7-in-1) 6 L	RSA
Autoclave vertical de laboratório (1 un.)	Autoclave vertical de laboratório 45L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto inox adicional e kit de documentação digital	DE-45 (ref. fabr. 1545)	RSA

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Banho-maria (1 un.)	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido (TX150-R4R) -30 a +100 °C, 20,l, ±0,1 °C, 18 l/min, 1,84 kW, com mangueiras e clips	LTC4R	UK
Contador de colónias (3 un.)	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50-90 mm placa Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3×/9x	E-CC90-D	RSA
Bomba de vácuo (2 un.)	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40-60 L/min, ≤ 10 Pa, 220V — inclui filtro de entrada e carga de óleo	VP125	RSA
pHmetro (10 un.)	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1-3 pontos; monitorização do elétrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; elétrodo 201T-FATC)	PH800	RSA
Ultra-congelador (-70 °C) (2 un.)	Ultra-low freezer (-70 °C)(Vertical laboratory freezer down to -86 °C, settable to -70 °C; ~500 L; stainless interior; microprocessor control; audiovisual alarm; insulated inner doors; high-efficiency refrigeration; vaccines, biologicals and cultures. Includes assembly and training.)	DW-86L579	China
Cuba de coloração (5 un.)	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa	CNW-TYI304 (Coplin vidro c/ tampa)	RSA
Pipetadores automáticos 1-10 mL (20 un.)	VWR EHP — micropipeta mecânica monocal volume variável 1000-10000 µl (autoclavável;resistente a UV)	613-7138	RSA
Biofermentador anaeróbico (1 un.)	Fermentador automático GMP em aço inoxidável 316L, 7.000 L, PLC & Documentação de validação FAT, SAT, IQ, OQ e PQ do fermentador & Instalação, arranque e treinamento no local por 2 técnicos do fabricante, 15 dias (inclui viagens, vistos, alojamento e transporte)	BAILUNBIO-7000SJA-GMP & DOC-FAT-SAT-IQ-OQ-PQ & INST-TREINO-BAILUN	China

6. Proposta Financeira

- a) Examinámos os documentos do **Concurso Público N° 35A003641/CP/03/2026**, referente ao fornecimento de diverso equipamento de laboratório para o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), e apresentamos a nossa proposta sem reservas, em conformidade com o Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro.
- b) Os preços da nossa proposta constam da Planilha de Preço **109 889 924,84 MT** (Cento e nove milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro Meticais e oitenta e quatro centavos), conforme apresentado na Planilha de Preços que se segue, com base nas Especificações Técnicas do Caderno de Encargos.
- c) Declaramos que não estamos enquadrados em qualquer situação de impedimento prevista na legislação aplicável.
- d) Esta proposta tem validade de **120 (cento e vinte) dias**, conforme o n.º 19.1 do Documento de Concurso e, juntamente com a vossa aceitação por escrito constante da notificação de adjudicação, será considerada como contrato vinculativo entre as partes, até que um contrato formal seja assinado.
- e) Compreendemos que não estão obrigados a aceitar a proposta de menor preço ou qualquer outra proposta que venham a receber.

Maputo, 24 de Setembro de 2026

.....
Assinatura do Representante Autorizado
NÚT: 401550216
Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

CONCURSO PÚBLICO Nº 35A003641/CP/03/2026



Endereço: Rua da França, Nº273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
1	HR1200-IIA2-G	BSL-2. Switchable airflow 70% recirculation/30% exhaust (A2) and 100% exhaust (B2); one-touch automatic mode change. EC motor; ISO 5 workspace; HEPA 99.99%; negative-pressure plenum. Use: biological samples, hazardous chemicals, cytotoxics and pharma assays. Includes assembly and training.	China	90 Dias Úteis	6	UN	530 327,83	3 181 966,98	509 114,72	3 691 081,70
2	LX-210L750R+LX-10L7 50R fixed-nge rotor 6x500ml	Refrigerated centrifuge for 500 mL bottles(Max speed 22,000 rpm; 21,000rpm max RCF 52,050 × g; 47,400 × g;capacity 6 × 500 mL; Comply;-20 °C to +40 °C; ±1 °C; Comply;speed accuracy ±10 rpm; Comply,1 s-99 h 59 min 59 s; Comply;noise ≤ 65 dB(A); Comply ≤ 56 dB(A);5,000 W; 3400W;740x720x900 mm; 740*920*990mm 250 kg. 375kg Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	2	UN	1 175 084,90	2 350 169,80	376 027,17	2 726 196,97
3	LX-500R+155T500R fixed-angle rotor 12x15ml	Refrigerated centrifuge for 15 mL tubes(Benchtop, Comply CFC-free compressor, brushless motor.Comply;≥ 15,000 rpm; Comply;155,500rpmRCF ≥ 20,000 × g; Comply, 26.322xg,-10 °C or lower to +40 °C; -20~40°C,±2 °C Better, ±1 °C; fixed-angle rotor ≥ 12 × 15 mL, anodised aluminium; Comply;LCD/TFT; electronic lid lock; Comply;noise ≤ 65 dB; 220-240 V 50/60 Hz; Comply;CE, ISO 9001 and ISO 13485. Includes assembly and training.Comply)	China	90 Dias Úteis	1	UN	535 360,27	535 360,27	85 657,64	621 017,91
4	SX-50 SpeedFill & Tubo-SIL-3.2 & DY-SIL-3.2 & Tubo-SIL-6.4 & DY-SIL-6.4 & Tubo-SIL-8.0 & DY-SIL-8.0	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5-500 ml; ±1%; servomotor; cGMP-US FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos);Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 3,2 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 3,2 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 6,4 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 6,4 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 8 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 8 mm;Serviço — Instalação, arranque e treinamento executados por técnico DARA (1 dia; vias e alojamento incluídos	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	2 552 436,52	5 104 873,04	816 779,69	5 921 652,73
5	SX-140-C & CO-5ml	Máquina de bancada para fecho automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática crimping; AISI-304; rodeta estrela POM; bimanual; até 1.000-1.500 uph; preparada p/ 1 formato frasco 5 ml + 1 formato tampa alu);Kit de changeover (rodeta/peças de adaptação) para formato adicional de frasco;Serviço — Documentação de validação IQ/OQ (Installation/Operational Qualification — entrega de protocolos)	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	3 215 928,92	6 431 857,84	1 029 097,25	7 460 955,09
					Total Em Meticais			94 732 693,83	15 157 231,01	109 889 924,84

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

CONCURSO PÚBLICO Nº 35A003641/CP/03/2026



Endereço: Rua da França, Nº273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
6	SYSTEM 1 PHARMA PLC	1 PHARMA PLC SIEMENS(Sistema automático de rotulagem para produtos cilíndricos: cabeça ENERGY 100, conveyor 2500×142mm, impressora térmica Videojet,DataFlex 6530, controlo OCV/OCR,Cognex IS7800, ispositivo de rotação, expulsor, PLC Siemens S7-1511, CFR21, painel ASEM 8,4"com UPS; manual e interface em português)	Italy	90 Dias Úteis	1		21 692 563,48	21 692 563,48	3 470 810,16	25 163 373,64
6.1	SPARE PARTS KIT	Kit de peças sobressalentes para o sistema de rotulagem								
6.2	CLARISOFT	Software Clarisoft para impressora Videojet 6530								
6.3	DISASTER RECOVERY	Módulo de recuperação de dados e configurações do sistema								
6.4	VALIDATION PACKAGE	Pacote de validação GAMP5 nível 2 (FDS, P&ID, IQ, OQ, PQ, relatórios FAT/SAT) em inglês								
6.5	TRADUCAO VALIDACAO PT	Tradução do pacote de validação de inglês para português								
6.6	INST-SAT-TREINO-ETIP ACK	Instalação, arranque, SAT e treinamento no local por técnico Etipack, 10 dias (inclui viagens, alojamento, alimentação e transferes)								
7	ZS-AFY1	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50–250 mL,20–60 frascos/min) — acessórios incluídos: esteira, distribuído	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	5 208 010,51	5 208 010,51	833 281,68	6 041 292,19
8	MIELE PLW 8693 & Basket set Basic & Inserto MIELE E 118 & ProCare Lab 10MA & ProCare Lab 30C	Máquina de lavar vidro de laboratório MIELE PLW 8693 com Dry Plus (DSS), caixa em inox; inclui dispensador de líquido e lança de aspiração com deteção de nível vazio;Conjunto de cestos "Basic" p/ PLW 8693: A101 cesto,superior, A150 cesto inferior, módulos injector A300/3 (vidraria 250–1000 ml) e A301/5 (50–250 ml), 2× AK12/1 e bocal de rinse A802 p/ doseador de pó;Inserto MIELE p/ 38 placas de Petri semi-tampas 100 mm, nível superior,Detergente ProCare Lab 10MA, 5 L;Neutralizador ProCare Lab 30C, 5 L	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	2 096 104,29	2 096 104,29	335 376,69	2 431 480,98
9	CON-TRIPOD	Suporte tripode de aço para laboratório (altura 200 mm)	RSA	30 Dias Úteis	3	UN	1 405,35	4 216,05	674,57	4 890,62
10	4240400	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	330 997,17	661 994,34	105 919,09	767 913,43
11	3581200	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	RSA	45 Dias Úteis	1	UN	208 177,84	208 177,84	33 308,45	241 486,29
12	BRAND® 137618	Magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring L 51 mm, bar diam. 8 mm	RSA	45 Dias Úteis	5		36 898,00	184 490,00	29 518,40	214 008,40
13	HCP-168	CO ₂ incubator(Ambient +5 °C to ~60 °C; CO ₂ 0–20% (IR sensor); humidity up to ~95%; typical volume 180 L; sterilisation 140 °C (some up to 180 °C); PID + touch screen; HEPA (ISO Class 5); fast)	China	90 Dias Úteis	1	UN	528 387,61	528 387,61	84 542,02	612 929,63
14	630-3290	VISISCOPE BL224PL T1(Microscópio digital VISISCOPE BL224PLT1)&Instalação, arranque e treinamentono local por técnico	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	329 412,46	329 412,46	52 705,99	382 118,45
15	LX-165T2-J+fixed-angle rotor (Plastic cover)24×1.5/2.0ml +Hematocrit rotor 24 Capillaries	Microhaematocrit centrifuge(Independent speed and time; intuitive menu; brushless DC; pulse. Haematocrit rotor 24 capillaries / 12,000 rpm; tube rotor 1.5/2 mL × 24 / 14,000 rpm; 200–12,000 rpm; max RCF 13,680; 8.5–10.5 kg; 364×280×274 mm. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	150 105,93	150 105,93	24 016,95	174 122,88
					Total Em Meticais			94 732 693,83	15 157 231,01	109 889 924,84

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO



CONCURSO PÚBLICO Nº 35A003641/CP/03/2026

Endereço: Rua da França, Nº273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
16	HRLM-60A	Vertical benchtop autoclave 50 L(Programmable, electric, stainless steel, with drying, 50 L; 105–134 °C; LCD; fully automatic cycle (preheat, replace, pulse exhaust, heat, sterilise, dry); 0.22 µm air filter. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	430 249,95	430 249,95	68 839,99	499 089,94
17	HRLM-45	Vertical laboratory autoclave(Systec DE-45 or equivalent. 45 L nominal; 316L chamber (344x500 mm); up to 140 °C and 4 bar; 220–240 V; microprocessor control; digital documentation options. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	419 942,28	419 942,28	67 190,76	487 133,04
18	MSV-3500&SV-4/30	Vortex digital multi-tubos 300–3500 rpm (tubos 0,2–50ml; plataformas não incluídas)&Plataforma SV-4/30 para 4x50 ml (30 mm) — acessório do vortex MSV-3500	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	153 477,57	153 477,57	24 556,41	178 033,98
19	Duo 60 (7-in-1) 6 L	Panela de pressão 6 L inox, painel digital, função «Keep Warm», válvula de segurança — inclui panela interior inox e grelha de vapor	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	51 671,60	103 343,20	16 534,91	119 878,11
20	DE-45 (ref. fabr. 1545)	Autoclave vertical de laboratório 45L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto inox adicional e kit de documentação digital	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	2 440 717,96	2 440 717,96	390 514,87	2 831 232,83
21	LTC4R	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido (TX150-R4R) -30 a +100 °C, 20,l, ±0,1 °C, 18 l/min, 1,84 kW, com mangueiras e clips	UK	30 Dias Úteis	1	UN	2 086 383,32	2 086 383,32	333 821,33	2 420 204,65
22	E-CC90-D	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50–90 mm placa Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3x/9x	RSA	30 Dias Úteis	3	UN	48 415,67	145 247,01	23 239,52	168 486,53
23	VP125	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40–60 L/min, ε 10 Pa, 220V — inclui filtro de entrada e carga de óleo	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	43 324,84	86 649,68	13 863,95	100 513,63
24	PH800	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1–3 pontos; monitorização do eletrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eletrodo 201T-FATC)	RSA	30 Dias Úteis	10	UN	76 248,05	762 480,50	121 996,88	884 477,38
25	DW-86L579	Ultra-low freezer (–70 °C)(Vertical laboratory freezer down to –86 °C, settable to –70 °C; ~500 L; stainless interior; microprocessor control; audiovisual alarm; insulated inner doors; high-efficiency refrigeration; vaccines, biologicals and cultures. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	2	UN	679 682,78	1 359 365,56	217 498,49	1 576 864,05
26	CNW-TY1304 (Coplin vidro c/ tampa)	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa	RSA	30 Dias Úteis	5	UN	6 007,57	30 037,85	4 806,06	34 843,91
27	613-7138	VWR EHP — micropipeta mecânica monocanal volume variável 1000–10000 µl (autoclavável;resistente a UV)	RSA	30 Dias Úteis	20	L	42 825,09	856 501,80	137 040,29	993 542,09
28	BAILUNBIO-7000SJA-G MP	BAILUNBIO-7000SJA-GMP-Fermentador automático GMP em aço inoxidável 316L, 7000 L, PLC	China	90 Dias Úteis	1	UN	37 190 606,71	37 190 606,71	5 950 497,07	43 141 103,78
28.1	DOC-FAT-SAT-IQ-OQ-P Q	Documentação de validação FAT, SAT, IQ, OQ e PQ do fermentador								
28.2	INST-TREINO-BAILUN	Instalação, arranque e treinamento no local por 2 técnicos do fabricante, 15 dias (inclui viagens, vistos, alojamento e transporte)								
					Total Em Meticais			94 732 693,83	15 157 231,01	109 889 924,84

7. Requisitos para Qualificação e Anexos

A) Documentos obrigatórios do Documento de Concurso:

- Cadastro único válido de fornecedores de bens ao Estado (n.º 8.1);
 - Facturação em actividades similares ao objecto da contratação, no mínimo 3 (n.º 8.2);
 - Declaração comprovativa das **instalações e equipamentos** adequados e disponíveis, com dados para verificação (n.º 8.2);
 - Declaração comprovativa da **equipa profissional e técnica**, acompanhada dos respectivos currículos (n.º 8.2);
 - Declaração de **experiência em actividades similares**, emitida por pessoa de direito público ou privado, no mínimo 3 (n.º 8.2);
 - **Capital social** não inferior a 500.000,00 MT (n.º 8.2);
 - Garantia mínima dos equipamentos de **12 meses** (n.º 8.2);
 - Catálogos dos bens a fornecer, com as descrições das especificações técnicas (n.º 8.2);
 - Autorização do fabricante (n.º 15.1.2) e **certificado de origem** (n.º 8.2);
 - **Montagem, testagem dos equipamentos e treinamento dos técnicos**, incluídos no fornecimento (n.º 8.2);
 - Após adjudicação: certidão válida de quitação, declaração do INSS e declaração de não falência ou concordata (n.º 8.7).
- **Declaração de Garantia Provisória reconhecida em notário**, com validade de **150 (cento e cinquenta) dias** (n.º 23.1.1).

B) Condições gerais da participação:

- Proposta redigida em **língua portuguesa** (n.º 16.1);
 - Preços cotados em **Meticais**, correspondendo a 100% do lote único (n.º 12.1 e 14.1);
 - Apresentação de **2 exemplares (ORIGINAL e CÓPIA)**, em invólucro opaco fechado e selado (n.º 11.1);
 - Validade da proposta: **120 (cento e vinte) dias** (n.º 19.1);
 - Critério de avaliação: **Menor Preço Avaliado** (n.º 26 e 27);
 - Apresentação das propostas: **18/09/2026, 10:00**, no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), Av. das FPLM, n.º 2698, Maputo (n.º 17);
 - Abertura das propostas: **18/09/2026, 10:15**, Sala Save – Recinto do IIAM, Maputo (n.º 18).
- Garantia Provisória de **405.000,00 MT (quatrocentos e cinco mil Meticais)**, com validade de **150 (cento e cinquenta) dias** (n.º 23).