

ORIGINAL

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

PROPOSTA TÉCNICA & FINANCEIRA

Data:

08/09/2026

Concurso Limitado N° 35A003641/PD/05/2026

**REAGENTES E CONSUMÍVEIS
DE LABORATÓRIO**



Infinity Health, SA
Rua de França, nº273, Bairro da Coop - Maputo
Nuit:401550216
Tel.: +258 848770340/ 870867668
Email: comercial@infinityhealth.co.mz

ÍNDICE GERAL

Nº	TÓPICO	PÁGINA
1.0	INFORMAÇÕES DO CONCORRENTE	4
2.0	APRESENTAÇÃO DA INFINITY HEALTH, SA	5
3.0	DESCRIÇÃO DOS PARCEIROS E MARCAS	6
4.0	OBJECTO DA PROPOSTA (Equipamento de Frio)	8
5.0	PROPOSTA TÉCNICA E METODOLOGIA	10
5.1	Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade	10
5.2	Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade	11
5.3	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	13
6.0	PROPOSTA FINANCEIRA	15
7.0	REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ANEXOS	17

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

REF.	DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Tabela 1	Informações do Concorrente	4
Tabela 2	Exemplos de fornecimento de equipamento	9
Tabela 3	Resumo do objecto da proposta	8
Tabela 4	Tabela de conformidade técnica	11
Tabela 5	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	13
Tabela 6	Planilha de preços dos bens	16
Figura 1	Marcas e representações	7

Tabelas

Tabela	Significado
Tabela 1	Informações do Concorrente
Tabela 2	Alguns exemplos de fornecimento de equipamentos
Tabela 3	Conformidade técnica e especificações técnicas do modelo a fornecer

Abreviaturas

Abreviaturas	Significado
Infinity Health	Infinity Health, SA
N/A	Não Aplicável
IQ	Installation Qualification

1. Informações do Concorrente

Tabela 1. Informações do Concorrente

Denominação Social: Infinity Health, SA
No caso de Consórcio, informar a denominação social de cada membro integrante do Consórcio: N/A
Número de Registo Comercial do Concorrente na Conservatória competente:
Data de Registo do Concorrente na Conservatória:
1. Endereço oficial do Concorrente: Rua da França, n.º 273, Bairro da Coop Telefone: + 258 848770340 Cel: (+258) 870867668 E-mail: info@infinityhealth.co.mz / comercial@infinityhealth.co.mz
Informações sobre o Representante Autorizado do Concorrente Nome: E-mail: comercial@infinityhealth.co.mz
2. Encontram-se anexas cópias dos originais dos seguintes documentos:

2. Apresentação

A Infinity Health, SA é uma empresa moçambicana, de capitais nacionais, cujo objecto social consiste em contribuir para o melhoramento da saúde pública em Moçambique, através de:

- 2.1. Importação, exportação e comércio geral de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais;
- 2.2. Estabelecimento de uma Unidade de Consultoria de Monitoria e Controlo de Qualidade de Laboratórios Clínicos, bem como a organização de formações técnicas na área de saúde pública.

Desde o estabelecimento da empresa, em 2023, todos os esforços e recursos estiveram sempre centrados na criação de parcerias internacionais e no aperfeiçoamento das nossas capacidades de importação e distribuição de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Este exercício assenta na definição de estratégias que visam disponibilizar produtos e equipamentos de qualidade a preços mais acessíveis.

Por isso, a definição das marcas a representar obedece ao padrão internacional de qualidade, procurando-se sempre alternativas de fornecimento adequadas às capacidades financeiras do cliente.

Estamos convictos de que podemos contribuir para o melhoramento da saúde em Moçambique, minimizando o impacto que as condições sociais dos cidadãos têm sobre o acesso aos serviços de saúde.

Há muito a dizer sobre a nossa visão e estratégia de apoio ao sector da saúde, sendo impossível esgotar o tema num texto ou numa conversa. Convidamos, por isso, V. Ex.as a contactar-nos a qualquer momento para explorar a gama de produtos e serviços que disponibilizamos. Poderão também, sempre que necessário, enviar qualquer pedido de cotação, esclarecimento ou reclamação para o nosso e-mail comercial@infinityhealth.co.mz.

3. Parceiros

Somos representantes oficiais e exclusivos da **MGI Tech Co., Ltd. (MGI)** para soluções de sequenciação genética DNBSEQ, automação MGISP e reagentes laboratoriais; da **Haier Biomedical** para cadeia de frio ultra-baixa (-86 °C), refrigeração médica, cabines de biossegurança e tanques de nitrogénio líquido; da **Dräger** para estações de anestesia, ventiladores, monitorização de pacientes e incubadoras neonatais; e da **Adams Equipment** para centrifugação, analisadores de hematologia e balanças laboratoriais de precisão.


Somos distribuidores oficiais, autorizados por acordo, da **Olympus** para microscopia, sistemas de endoscopia e imagiologia de ciências da vida; da **BD – Becton Dickinson** para diagnósticos, biosciências e dispositivos médicos; da **Elabscience** para kits ELISA, anticorpos, proteínas e reagentes de investigação; e da **Zeiss** para sistemas de microscopia, oftalmologia e metrologia industrial, entre outras marcas de referência internacional.

Definimos a origem das aquisições a partir das referências indicadas pelos nossos clientes; na ausência destas, baseamo-nos na experiência técnica da nossa equipa para aconselhar a melhor marca, de acordo com os objectivos e as capacidades financeiras.

3.1. Nossas Marcas

CORPORATE BRAND HIERARCHY


Parent Companies & Subsidiary Branches

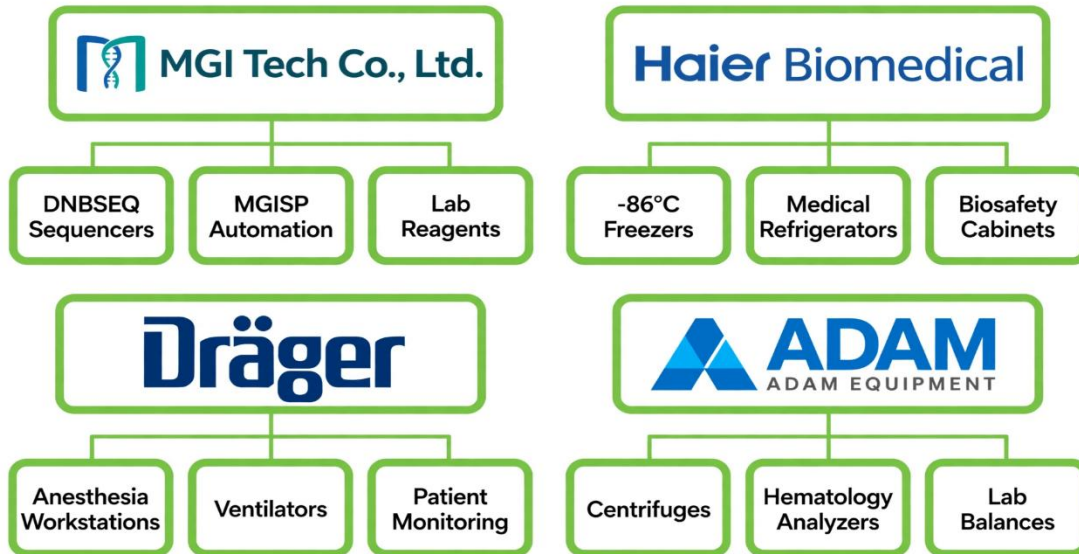

Corporate Brand Structure • Medical & Laboratory Equipment Portfolio • 2024

CORPORATE BRAND HIERARCHY

Parent Companies & Child Branch Divisions

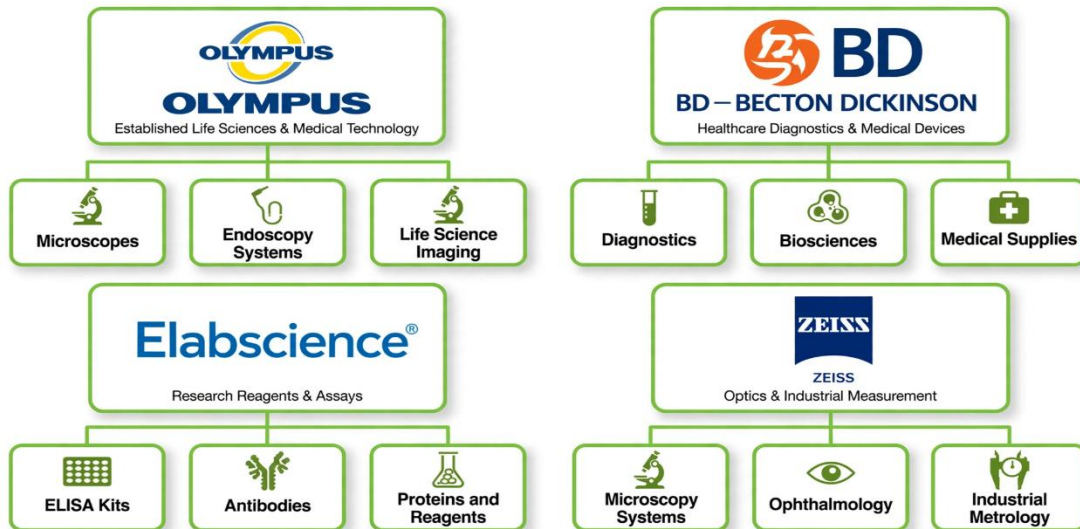

Corporate Hierarchy — Overview for Medical Proposal | Generated for Strategic Partnership Review | 2024

4. Objecto da Proposta

A presente proposta tem por objecto o fornecimento de **diverso equipamento de frio** destinado ao **Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)** , no âmbito do concurso abaixo resumido.

Concurso	Concurso Limitado N° 35A003641/CL/03/2026
Entidade Contratante	Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
Objecto	Fornecimento de diverso equipamento de frio (geleiras, câmara fria, liofilizador, termo-higrómetros e ar condicionado) para o IIAM
Âmbito do fornecimento	6 rubricas: geleiras para vacinas (2+3), geleira de laboratório, termo-higrómetro, câmara fria, liofilizador e ar condicionado (9)
Modalidade	Concurso Limitado — Lote Único
Regime de contratação	
Critério de avaliação	Menor Preço Avaliado
Prazo de entrega	Mínimo 15 dias, máximo 3 meses
Local de entrega	IIAM — Direcção de Ciências Animais (DCA), Km 1.5 — Maputo
Validade da proposta	90 dias

Tabela 3. Resumo do objecto da proposta

A Infinity Health, SA compromete-se a fornecer a totalidade dos itens em conformidade com as especificações técnicas constantes da Parte II.1 — Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo a montagem, a testagem dos equipamentos e o treinamento dos técnicos, com garantia mínima de 12 meses.

Tabela 2. Alguns exemplos de fornecimento de equipamento

Instituição	Período	Modelo Fornecido
Universidade Eduardo Mondlane	2025-HZS-60 - Drying Oven	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-30L520F -30°C Biomedical Freezer (Forced Air Cooling)	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-40L568J -40°C Biomedical Freezer (Upright)	

5. Proposta Técnica e Metodologia

A presente proposta técnica foi elaborada com base no **Concurso Limitado N° 35A003641/CL/03/2026** e nas Especificações Técnicas da Parte II.1 do Caderno de Encargos, para o fornecimento de diverso equipamento de frio ao IIAM.

5.1. Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade

A Infinity Health, SA fornecerá equipamento de frio de fabricantes internacionais reconhecidos, com sistemas de gestão da qualidade certificados (**ISO 13485** e **ISO 9001**) e marcação **CE** . Todos os bens são acompanhados de **catálogos e fichas técnicas** , conforme exigido no Documento de Concurso (n.º 8.2).

A empresa apresenta **autorização do fabricante e certificado de origem** dos equipamentos propostos (n.º 8.2 e 15.1.2), e dispõe de documento autorizado para a importação dos equipamentos.

Metodologia de Fornecimento

- **Seleção e conformidade:** cada item cumpre integralmente as especificações da Parte II.1 (temperaturas, capacidades, dimensões e normas aplicáveis).
- **Aquisição e importação:** as encomendas são colocadas junto de fabricantes/fornecedores qualificados, com documentação de origem e autorização de importação.
- **Controlo de qualidade:** verificação de conformidade com as fichas técnicas e integridade das embalagens antes da expedição.
- **Entrega e instalação:** transporte, montagem, testagem e treinamento dos técnicos no IIAM — Direcção de Ciências Animais, Km 1.5, Maputo, no prazo máximo de 3 meses.
- **Garantia e peças de reposição:** garantia mínima de 12 meses e manutenção/peças asseguradas em Moçambique.

Enquadramento da Proposta

- Cotação correspondente a **100% do lote único** especificado (n.º 12.1).
- Regime de contratação por **Preço Global** (Decreto n° 79/2022, de 30 de Dezembro).
- Proposta apresentada em **língua portuguesa** (n.º 16.1); preços cotados em Metical (n.º 14.1).
- Validade da proposta: **90 (noventa) dias** (n.º 19.1).
- Apresentação de 1 original e 1 cópia, em invólucro opaco selado (n.º 11.1).

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

As especificações técnicas dos bens propostos foram elaboradas em estrita conformidade com as exigências constantes da **Parte II.1 — Especificações Técnicas** do Caderno de Encargos do Concurso N° 35A003641/CL/03/2026. O quadro seguinte demonstra a conformidade item a item.

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade
01	Geleiras para vacinas	Refrigerador combinado +2 a +8 °C e congelador -10 a -40 °C; dimensões externas 810×735×1960 mm; dimensões internas (650×570×627)×2 mm; volume útil total 450 L.	CUMPRE
02	Geleira	Frigorífico/congelador combinado de laboratório LFF 660; capacidade 288 L; temperaturas +1/+10 °C e -10/-30 °C; refrigeração por ar forçado.	CUMPRE
03	Termómetro-higrómetro com sensor externo	Termómetro-higrómetro digital com sonda externa, higrómetro e relógio integrados (mod. TH-402); intervalo -50 a 70 °C; precisão ±1 °C; humidade 10–99% UR (±5%); leitura máx./mín.; exibição simultânea int./ext.; 1 pilha AAA de 1,5 V.	CUMPRE

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade (continuação)

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade
04	Câmara Fria combinada	Refrigerador combinado +2 a +8 °C e congelador -10 a -40 °C; dimensões externas 810×735×1960 mm; dimensões internas (650×570×627)×2 mm; volume útil total 450 L.	CUMPRE
05	Liofilizador	Liofilizador laboratorial em aço inoxidável para secagem por congelamento de produtos biológicos e vacinas; condensador de baixa temperatura (-55 a -80 °C); sistema de vácuo de alta eficiência; controlo digital programável de temperatura e pressão; bandejas em aço inox; bomba de vácuo integrada.	CUMPRE
06	Ar condicionado	Ar condicionado para laboratório, tipo Split Inverter, 18.000 BTU/h (30-40 m²); 220-240 V / 50 Hz; classe de eficiência A; gás R32 ou R410A; temperatura ajustável 16-30 °C; refrigeração, desumidificação, ventilação e modo automático; filtro antibacteriano e anti-poeira lavável; ≤45 dB; reinício automático; protecção contra sobrecarga.	CUMPRE

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Apresenta-se em seguida uma amostra representativa dos bens propostos, com a descrição, especificações técnicas, marca, país de origem e imagem do produto de cada fornecedor. As referências completas constam da planilha de preços.

Geleiras para vacinas (2 un.)	Refrigerador combinado +2 a +8 °C e congelador -10 a -40 °C; volume útil 450 L; 810×735×1960 mm	Haier Biomedical HYCD-469A	China	
Geleira de laboratório (3 un.)	Frigorífico/congelador combinado de laboratório; 282 L (185+97); +2/+8 °C e -10 a -40 °C; display LED	Haier Biomedical HYCD-282A	China	
Termómetro-higrómetro com sensor externo	Digital de precisão, sonda externa 3 m, triplo display e alarmes; -50 a 70 °C; ±1 °C; UR 10-99%; inclui calibração metrológica	PH1000 / A2000-EX	África do Sul (RSA)	

Tabela 5. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA (continuação)

Câmara Fria combinada (1 un.)	Refrigerador combinado +2 a +8 °C e congelador -10 a -40 °C; volume útil 450 L; 810×735×1960 mm	Haier Biomedical HYCD-469A	China	
Liofilizador (1 un.)	FlexiFreeze floor-standing, aço inoxidável; condensador -86 °C; 4 kg/24 h; bomba de vácuo WYB (VRD-4-FY)	Haier Biomedical HDG-86Z04-12	China	
Ar condicionado (9 un.)	Split Inverter 18.000 BTU/h; 220-240 V/50 Hz; R32/R410A; 16-30 °C; ≤45 dB; reinício automático	Hisense	Moçambique	

Tabela 5. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA (continuação)

6. Proposta Financeira

Prezados Senhores e/ou Senhoras,

a) Examinámos os documentos do **Concurso Limitado N° 35A003641/CL/03/2026**, referente ao fornecimento de diverso equipamento de frio para o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), e apresentamos a nossa proposta sem reservas, em conformidade com o Decreto n° 79/2022, de 30 de Dezembro.


b) Os preços da nossa proposta constam da Planilha de Preço **3.315.914,24 MT** (Três milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e catorze Meticais e vinte e quatro centavos), conforme apresentado adiante, com base no Mapa de Quantidades e nas Especificações Técnicas do Caderno de Encargos.

c) Declaramos que não estamos enquadrados em qualquer situação de impedimento prevista na legislação aplicável.

d) Esta proposta tem validade de **90 (noventa) dias**, conforme o n.º 19.1 do Documento de Concurso e, juntamente com a vossa aceitação por escrito constante da notificação de adjudicação, será considerada como contrato vinculativo entre as partes, até que um contrato formal seja assinado.

e) Compreendemos que não estão obrigados a aceitar a proposta de menor preço ou qualquer outra proposta que venham a receber.

Maputo, 02 de Agosto de 2026

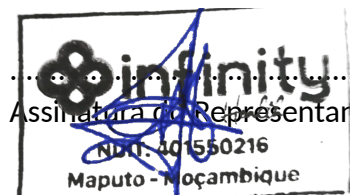
Assinatura do Representante Autorizado
NÚM. 401550216
Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

CONCURSO PÚBLICO N° 35A003641/CP/03/2026



Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
1	HR1200-IIA2-G	BSL-2. Switchable airflow 70% recirculation/30% exhaust (A2) and 100% exhaust (B2); one-touch automatic mode change. EC motor; ISO 5 workspace; HEPA 99.99%; negative-pressure plenum. Use: biological samples, hazardous chemicals, cytotoxics and pharma assays. Includes assembly and training.	China	90 Dias Úteis	6	UN	530 327,83	3 181 966,98	509 114,72	3 691 081,70
2	LX-210L750R+LX-101-750R fixed-ngle rotor 6x500ml	Refrigerated centrifuge for 500 mL bottles(Max speed 22,000 rpm; 21,000rpm max RCF 52,050 × g; 47,400 × g;capacity 6 × 500 mL; Comply;−20 °C to +40 °C; ±1 °C; Comply;speed accuracy ±10 rpm; Comply,1 s-99 h 59 min 59 s; Comply;noise ≤ 65 dB(A); Comply ≤ 56 dB(A);5,000 W; 3400W;740x720x900 mm; 740*920*990mm 250 kg. 375kg Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	2	UN	1 175 084,90	2 350 169,80	376 027,17	2 726 196,97
3	LX-500R+155T500R fixed-angle rotor 12x15ml	Refrigerated centrifuge for 15 mL tubes(Benchtop, Comply CFC-free compressor, brushless motor.Comply;≥ 15,000 rpm; Comply;155,500rpmRCF ≥ 20,000 × g; Comply, 26.322xg,−10 °C or lower to +40 °C; -20□40°C,±2 °C Better, ±1 °C; fixed-angle rotor ≥ 12 × 15 mL, anodised aluminium; Comply;LCD/TFT; electronic lid lock; Comply;noise ≤ 65 dB; 220-240 V 50/60 Hz; Comply;CE, ISO 9001 and ISO 13485. Includes assembly and training.Comply)	China	90 Dias Úteis	1	UN	535 360,27	535 360,27	85 657,64	621 017,91
4	SX-50 SpeedFill & Tubo-SIL-3.2 & DY-SIL-3.2 & Tubo-SIL-6.4 & DY-SIL-6.4 & Tubo-SIL-8.0 & DY-SIL-8.0	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5–500 ml; ±1%; servomotor; cGMP-US FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos);Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 3,2 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 3,2 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 6,4 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 6,4 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 8 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 8 mm;Serviço — Instalação, arranque e treinamento executados por técnico DARA (1 dia; vias e alojamento incluídos	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	2 552 436,52	5 104 873,04	816 779,69	5 921 652,73
5	SX-140-C & CO-5ml	Máquina de bancada para fecho automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática crimping; AISI-304; rodeta estrela POM; bimanual; até 1.000–1.500 uph; preparada p/ 1 formato frasco 5 ml + 1 formato tampa alu);Kit de changeover (rodeta/peças de adaptação) para formato adicional de frasco;Serviço — Documentação de validação IQ/OQ (Installation/Operational Qualification — entrega de protocolos)	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	3 215 928,92	6 431 857,84	1 029 097,25	7 460 955,09
6	ZS-TB800	Máquina de rotulagem automática (GMP/BPF, PLC touchscreen, esteira motorizada) — acessórios incluídos: esteira motorizada, sensor fotoelétrico e aplicador	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	507 778,80	507 778,80	81 244,61	589 023,41
7	ZS-AFY1	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50–250 mL,20–60 frascos/min) — acessórios incluídos: esteira, distribuído	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	5 208 010,51	5 208 010,51	833 281,68	6 041 292,19

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

CONCURSO PÚBLICO N° 35A003641/CP/03/2026



Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
8	MIELE PLW 8693 & Basket set Basic & Inserto MIELE E 118 & ProCare Lab 10MA & ProCare Lab 30C	Máquina de lavar vidro de laboratório MIELE PLW 8693 com Dry Plus (DSS), caixa em inox; inclui dispensador de líquido e lança de aspiração com detecção de nível vazio; Conjunto de cestos "Basic" p/ PLW 8693: A101 cesto superior, A150 cesto inferior, módulos injector A300/3 (vidraria 250–1000 ml) e A301/5 (50–250 ml), 2× AK12/1 e bocal de rinse A802 p/ doseador de pó; Inserto MIELE p/ 38 placas de Petri semi-tampas 100 mm, nível superior, Detergente ProCare Lab 10MA, 5 L; Neutralizador ProCare Lab 30C, 5 L	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	2 096 104,29	2 096 104,29	335 376,69	2 431 480,98
9	CON-TRIPOD	Suporte tripode de aço para laboratório (altura 200 mm)	RSA	30 Dias Úteis	3	UN	1 405,35	4 216,05	674,57	4 890,62
10	4240400	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	330 997,17	661 994,34	105 919,09	767 913,43
11	3581200	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878)	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	208 177,84	208 177,84	33 308,45	241 486,29
12	BRAND® 137618	Magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring L 51 mm, bar diam. 8 mm	RSA	30 Dias Úteis	5	UN	36 898,00	184 490,00	29 518,40	214 008,40
13	HCP-168	CO ₂ incubator(Ambient +5 °C to ~60 °C; CO ₂ 0–20% (IR sensor); humidity up to ~95%; typical volume 180 L; sterilisation 140 °C (some up to 180 °C); PID + touch screen; HEPA (ISO Class 5); fast)	China	90 Dias Úteis	1	UN	528 387,61	528 387,61	84 542,02	612 929,63
14	VISISCOPE BL224PL T1	Microscópio digital composto VISISCOPE® BL224PL T1 (contraste/fundo claro, câmara digital T1;	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	271 794,59	271 794,59	43 487,13	315 281,72
15	LX-165T2-J+fixed-angle rotor (Plastic cover)24x1.5/2.0ml +Hematocrit rotor 24 Capillaries	Microhaematocrit centrifuge(Independent speed and time; intuitive menu; brushless DC; pulse. Haematocrit rotor 24 capillaries / 12,000 rpm; tube rotor 1.5/2 mL × 24 / 14,000 rpm; 200–12,000 rpm; max RCF 13,680; 8.5–10.5 kg; 364×280×274 mm. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	150 105,93	150 105,93	24 016,95	174 122,88
16	HRLM-60A	Vertical benchtop autoclave 50 L(Programmable, electric, stainless steel, with drying. 50 L; 105–134 °C; LCD; fully automatic cycle (preheat, replace, pulse exhaust, heat, sterilise, dry); 0.22 µm air filter. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	430 249,95	430 249,95	68 839,99	499 089,94
17	HRLM-45	Vertical laboratory autoclave(Systec DE-45 or equivalent. 45 L nominal; 316L chamber (344×500 mm); up to 140 °C and 4 bar; 220–240 V; microprocessor control; digital documentation options. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	1	UN	419 942,28	419 942,28	67 190,76	487 133,04

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO



CONCURSO PÚBLICO N° 35A003641/CP/03/2026

Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
18	MSV-3500&SV-4/30	Vortex digital multi-tubos 300–3500 rpm (tubos 0,2–50ml; plataformas não incluídas)&Plataforma SV-4/30 para 4×50 ml (30 mm) — acessório do vortex MSV-3500	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	153 477,57	153 477,57	24 556,41	178 033,98
19	Duo 60 (7-in-1) 6 L	Panela de pressão 6 L inox, painel digital, função «Keep Warm», válvula de segurança — inclui painel interior inox e grelha de vapor	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	51 671,60	103 343,20	16 534,91	119 878,11
20	DE-45 (ref. fabr. 1545)	Autoclave vertical de laboratório 45L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto inox adicional e kit de documentação digital	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	2 440 717,96	2 440 717,96	390 514,87	2 831 232,83
21	LTC4R	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido (TX150-R4R) -30 a +100 °C, 20,l, ±0,1 °C, 18 l/min, 1,84 kW, com mangueiras e clips	UK	30 Dias Úteis	1	UN	2 086 383,32	2 086 383,32	333 821,33	2 420 204,65
22	E-CC90-D	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50–90 mm placa Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3×/9x	RSA	30 Dias Úteis	3	UN	48 415,67	145 247,01	23 239,52	168 486,53
23	VP125	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40–60 L/min, £ 10 Pa, 220V — inclui filtro de entrada e carga de óleo	RSA	30 Dias Úteis	2	UN	43 324,84	86 649,68	13 863,95	100 513,63
24	PH800	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1–3 pontos; monitorização do eletrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eletrodo 201T-FATC)	RSA	30 Dias Úteis	10	UN	76 248,05	762 480,50	121 996,88	884 477,38
25	DW-86L579	Ultra-low freezer (–70 °C)(Vertical laboratory freezer down to –86 °C, settable to –70 °C; ~500 L; stainless interior; microprocessor control; audiovisual alarm; insulated inner doors; high-efficiency refrigeration; vaccines, biologicals and cultures. Includes assembly and training.)	China	90 Dias Úteis	2	UN	679 682,78	1 359 365,56	217 498,49	1 576 864,05
26	CNW-TYI304 (Coplin vidro c/ tampa)	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa	RSA	30 Dias Úteis	5	UN	6 007,57	30 037,85	4 806,06	34 843,91
27	613-7138	VWR EHP — micropipeta mecânica monocanal volume variável 1000–10000 µl (autoclavável;resistente a UV)	RSA	30 Dias Úteis	20	UN	42 825,09	856 501,80	137 040,29	993 542,09
28	BLBIO-SJA 7.000 L	Biofermentador anaeróbico 6.000–7.000 L em AISI 316L,CIP/SIP, painel digital Siemens —inclui sparger N2, sensores pH/nível	RSA	30 Dias Úteis	1	UN	35 309 742,83	35 309 742,83	5 649 558,85	40 959 301,68
							Total Em Meticais	71 609 427,40	11 457 508,38	83 066 935,78

7. Requisitos para Qualificação e Anexos

A) Documentos obrigatórios do Documento de Concurso:

- Cadastro único válido de fornecedores de bens ao Estado (n.º 8.1);
- Facturação em actividades similares ao objecto da contratação, no mínimo 3 (n.º 8.2);
- Declaração comprovativa das **instalações e equipamentos** adequados e disponíveis, com dados para verificação (n.º 8.2);
- Declaração comprovativa da **equipa profissional e técnica**, acompanhada dos respectivos currículos (n.º 8.2);
- Declaração de **experiência em actividades similares**, emitida por pessoa de direito público ou privado, no mínimo 3 (n.º 8.2);
- Garantia mínima dos equipamentos de **12 meses** (n.º 8.2);
- Catálogos dos bens a fornecer, com as descrições das especificações técnicas (n.º 8.2);
- Autorização do fabricante (n.º 15.1.2) e **certificado de origem** (n.º 8.2);
- Montagem, **testagem dos equipamentos e treinamento dos técnicos**, incluídos no fornecimento (n.º 8.2);
- Após adjudicação: certidão válida de quitação, declaração do INSS e declaração de não falência ou concordata (n.º 8.7).

B) Condições gerais da participação:

- Proposta redigida em **língua portuguesa** (n.º 16.1);
- Preços cotados em **Metical**, correspondendo a 100% do lote único (n.º 12.1 e 14.1);
- Apresentação de **2 exemplares (ORIGINAL e CÓPIA)**, em invólucro opaco fechado e selado (n.º 11.1);
- Validade da proposta: **90 (noventa) dias** (n.º 19.1);
- Critério de avaliação: **Menor Preço Avaliado** (n.º 26 e 27).