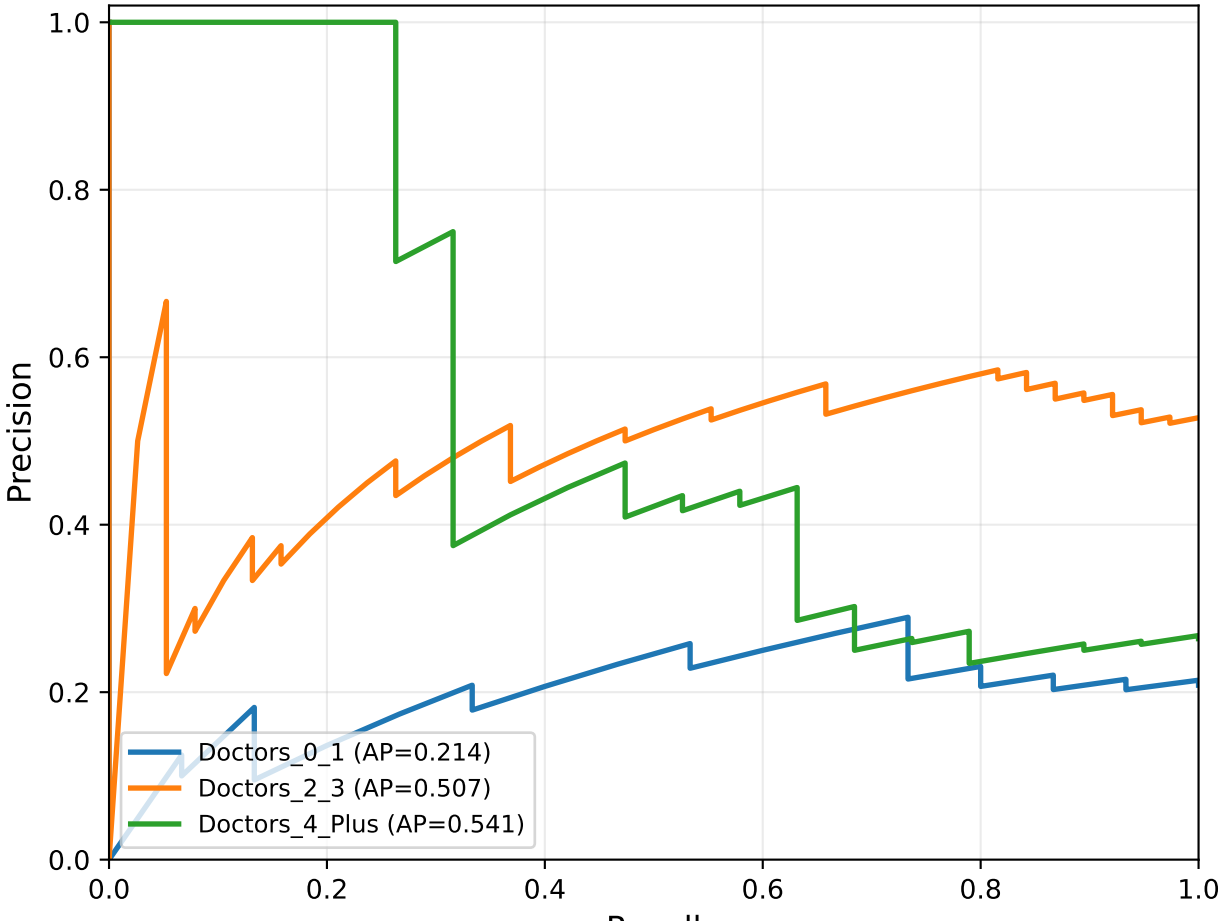
Precision-Recall Curve - FT-Transformer - Validation
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Doctors_0_1 (AP=0.214)
Doctors_2_3 (AP=0.507)
Doctors_4_Plus (AP=0.541)