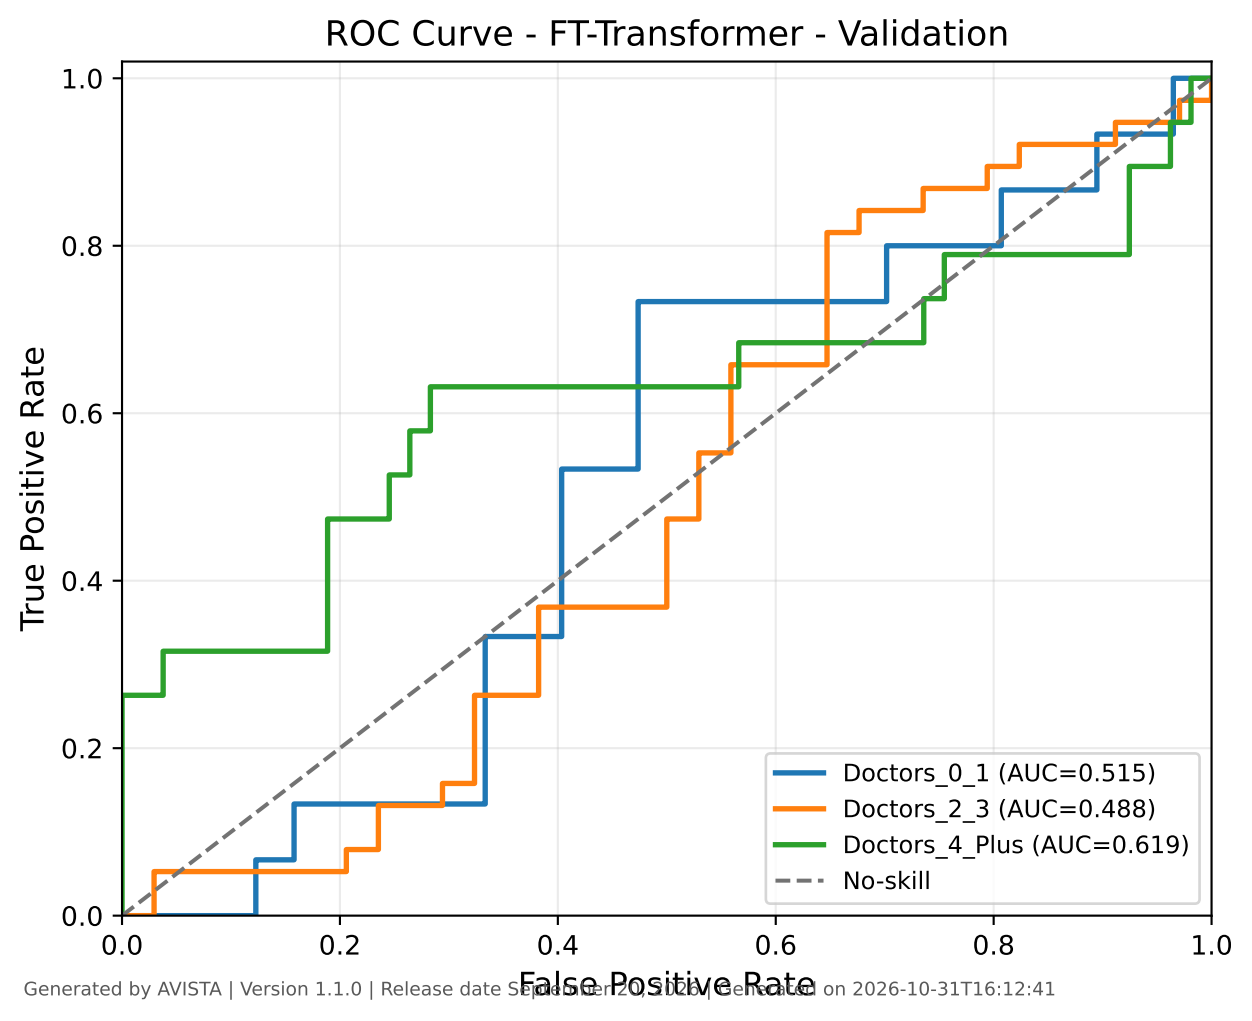
ROC Curve - FT-Transformer - Validation
True Positive Rate
False Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Doctors_0_1 (AUC=0.515)
Doctors_2_3 (AUC=0.488)
Doctors_4_Plus (AUC=0.619)
No-skill
Generated by AVISTA | Version 1.1.0 | Release date September 20, 2025 | Generated on 2026-10-31T16:12:41