


Estimation d’une sensibilité propre à chaque patient à partir de J0–J2, en passant par J0

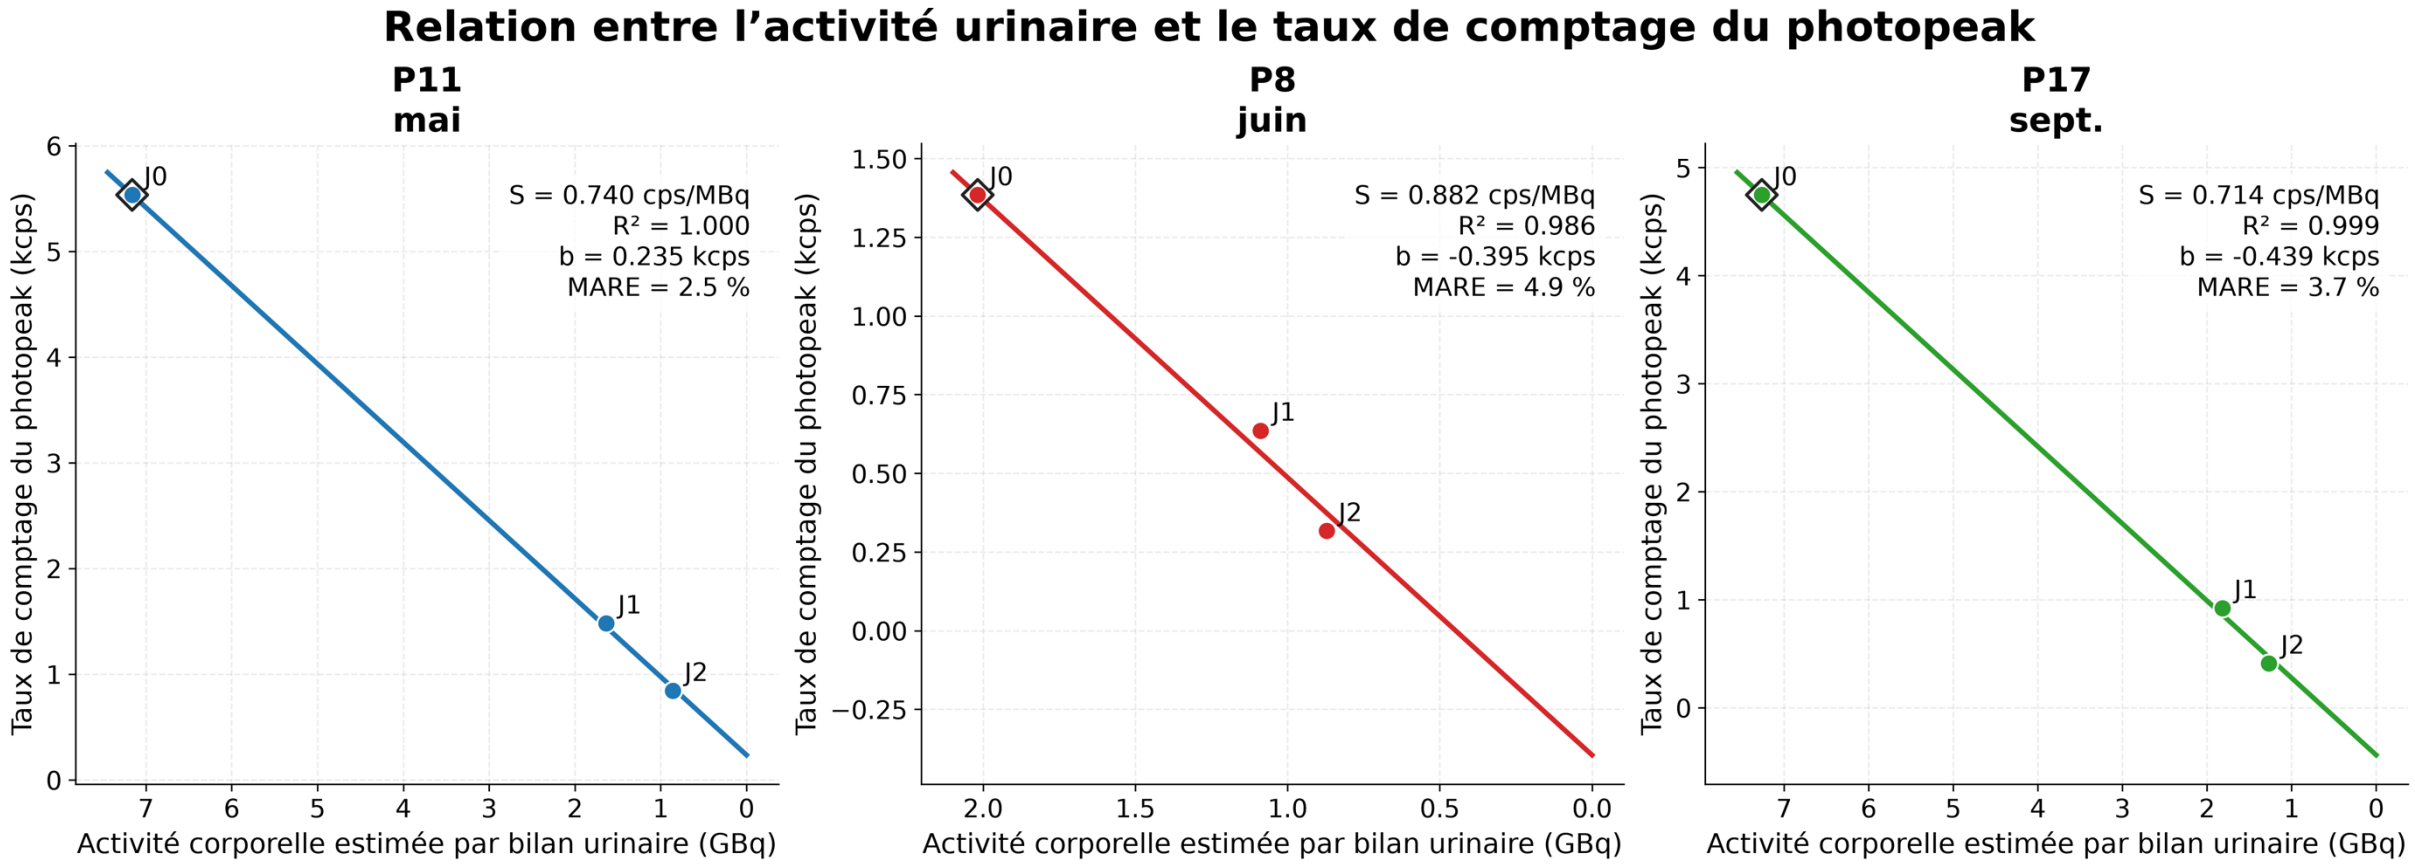

Pente estimée sur J0–J2 avec passage imposé par l’origine

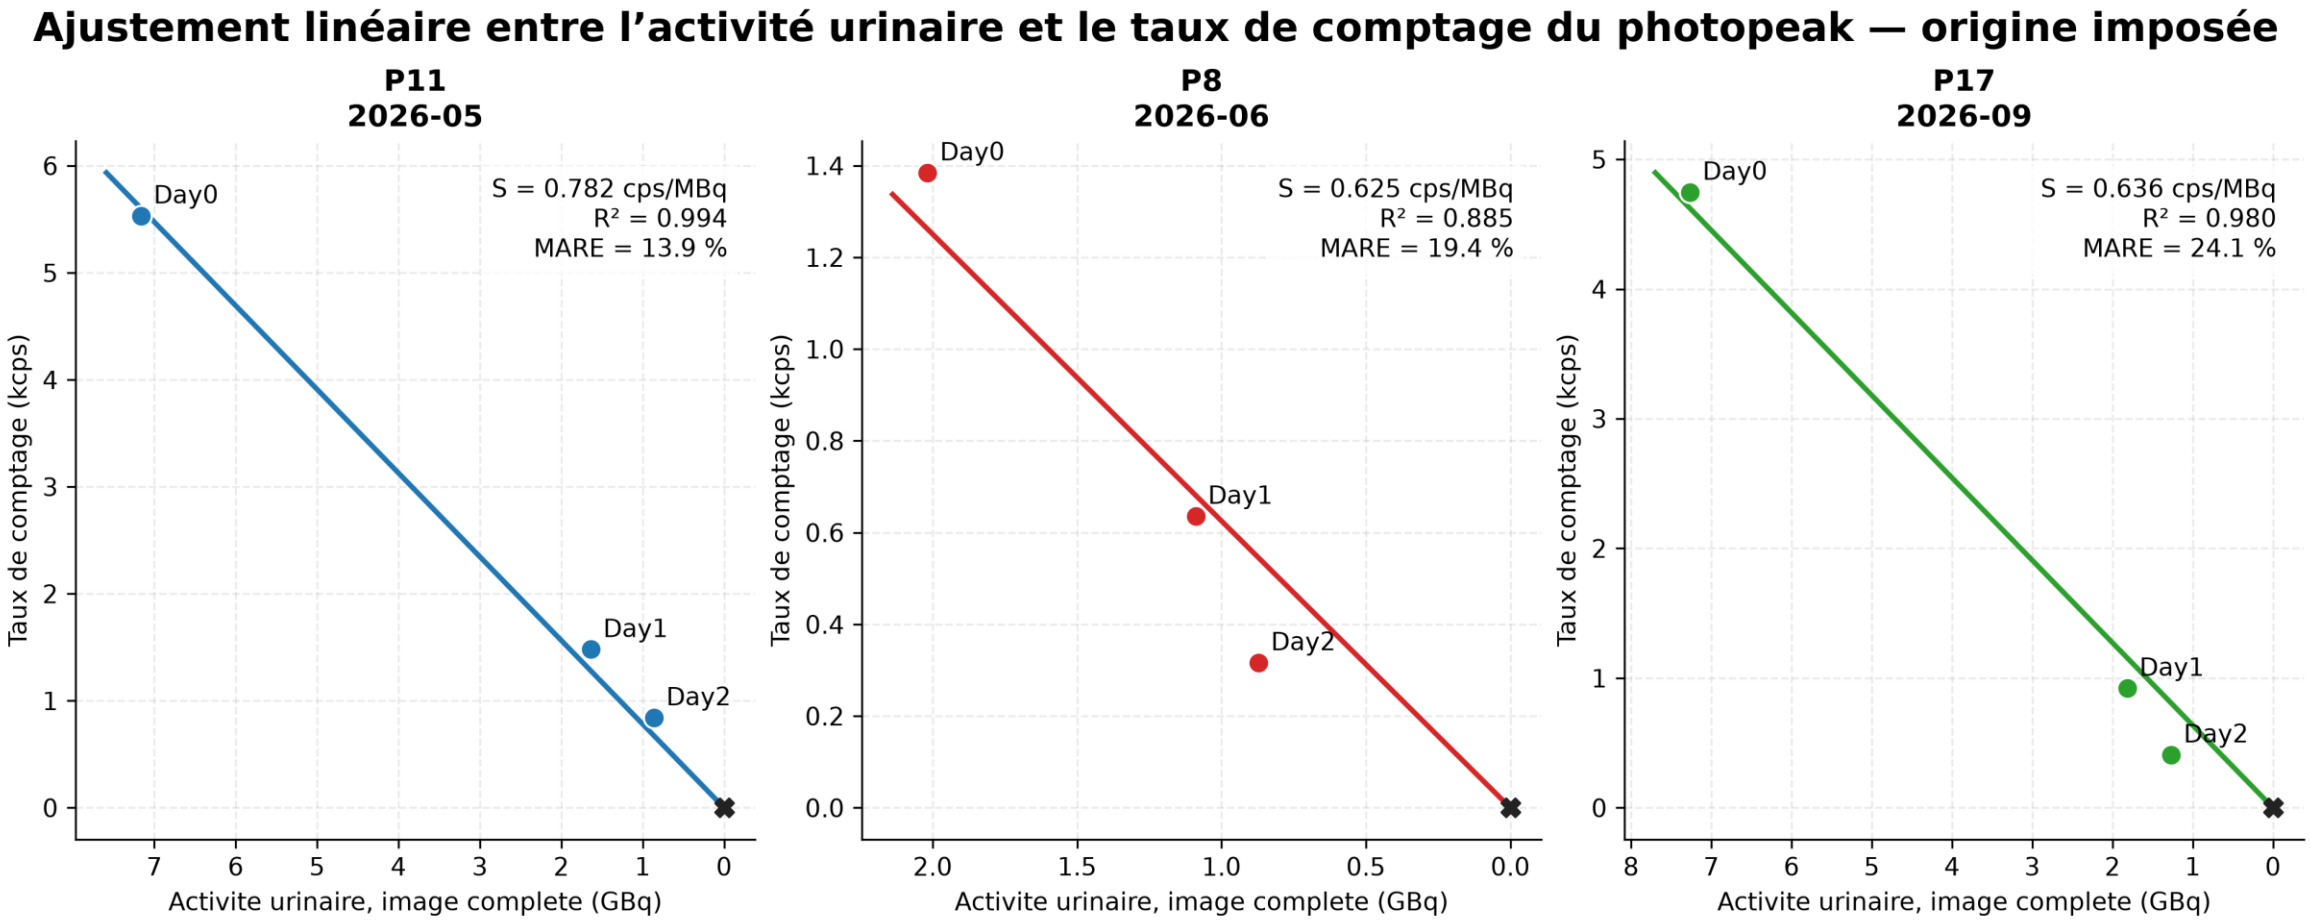

Sensibilité calibrée à J0 avec passage imposé par l'origine

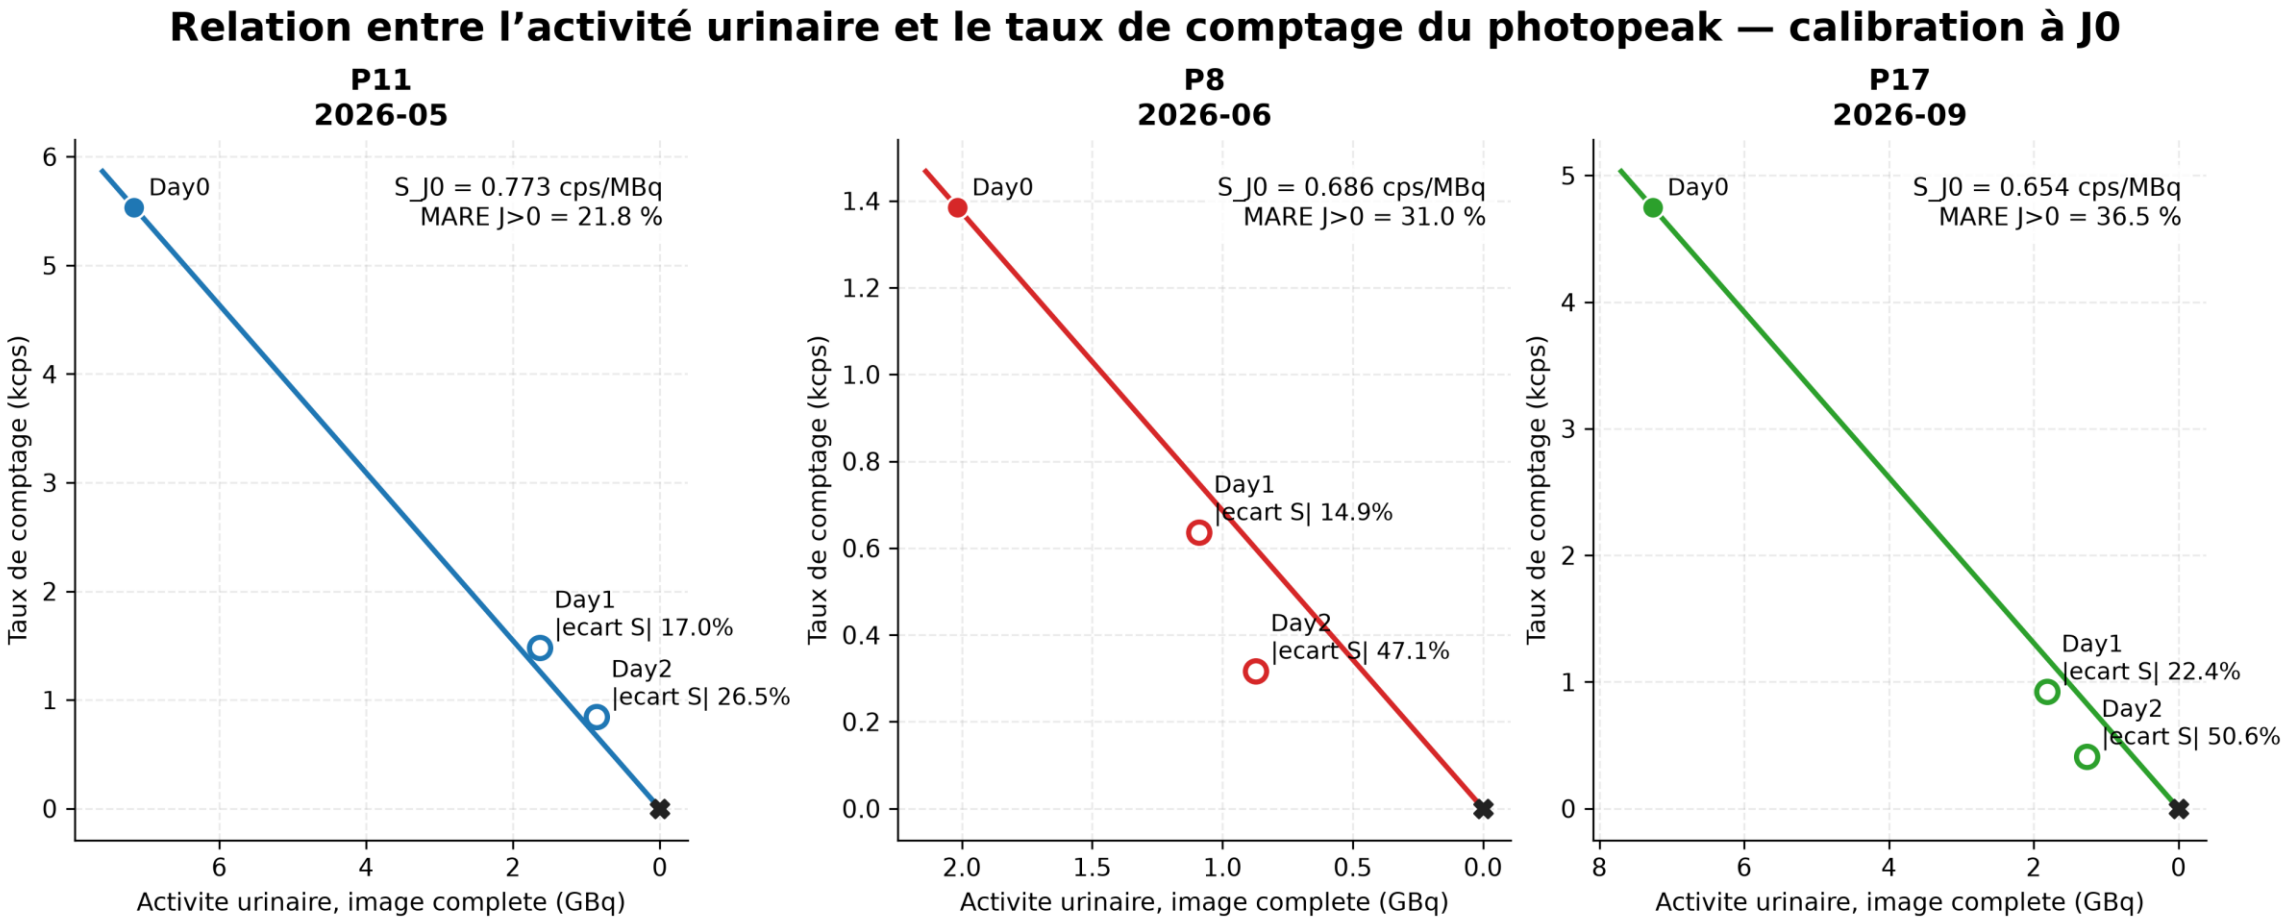

Comparaison des méthodes contraintes à l’origine

Erreurs sur l’activité urinaire : calibration ou ajustement — Photopeak

Patient / cycle	Point	Activité réf. (GBq)	Activité préd. premier point (GBq)	Erreur premier point (%)	Activité préd. pente (GBq)	Erreur pente (%)
P11 — 2026-05	J0	7.160	7.160	+0.0	7.075	-1.2
P11 — 2026-05	J1	1.637	1.916	+17.0	1.893	+15.7
P11 — 2026-05	J2	0.862	1.090	+26.5	1.077	+25.0
P8 — 2026-06	J0	2.018	2.018	+0.0	2.214	+9.8
P8 — 2026-06	J1	1.089	0.927	-14.9	1.017	-6.7
P8 — 2026-06	J2	0.871	0.461	-47.1	0.506	-41.9
P17 — 2026-09	J0	7.262	7.262	+0.0	7.463	+2.8
P17 — 2026-09	J1	1.818	1.411	-22.4	1.451	-20.2
P17 — 2026-09	J2	1.267	0.626	-50.6	0.644	-49.2

Comparaison des ajustements sans passage imposé par l’origine

Patient / cycle	Point	Activité réf. (GBq)	Activité préd. (GBq)	Erreur (%)	MARE 3 points (%)	MARE 2 derniers (%)
P11 — 2026-05	J0	7.160	7.160	+0.0	2.5	3.8
P11 — 2026-05	J1	1.637	1.683	+2.8		
P11 — 2026-05	J2	0.862	0.821	-4.7		
P8 — 2026-06	J0	2.018	2.018	+0.0	4.9	7.3
P8 — 2026-06	J1	1.089	1.169	+7.3		
P8 — 2026-06	J2	0.871	0.807	-7.4		
P17 — 2026-09	J0	7.262	7.262	+0.0	3.7	5.6
P17 — 2026-09	J1	1.818	1.906	+4.8		
P17 — 2026-09	J2	1.267	1.187	-6.3		

Les plus faibles erreurs sont obtenues sans passage imposé par l’origine

