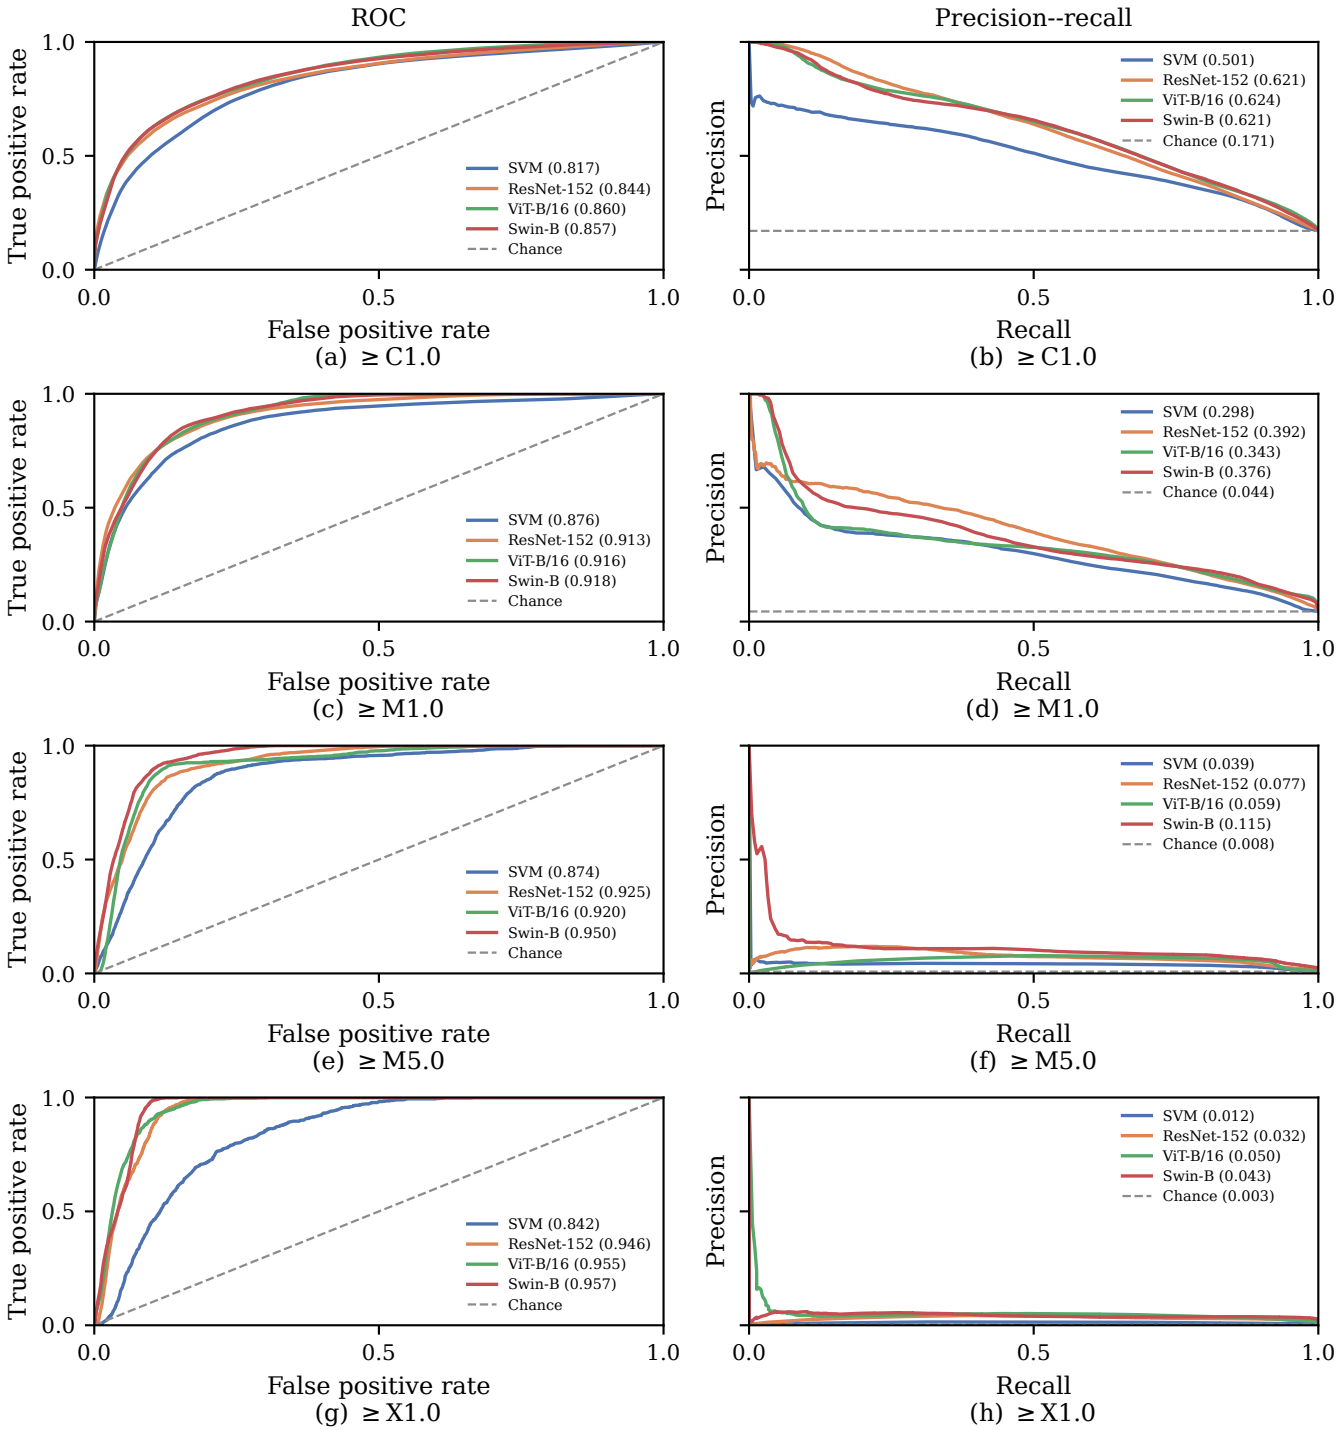
ROC
Precision--recall
True positive rate
False positive rate
Precision
Recall
SVM (0.817)
ResNet-152 (0.844)
ViT-B/16 (0.860)
Swin-B (0.857)
Chance
SVM (0.501)
ResNet-152 (0.621)
ViT-B/16 (0.624)
Swin-B (0.621)
Chance (0.171)
(a) ≥ C1.0
(b) ≥ C1.0
SVM (0.876)
ResNet-152 (0.913)
ViT-B/16 (0.916)
Swin-B (0.918)
Chance
SVM (0.298)
ResNet-152 (0.392)
ViT-B/16 (0.343)
Swin-B (0.376)
Chance (0.044)
(c) ≥ M1.0
(d) ≥ M1.0
SVM (0.874)
ResNet-152 (0.925)
ViT-B/16 (0.920)
Swin-B (0.950)
Chance
SVM (0.039)
ResNet-152 (0.077)
ViT-B/16 (0.059)
Swin-B (0.115)
Chance (0.008)
(e) ≥ M5.0
(f) ≥ M5.0
SVM (0.842)
ResNet-152 (0.946)
ViT-B/16 (0.955)
Swin-B (0.957)
Chance
SVM (0.012)
ResNet-152 (0.032)
ViT-B/16 (0.050)
Swin-B (0.043)
Chance (0.003)
(g) ≥ X1.0
(h) ≥ X1.0