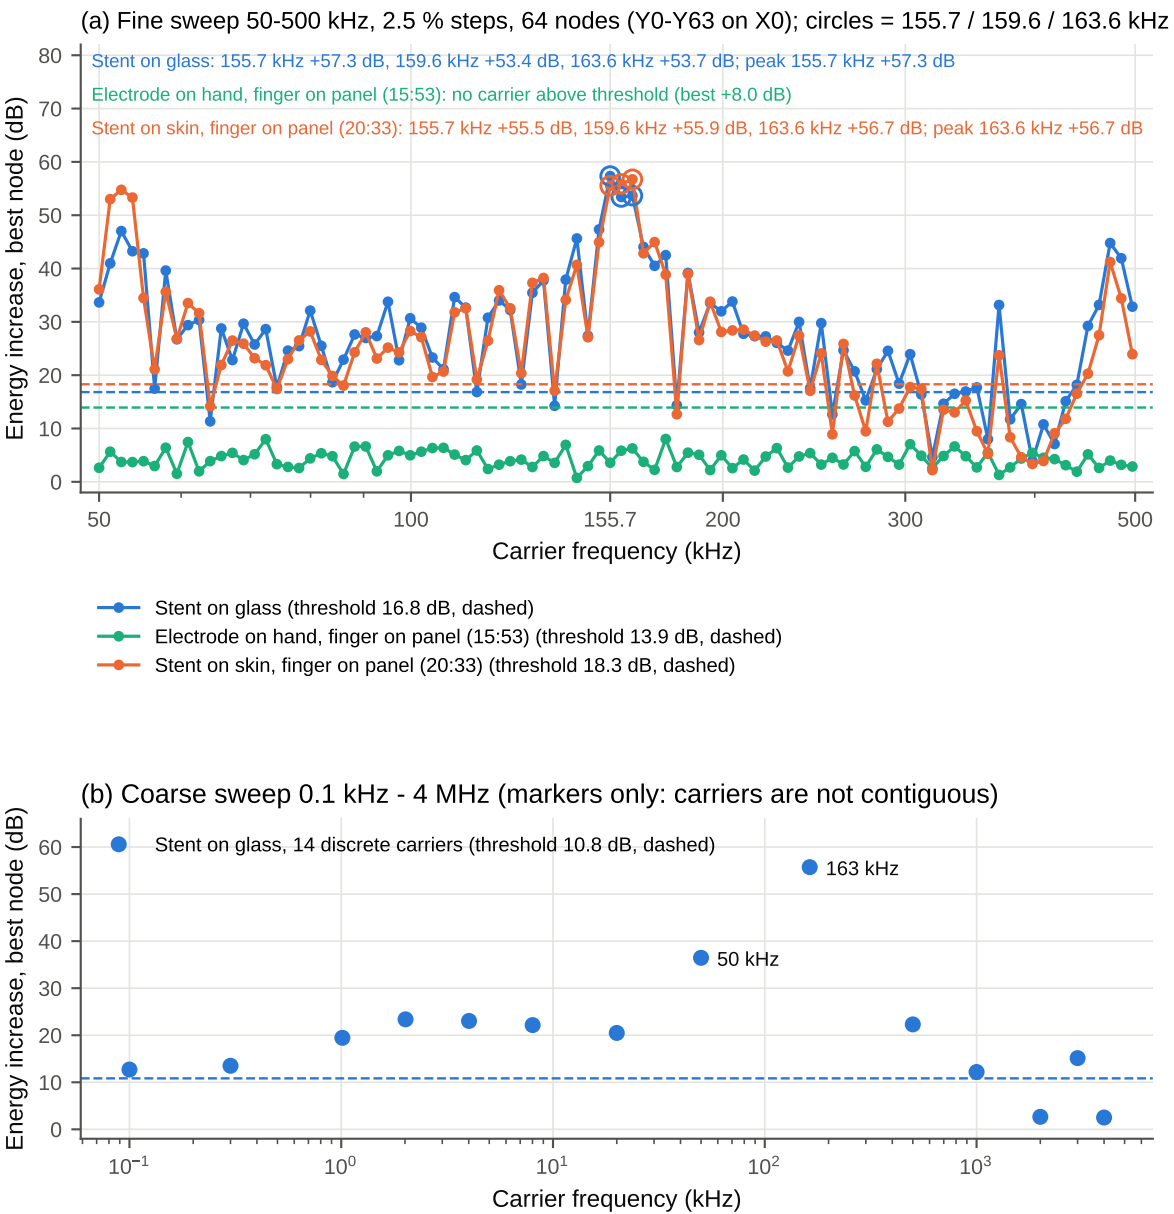
(a) Fine sweep 50-500 kHz, 2.5 % steps, 64 nodes (Y0-Y63 on X0); circles = 155.7 / 159.6 / 163.6 kHz
Stent on glass: 155.7 kHz +57.3 dB, 159.6 kHz +53.4 dB, 163.6 kHz +53.7 dB; peak 155.7 kHz +57.3 dB
Electrode on hand, finger on panel (15:53): no carrier above threshold (best +8.0 dB)
Stent on skin, finger on panel (20:33): 155.7 kHz +55.5 dB, 159.6 kHz +55.9 dB, 163.6 kHz +56.7 dB; peak 163.6 kHz +56.7 dB
Energy increase, best node (dB)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
50
100
155.7
200
300
500
Carrier frequency (kHz)
Stent on glass (threshold 16.8 dB, dashed)
Electrode on hand, finger on panel (15:53) (threshold 13.9 dB, dashed)
Stent on skin, finger on panel (20:33) (threshold 18.3 dB, dashed)
(b) Coarse sweep 0.1 kHz - 4 MHz (markers only: carriers are not contiguous)
Energy increase, best node (dB)
0
10
20
30
40
50
60
Stent on glass, 14 discrete carriers (threshold 10.8 dB, dashed)
163 kHz
50 kHz
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
Carrier frequency (kHz)