STEP 1 新增客戶

1. 登錄您的帳戶。

2. 從目錄中選擇「我的病人」頁面，點擊「添加」來添加新客戶，輸入客戶信息，然後點擊「確認」按鈕。

3. 如果客戶已經添加過，您可以通過輸入姓名、電話號碼或外部編號來搜索客戶記錄。

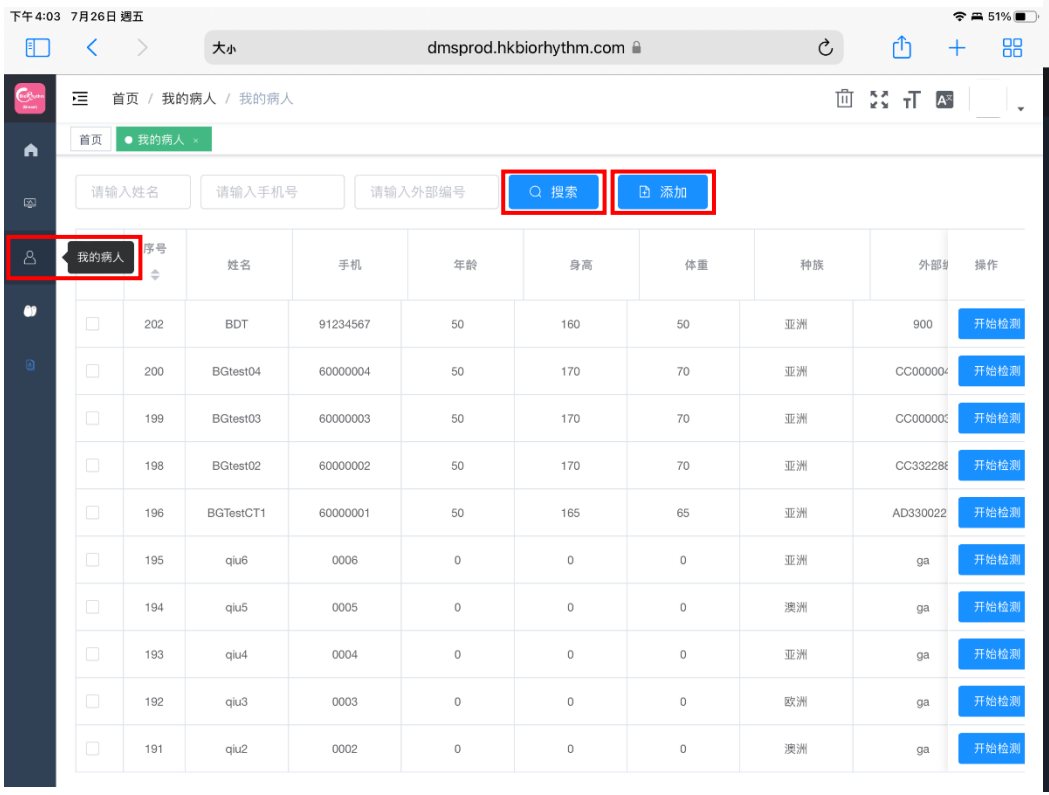

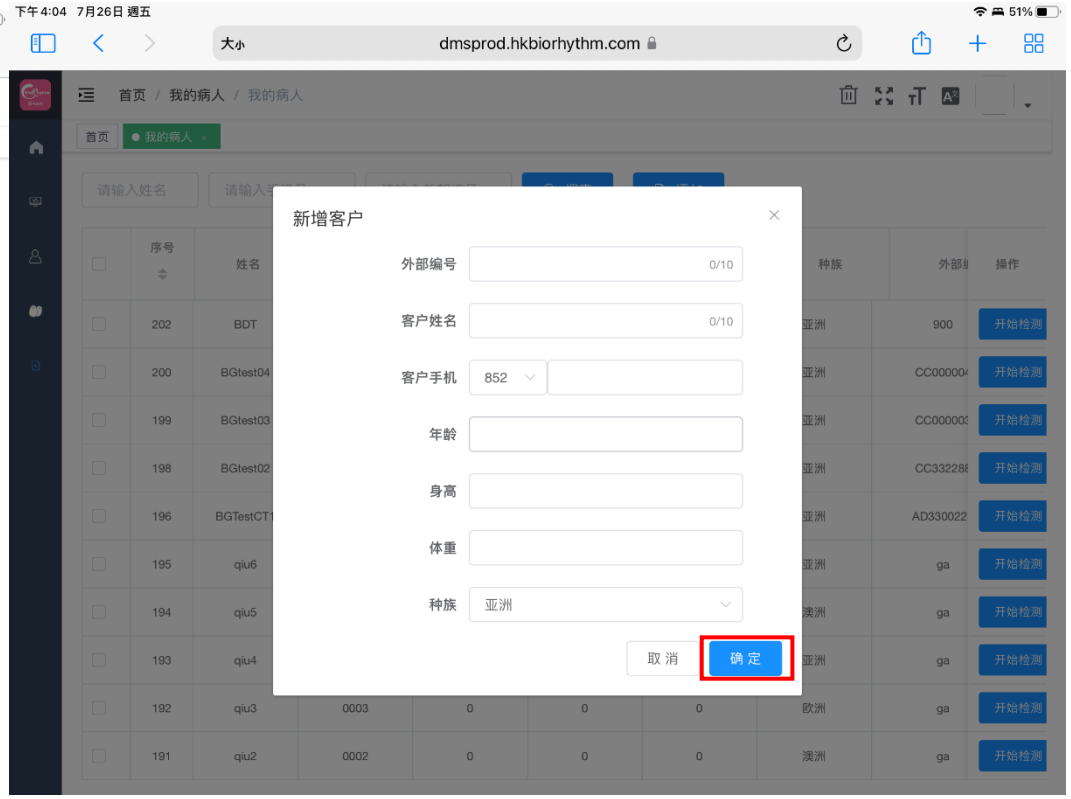

STEP 2 配對設備

1. 在頁面上選擇要測試的客戶資料，點擊右側操作欄的「開始監測」，會彈出選擇「乳腺快速檢測」或「乳腺 Holter 檢測」的對話框。選擇後頁面將自動切換到微信小程序。

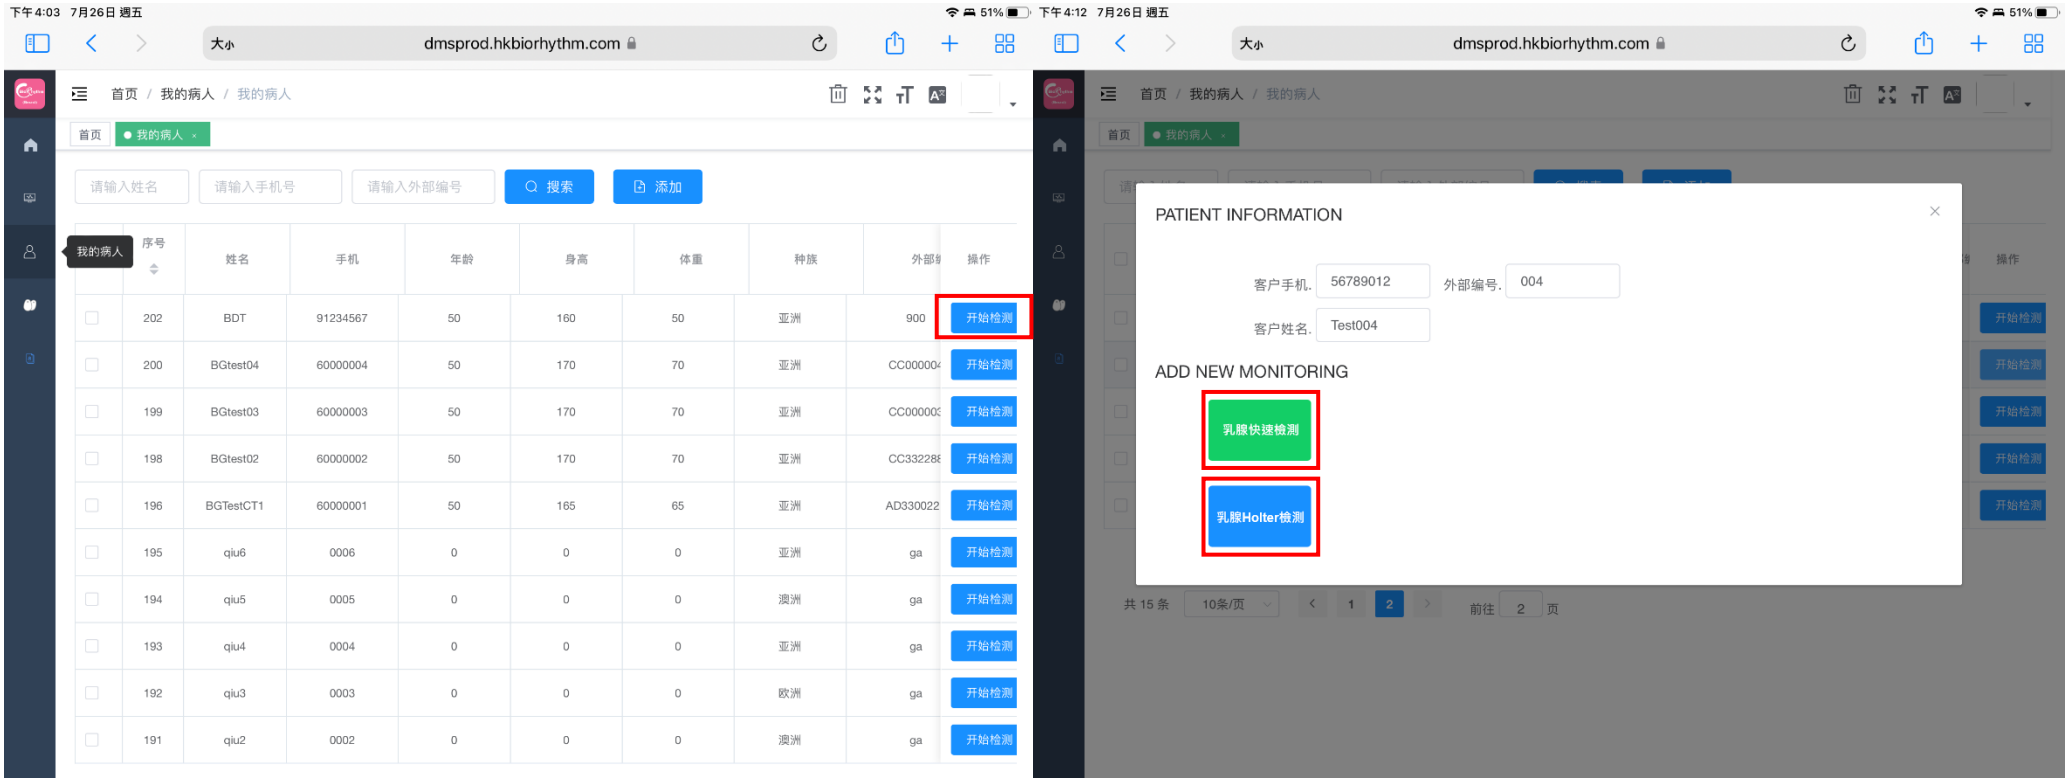

2. 開啟設備，按住 5 秒直到藍燈閃爍，表示設備已開啟並準備連接。連接時請將設備放置在平板電腦旁，並確保在 1 米範圍內沒有其他已連接的設備。在此頁面中，請檢查確保最後的 4 位數字與已連接的設備是相同的。（**請勿在設備已開機時長按按鈕，這樣可能導致設備關機。如果在設備開機狀態下長按按鈕，紅燈會閃爍，表示設備已關閉。您需要重複開機步驟來啟動設備。**）

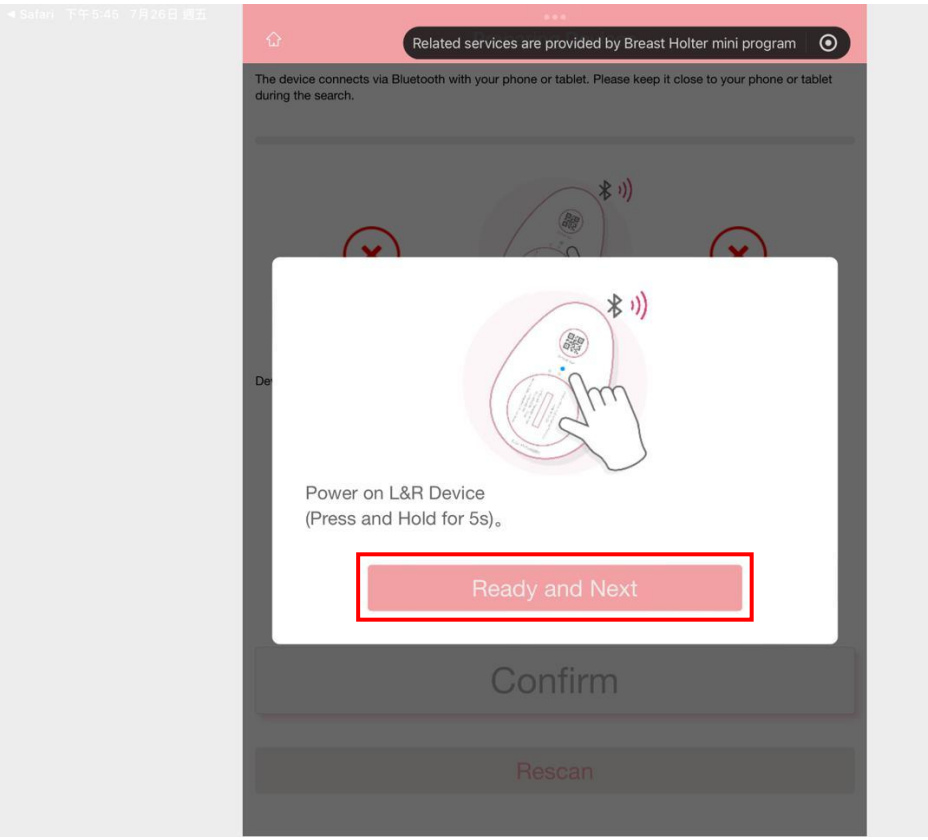

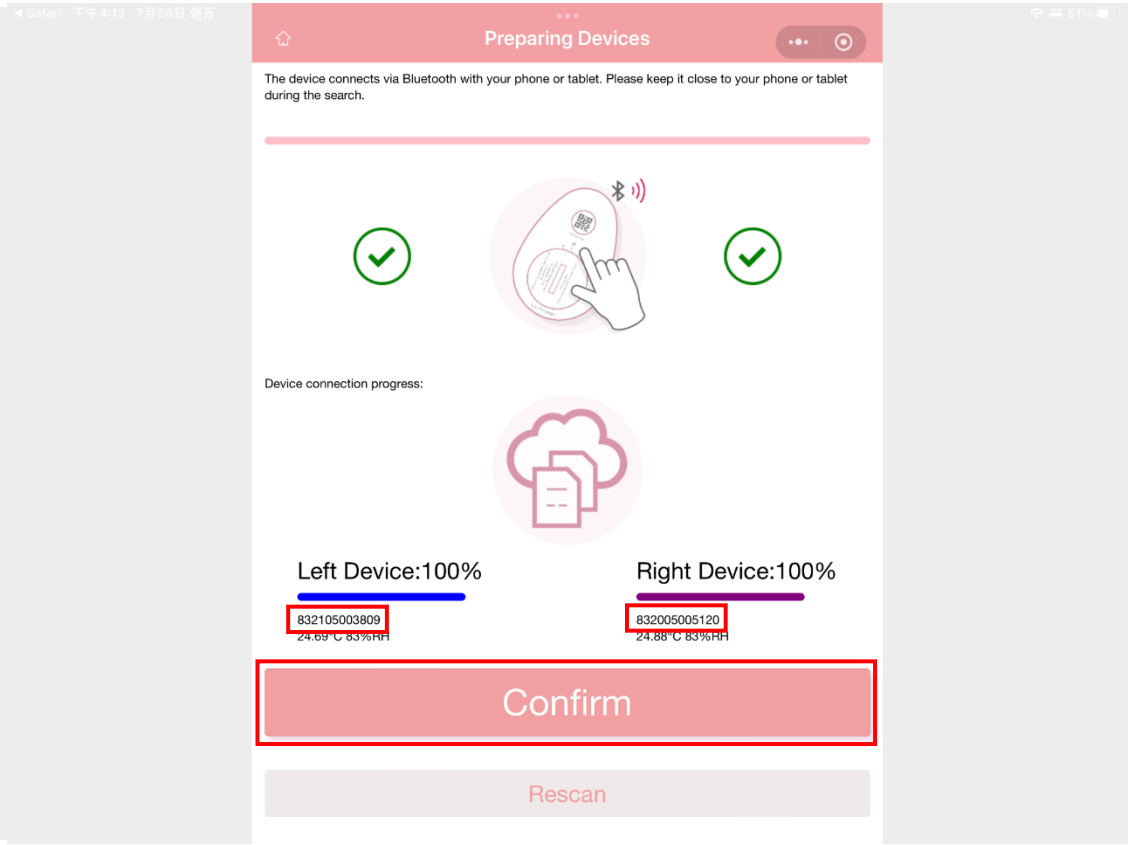

3. 設備連接後，頁面將顯示客戶信息和監測類型。請仔細核對頁面上的所有信息是否準確，然後點擊「開始監測」。

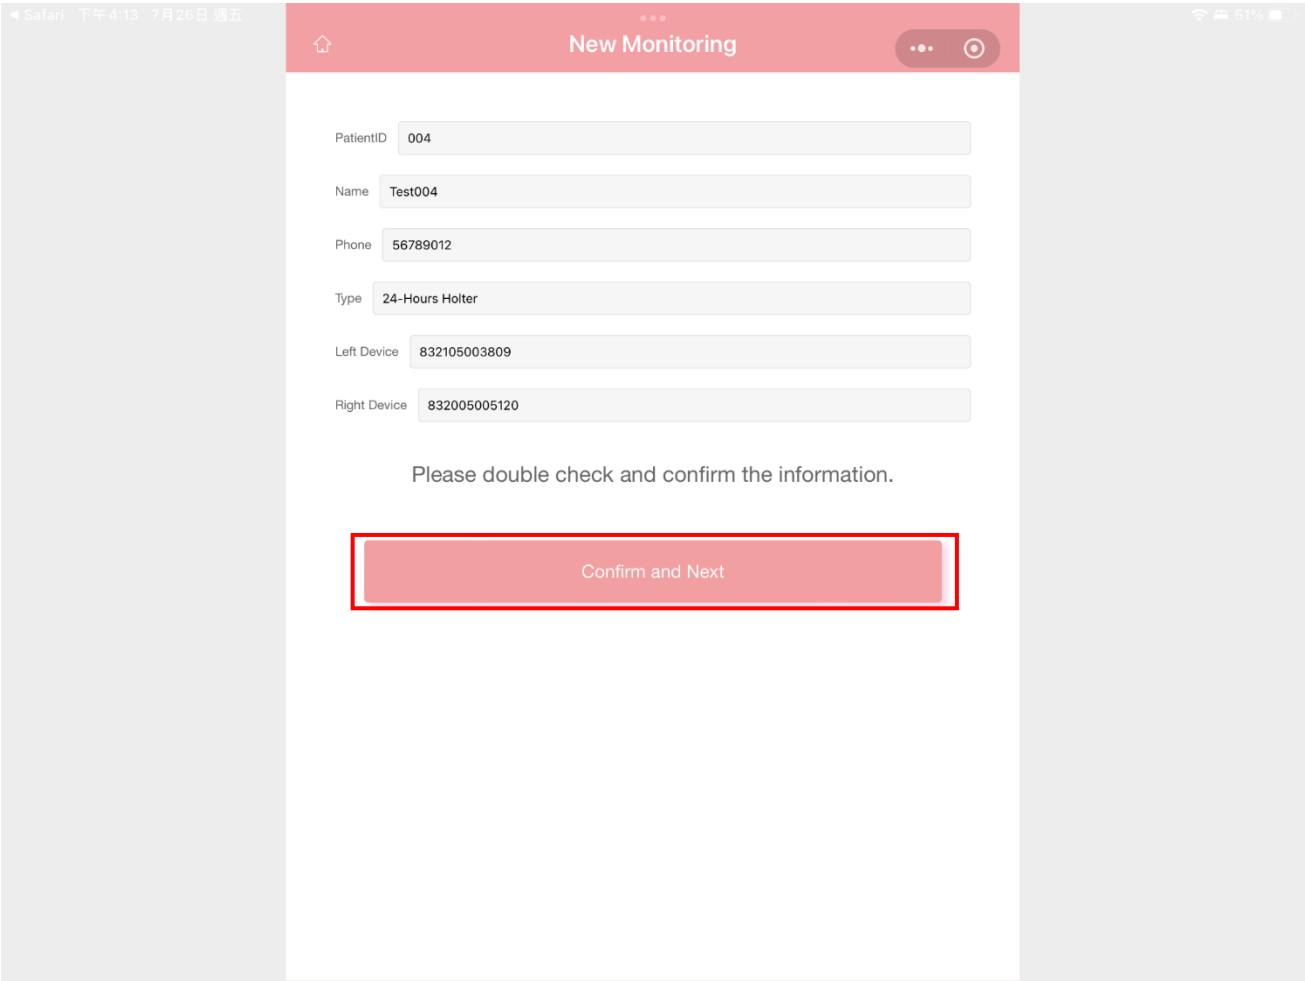

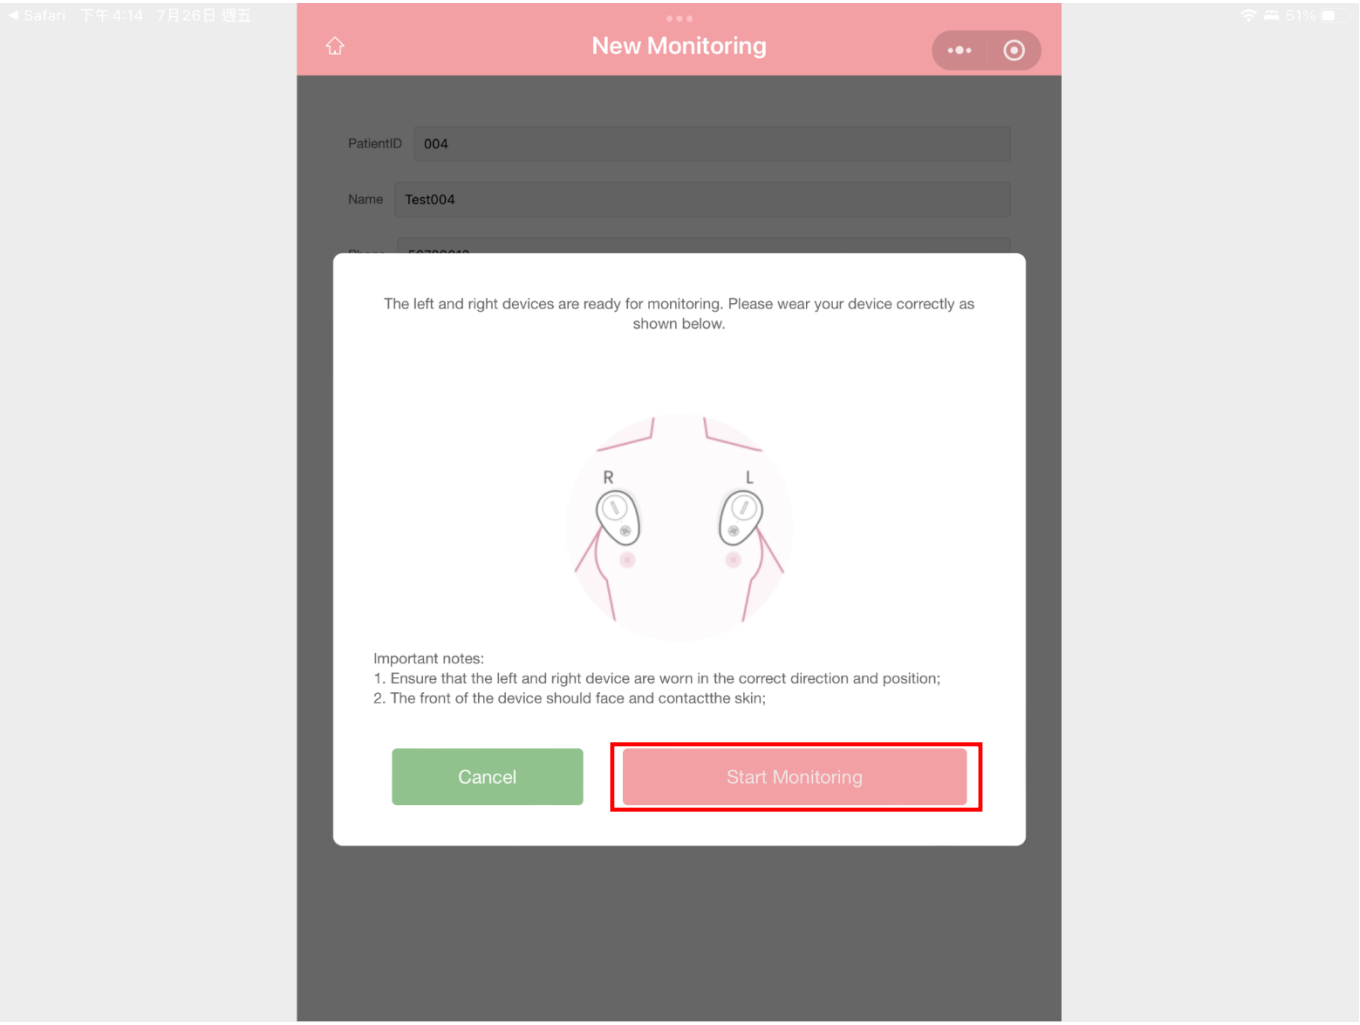

注意事項：

對於「乳腺快速檢測」：

在 45 分鐘倒計時開始後，請確保客戶在 10 分鐘內佩戴設備。如果延遲，可能會導致報告無效，需要重新開始。

對於「乳腺 Holter 檢測」：

24 小時倒計時開始，至少需要 8 小時的有效數據。監測時間數據不足可能會導致報告無效，需要重新開始。

STEP 3 穿戴設備

1. 設備開啟並成功配對後，請嚴格區分左右設備，使用我們提供的蝴蝶形膠帶或醫用膠帶固定設備。
2. 將蝴蝶形膠帶或醫用膠帶的黏性面按照圖示貼在胸部位置。
   （確保設備的金屬探頭緊貼皮膚表面。）

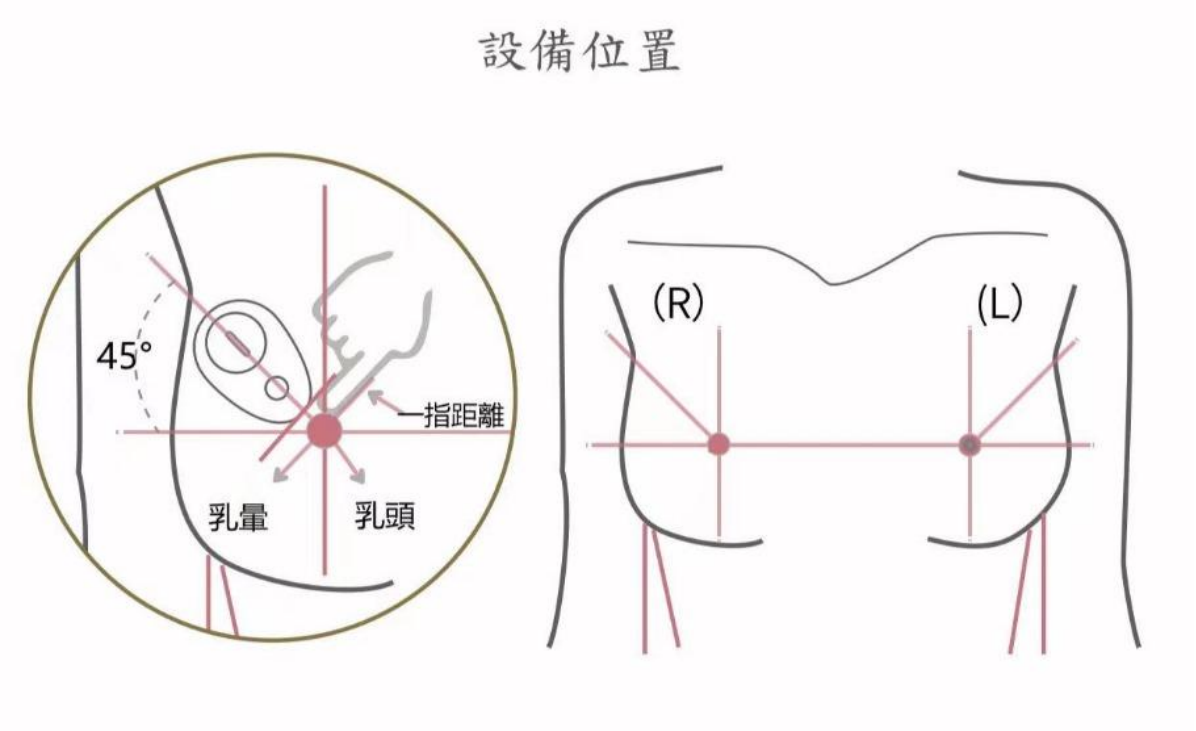

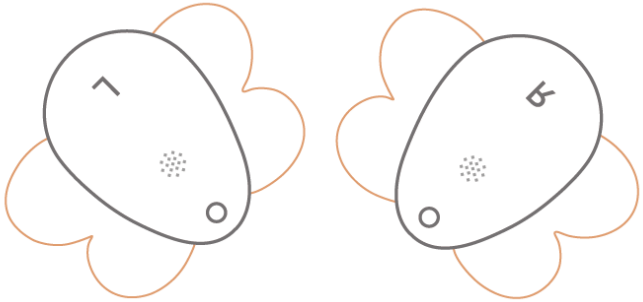

STEP 4 監測測試

1. 系統會切換到監測頁面，顯示檢測正在進行中。請按照穿戴設備說明操作。此時可以返回系統頁面。

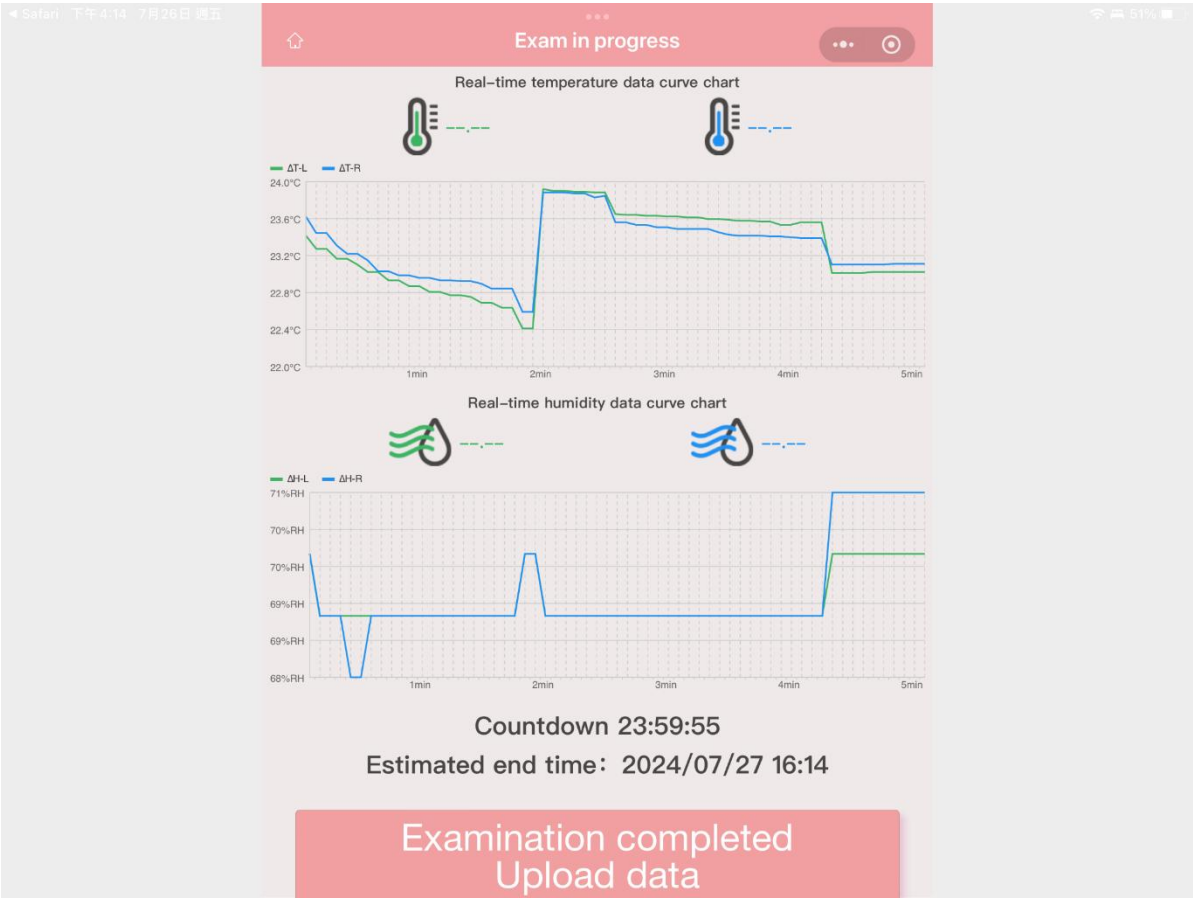

2. 從系統頁面目錄選擇「監控任務」，可以查看客戶檢測的進度百分比。

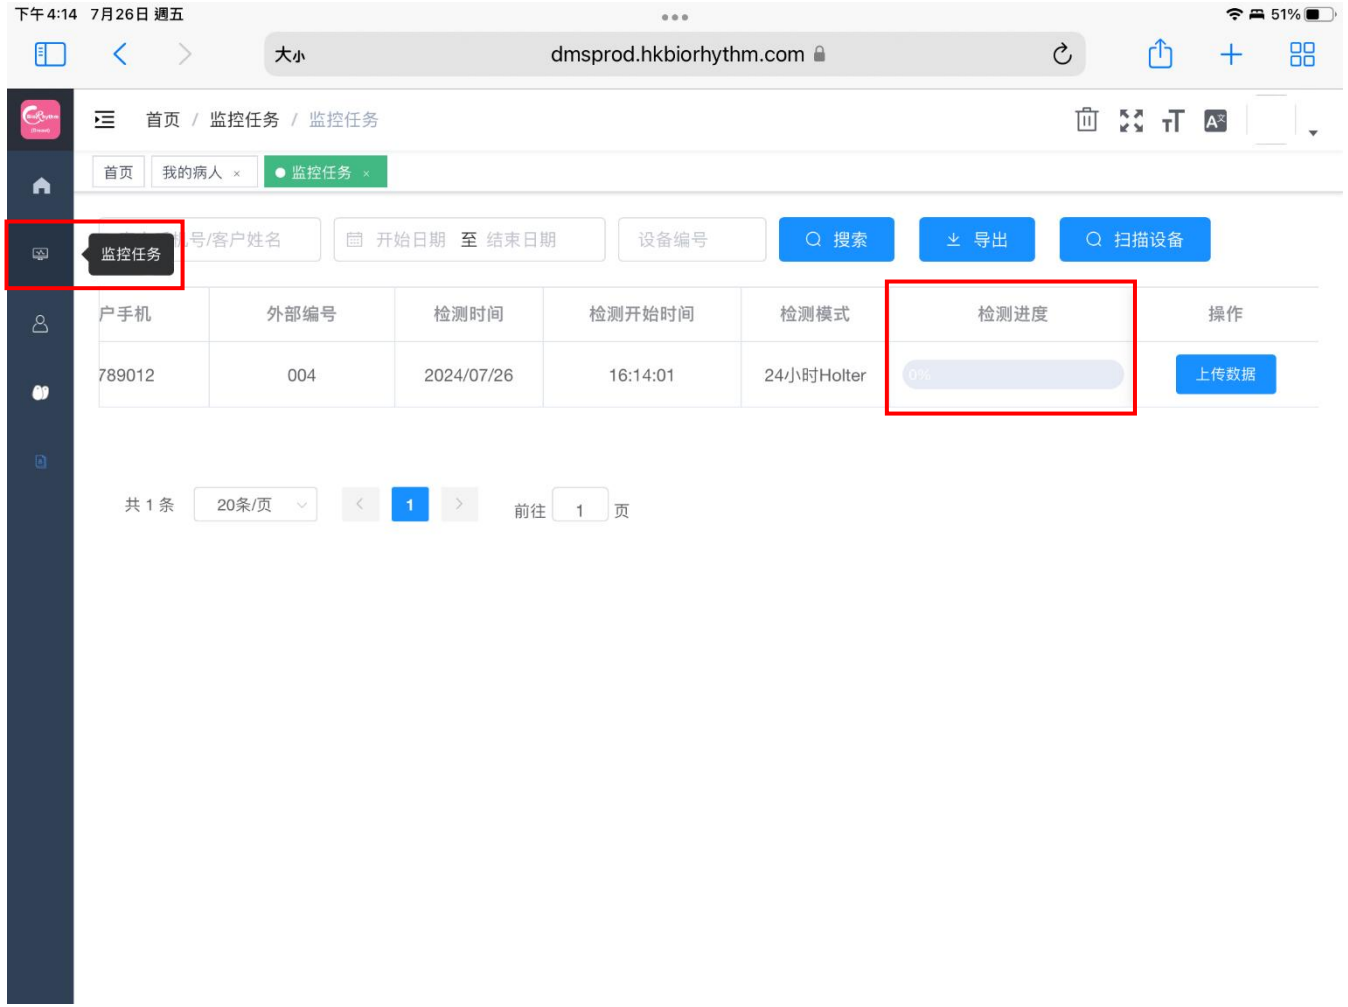

STEP 5 上傳數據

1. 測試完成後，在「監控任務」頁面中，選擇相應的客戶並點擊「上傳數據」。這將帶您進入監測頁面。

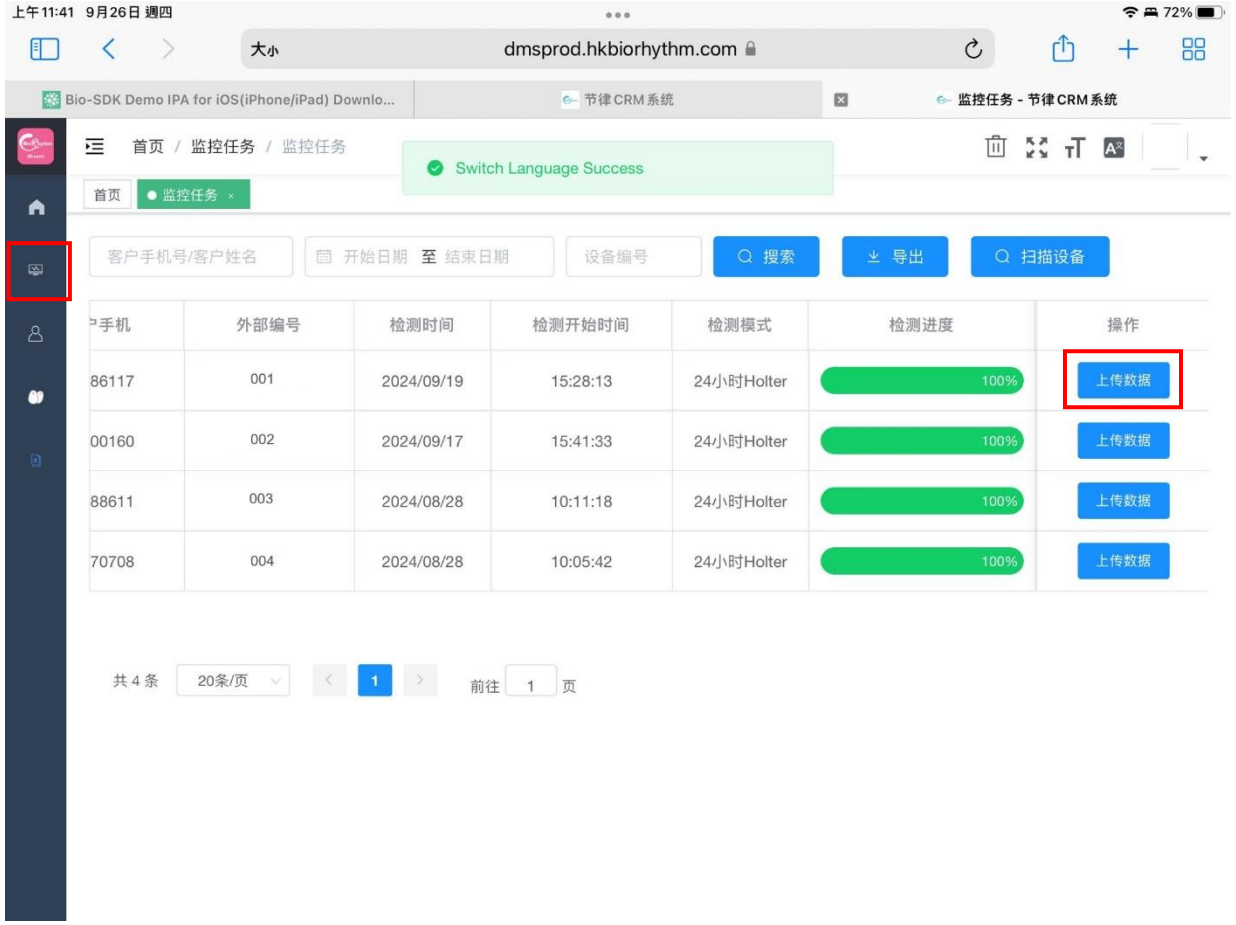

2. 點擊「檢查完成上傳數據」，確認上傳，系統會自動連接設備上傳數據，設備將自動關機。

（如果設備電量低，會提示更換電池。）

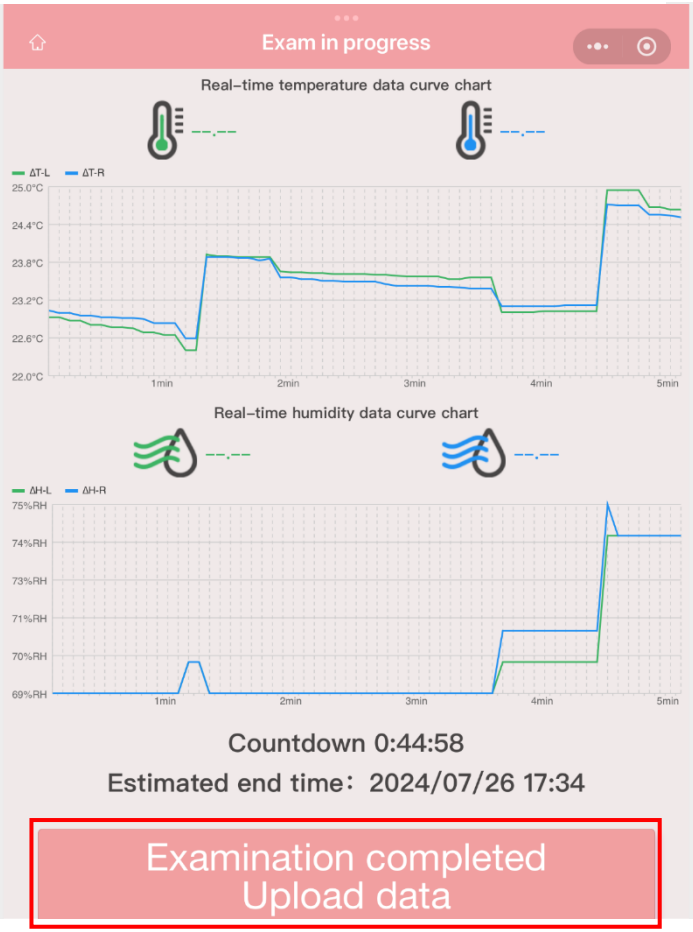

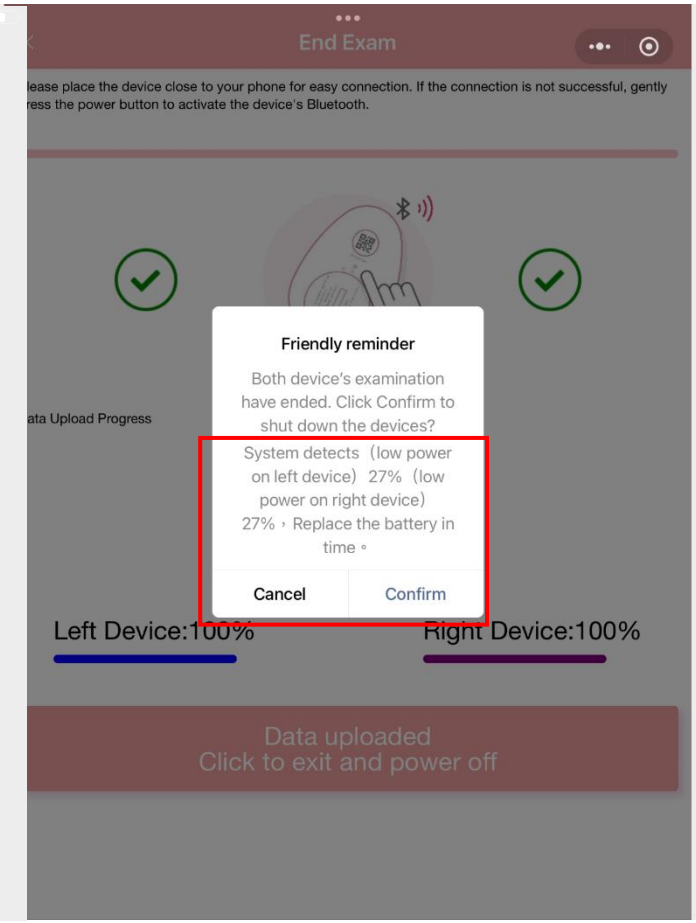

3. 上傳完成後，您可以返回系統頁面。

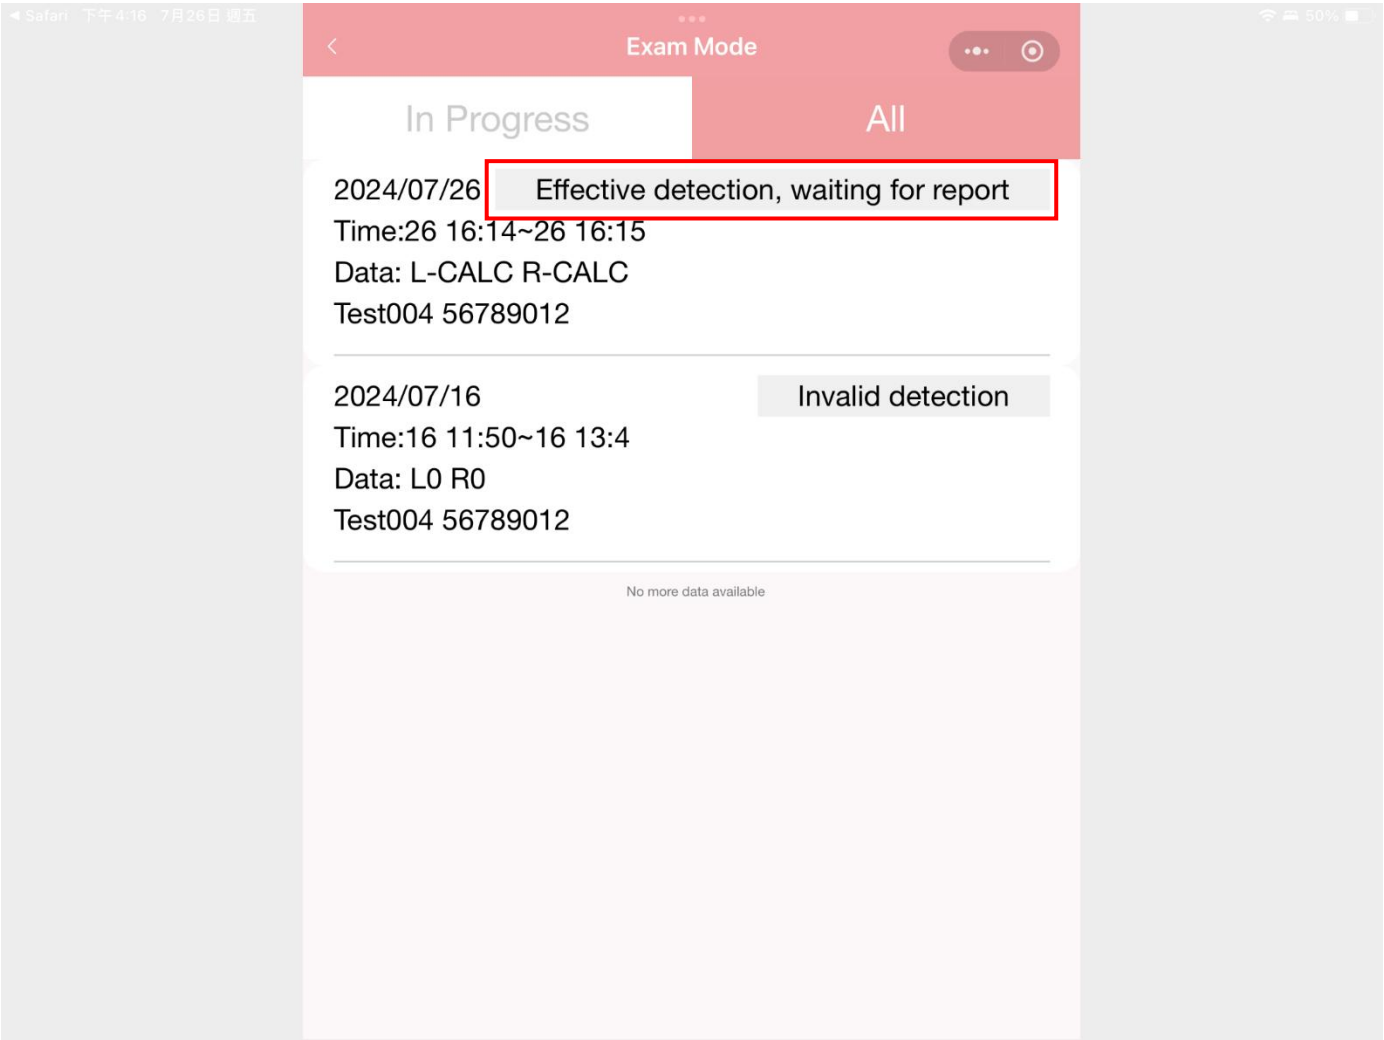

STEP 6 閱讀報告

1. 從系統頁面目錄中選擇「報告管理」，點擊「報告列表」來查看和下載客戶的報告。

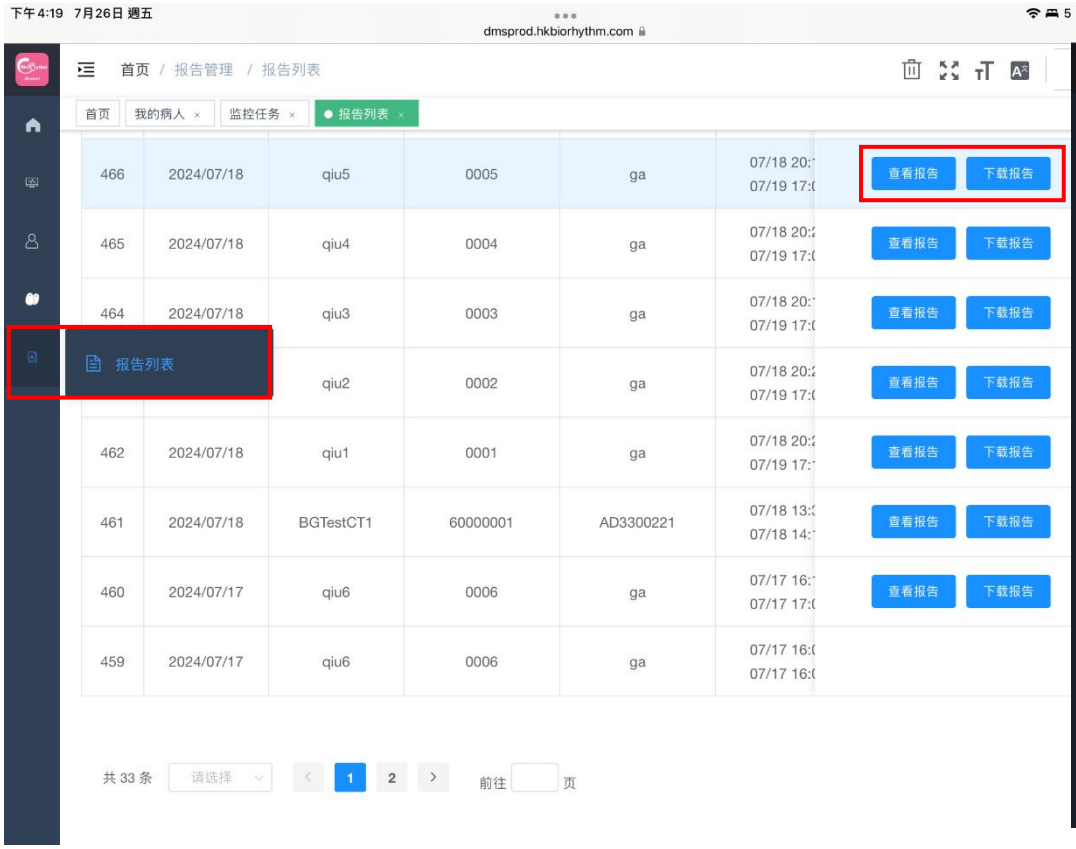

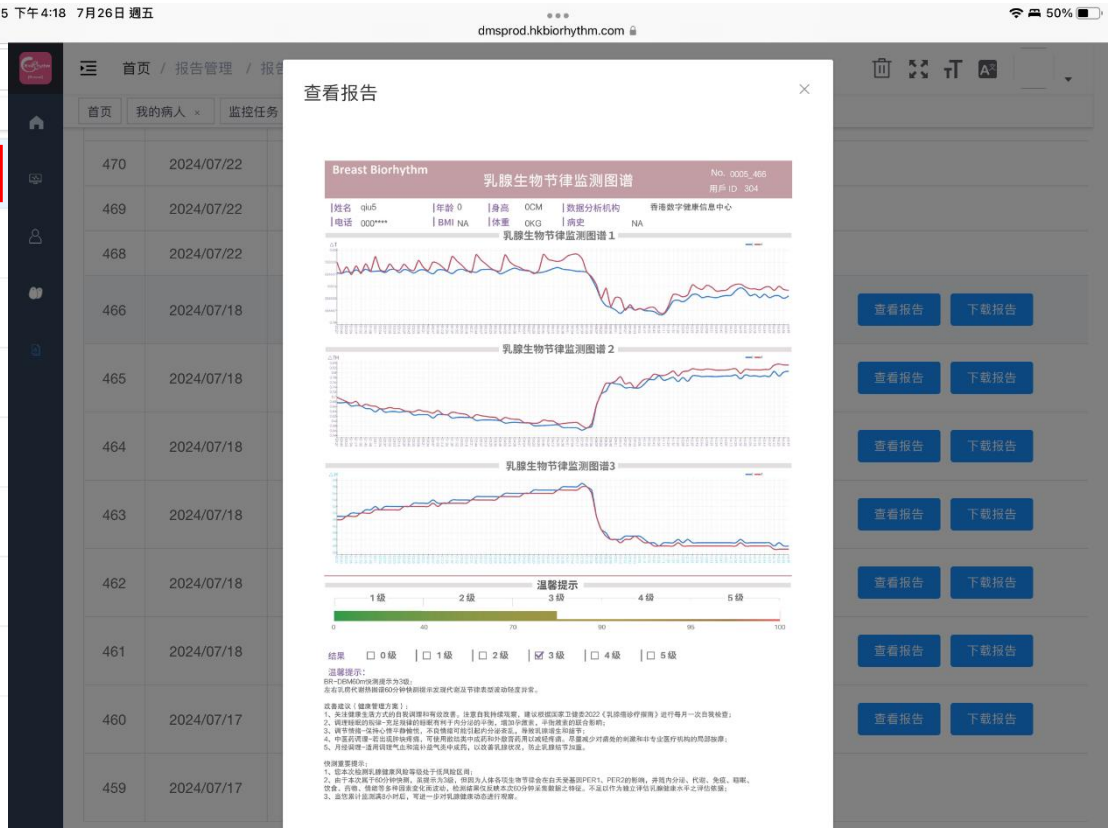

設備列表：

*在目錄的「設備列表」中，您可以查看設備的「佔用」和「可用」狀態數量。

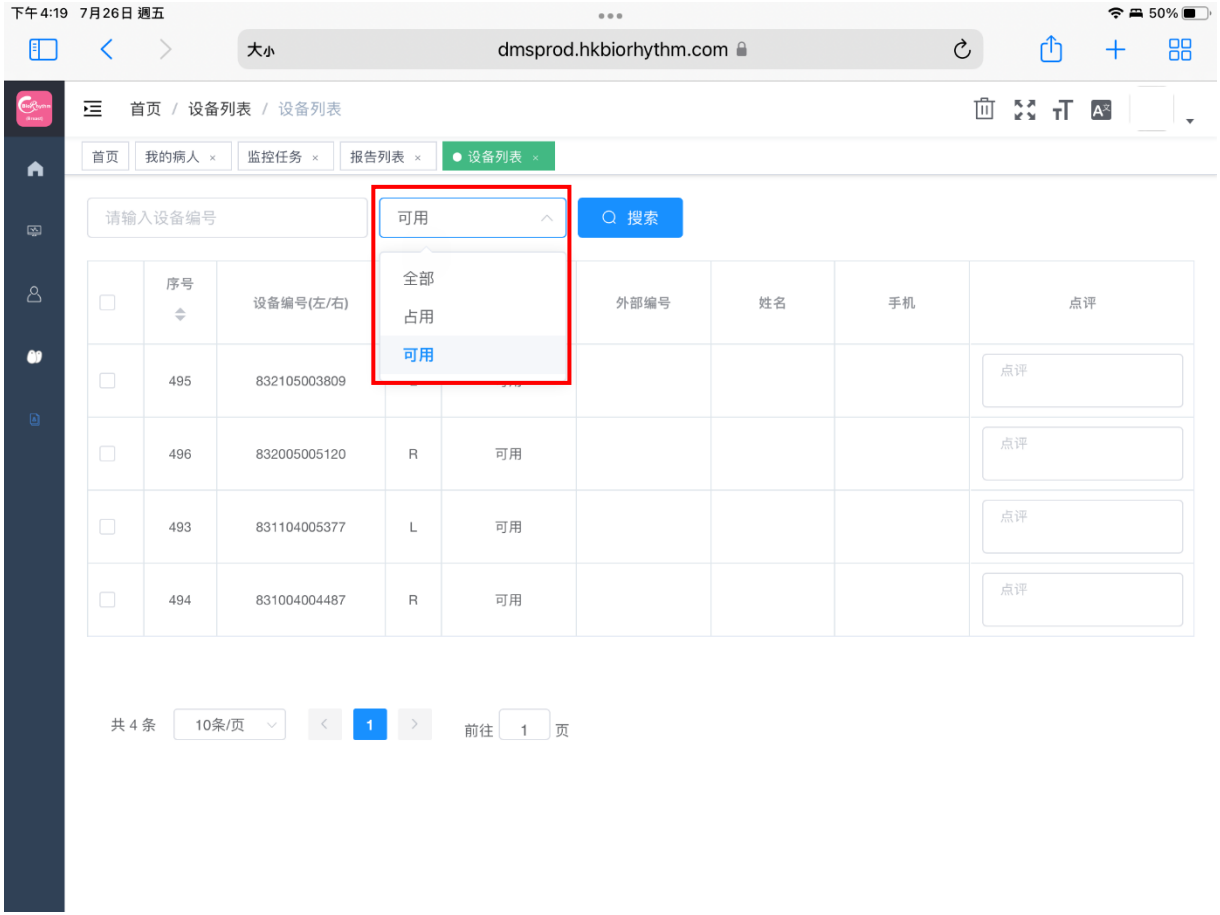

疑難排解

1. 配對

如果您在連接設備時遇到問題，可以透過以下三種方法解決：

1.1 確保開機：

請確認設備的電源已打開。輕輕按壓會出現藍色燈在閃爍，這表示電源已成功開啟。如果輕輕按下按鈕後紅燈閃爍，這表示電池電量低並需要更換。**（如果沒有任何指示燈閃爍，這表示電源未打開。請按住 5 秒以重新啟動，直到藍燈閃爍以進行連接。）**

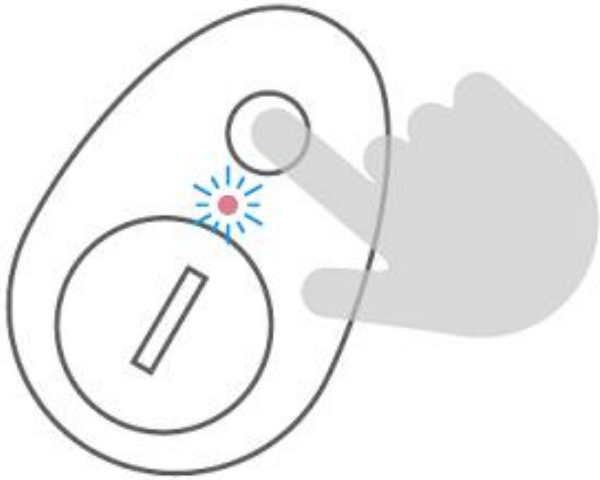

1.2 重置藍牙（如果仍未解決問題，則執行第 3 步）：

從屏幕頂部向下拉動，按下藍牙按鈕以關閉並重新啟動藍牙連接。

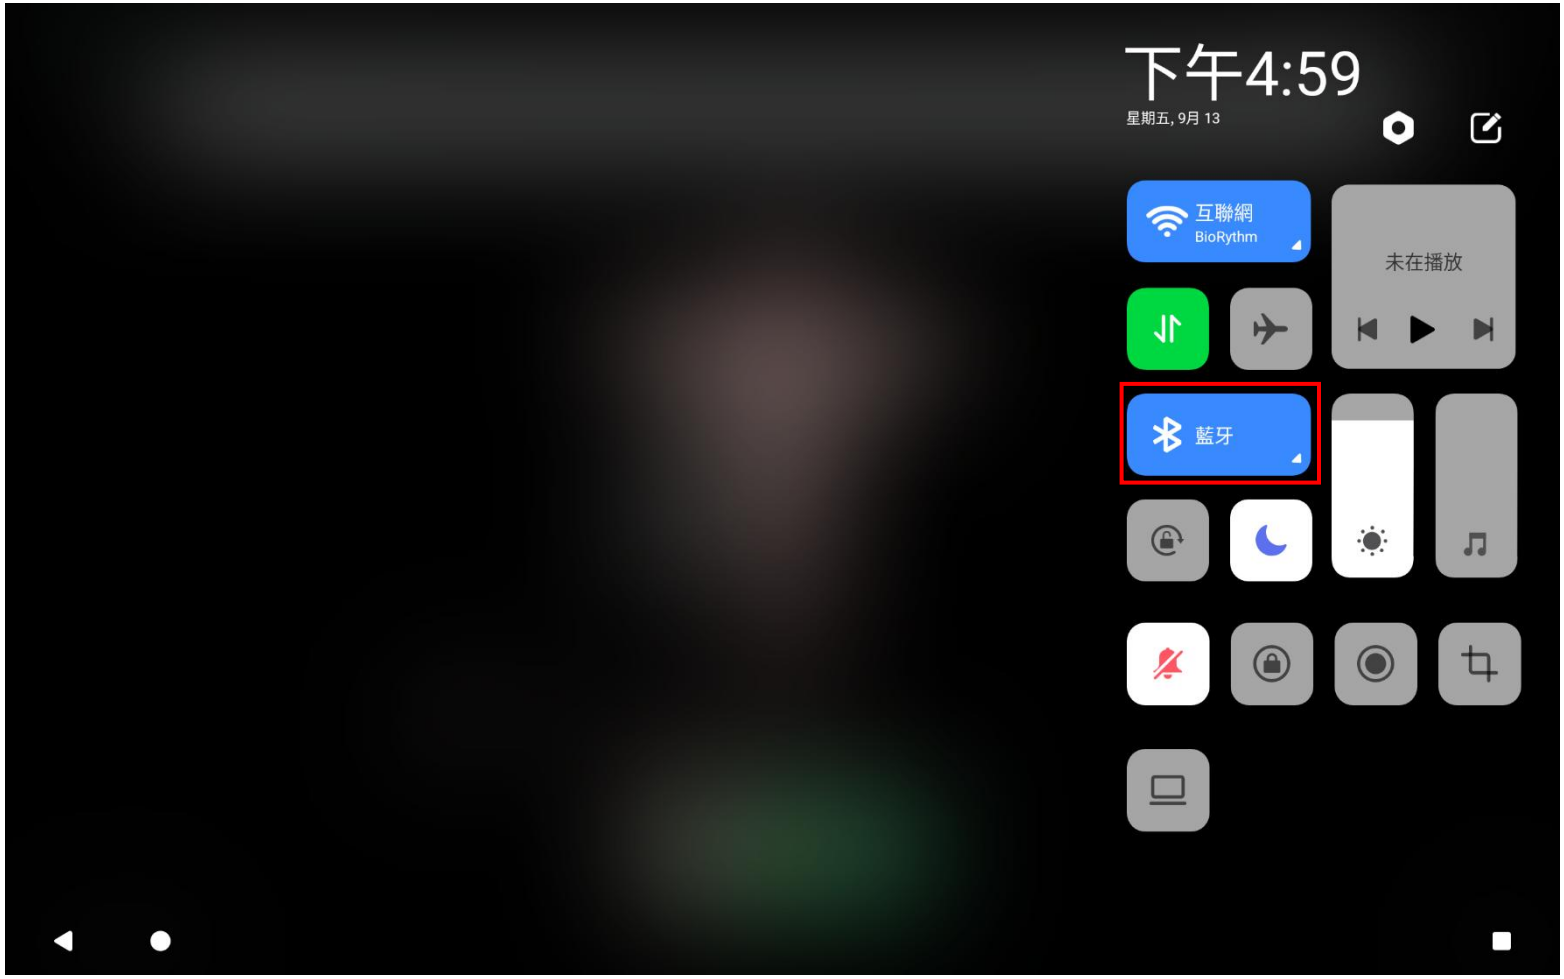

1.3 刪除 BR 小程式：

在微信中刪除小程式。

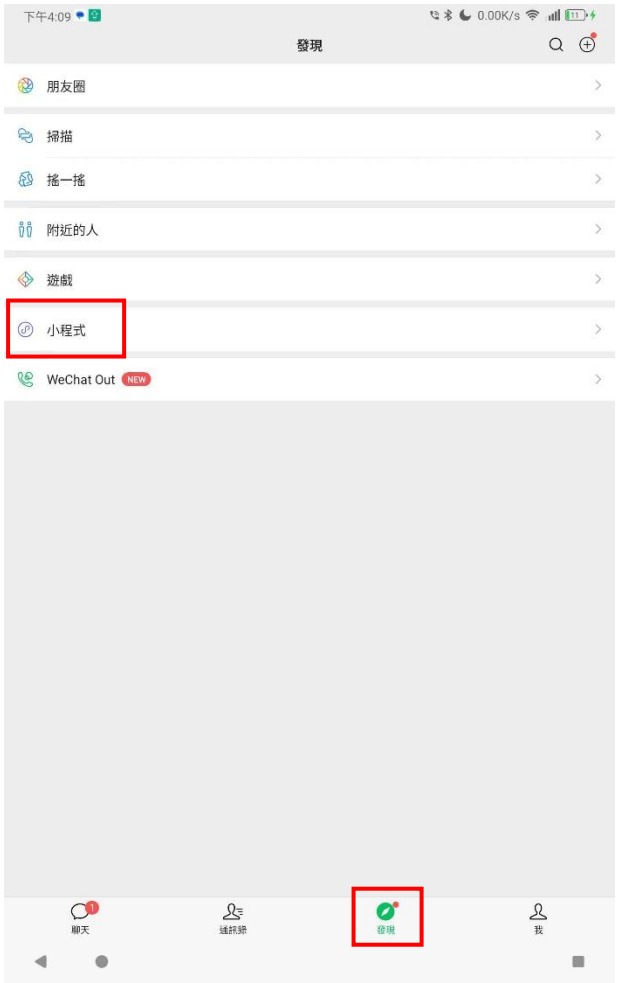

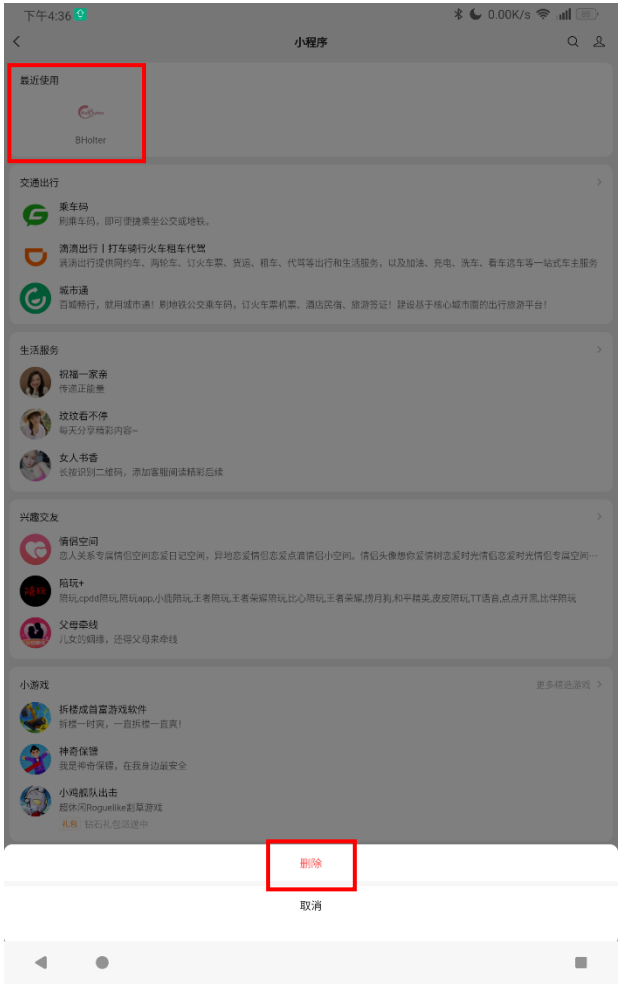

刪除小程式的步驟：

1. 打開微信，選擇「發現」頁面，點擊「小程式」，長按頂部最近使用欄位中的「BHolter」圖標，然後點擊底部的「刪除」。小程式現已成功刪除。

2. 返回系統頁面，從目錄中選擇「我的病人」，再次點擊「開始檢測」，然後按照檢測設備連接步驟進行操作。

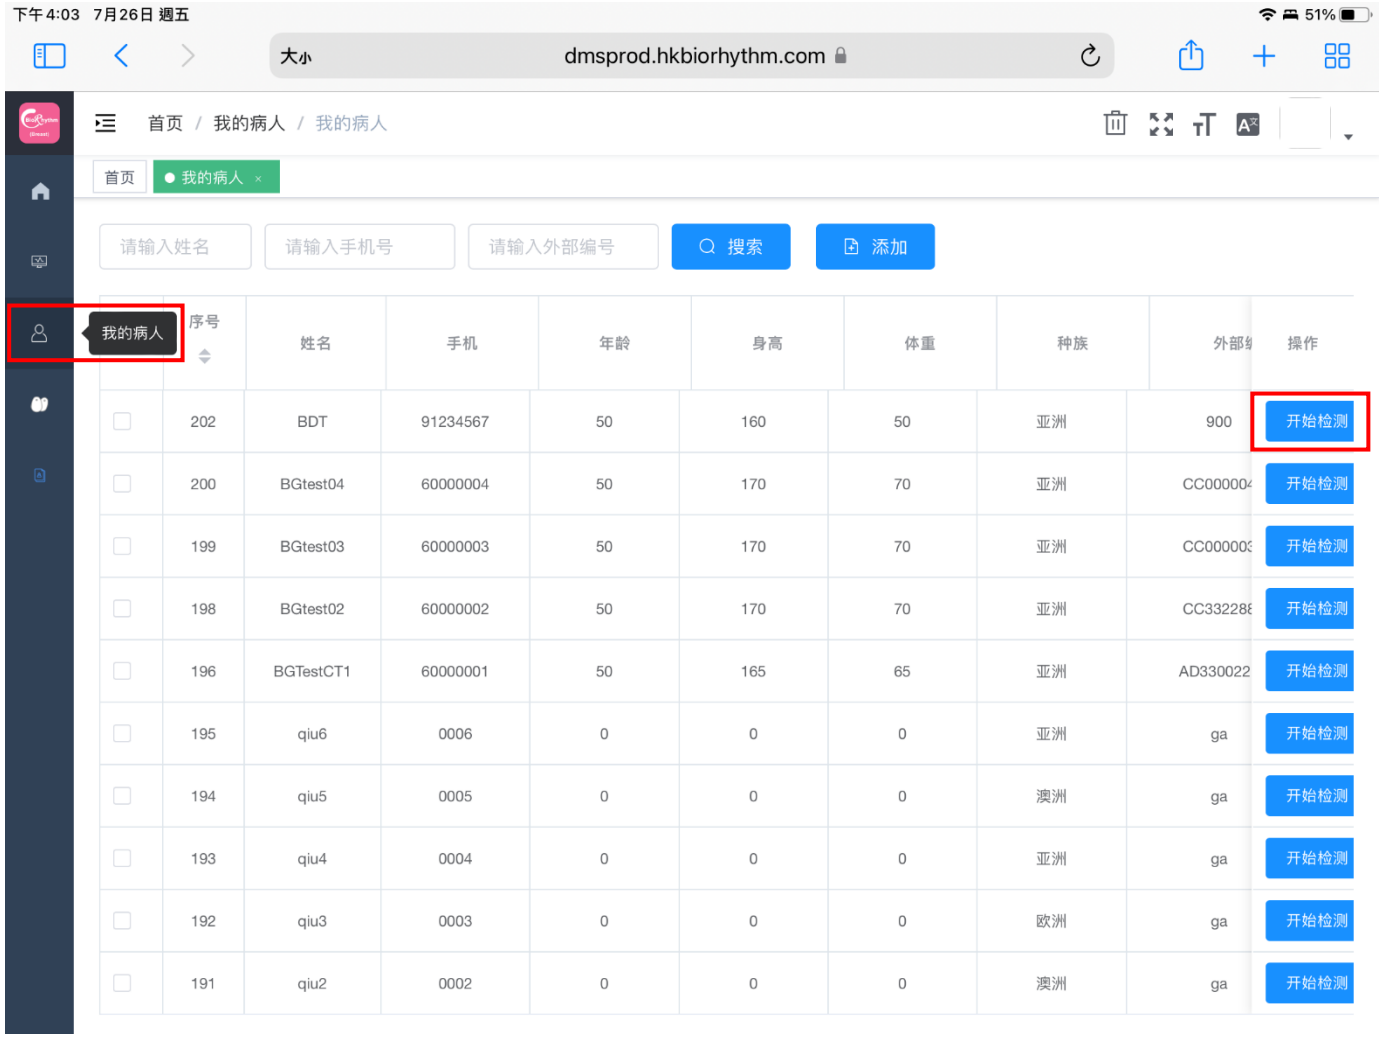

3. 當系統自動跳到微信小程式時，按下「同意並繼續」，然後按下「微信授權」,「準備並下一步」以繼續進行。

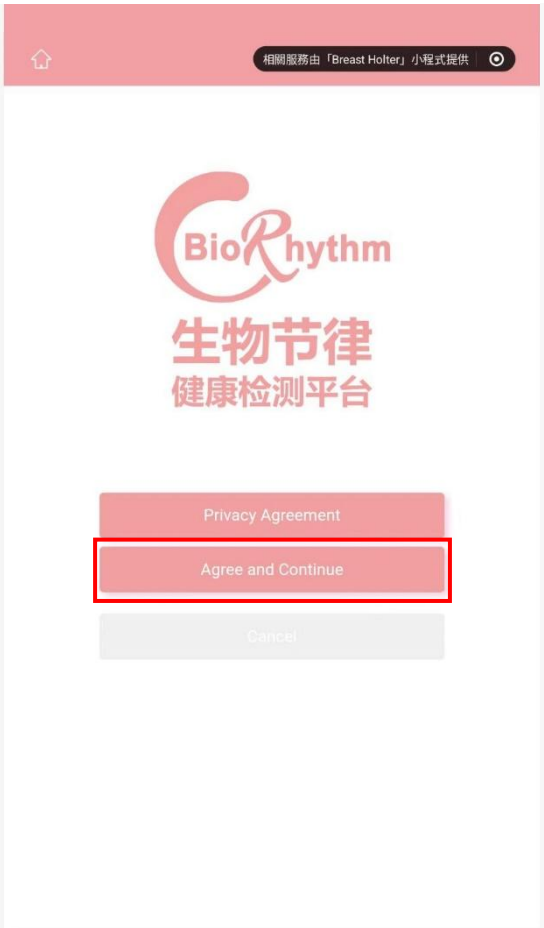

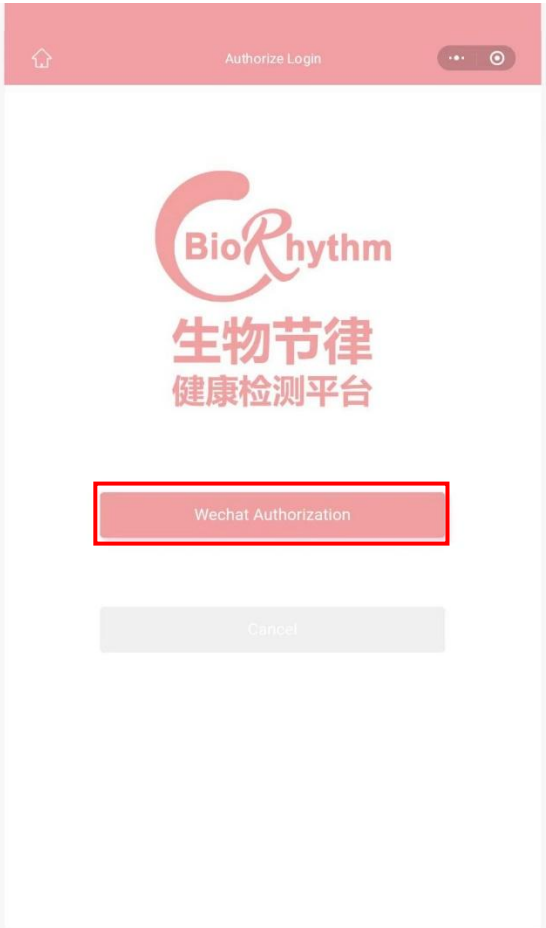

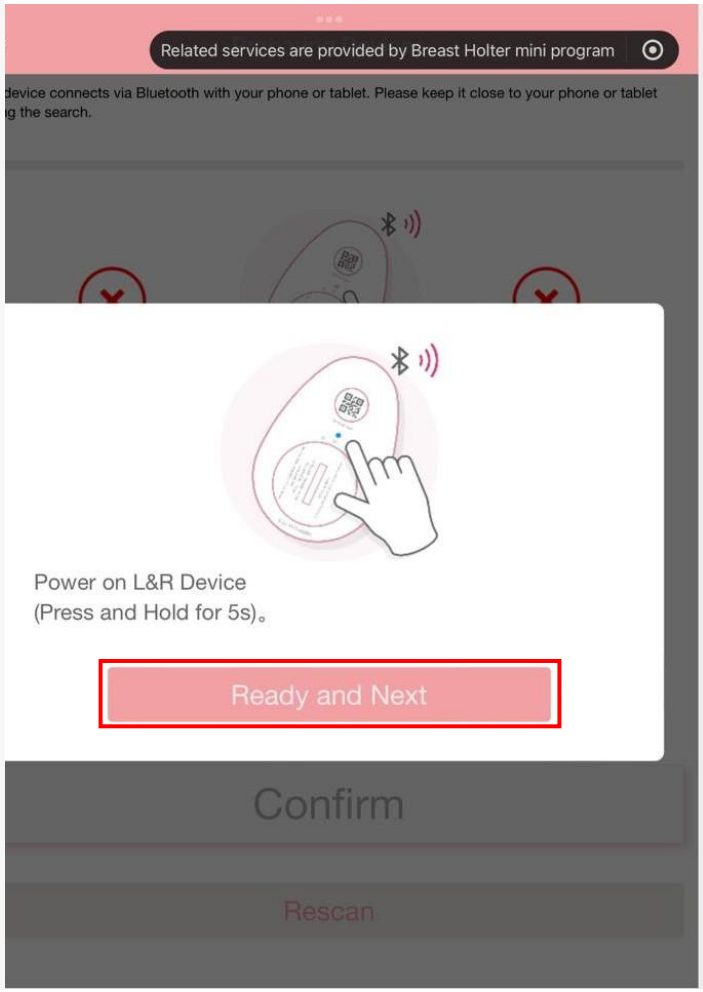

4. 當提示「使用你的藍牙」授權時，點擊「允許」。

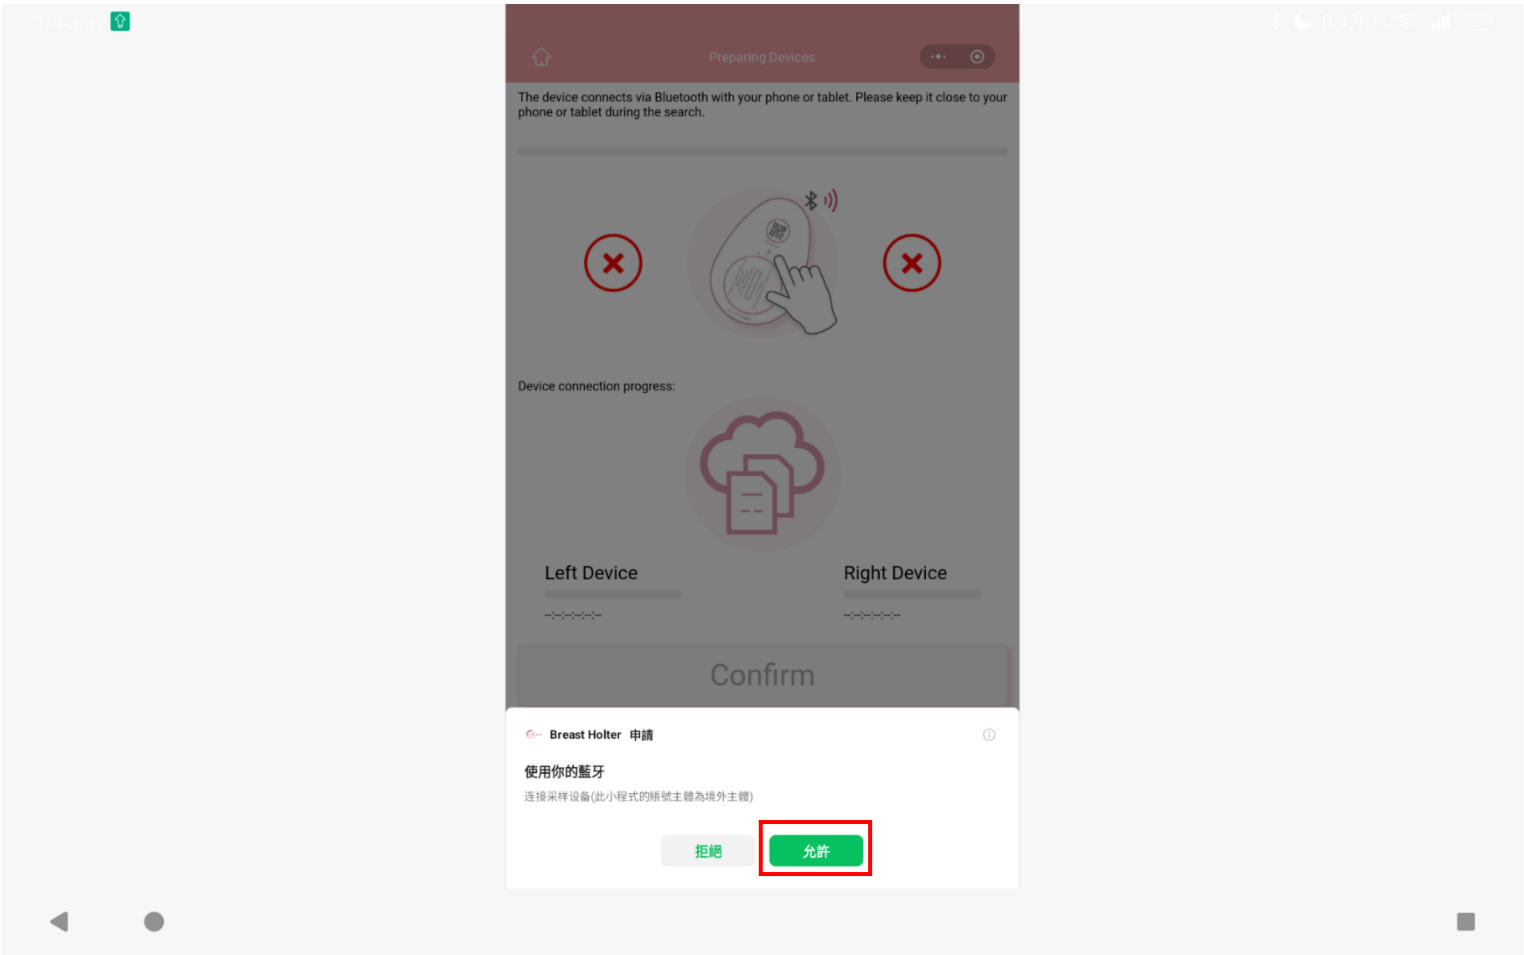

5. 系統現在將自動連接到您的設備。您現在可以進行正常的檢測步驟。

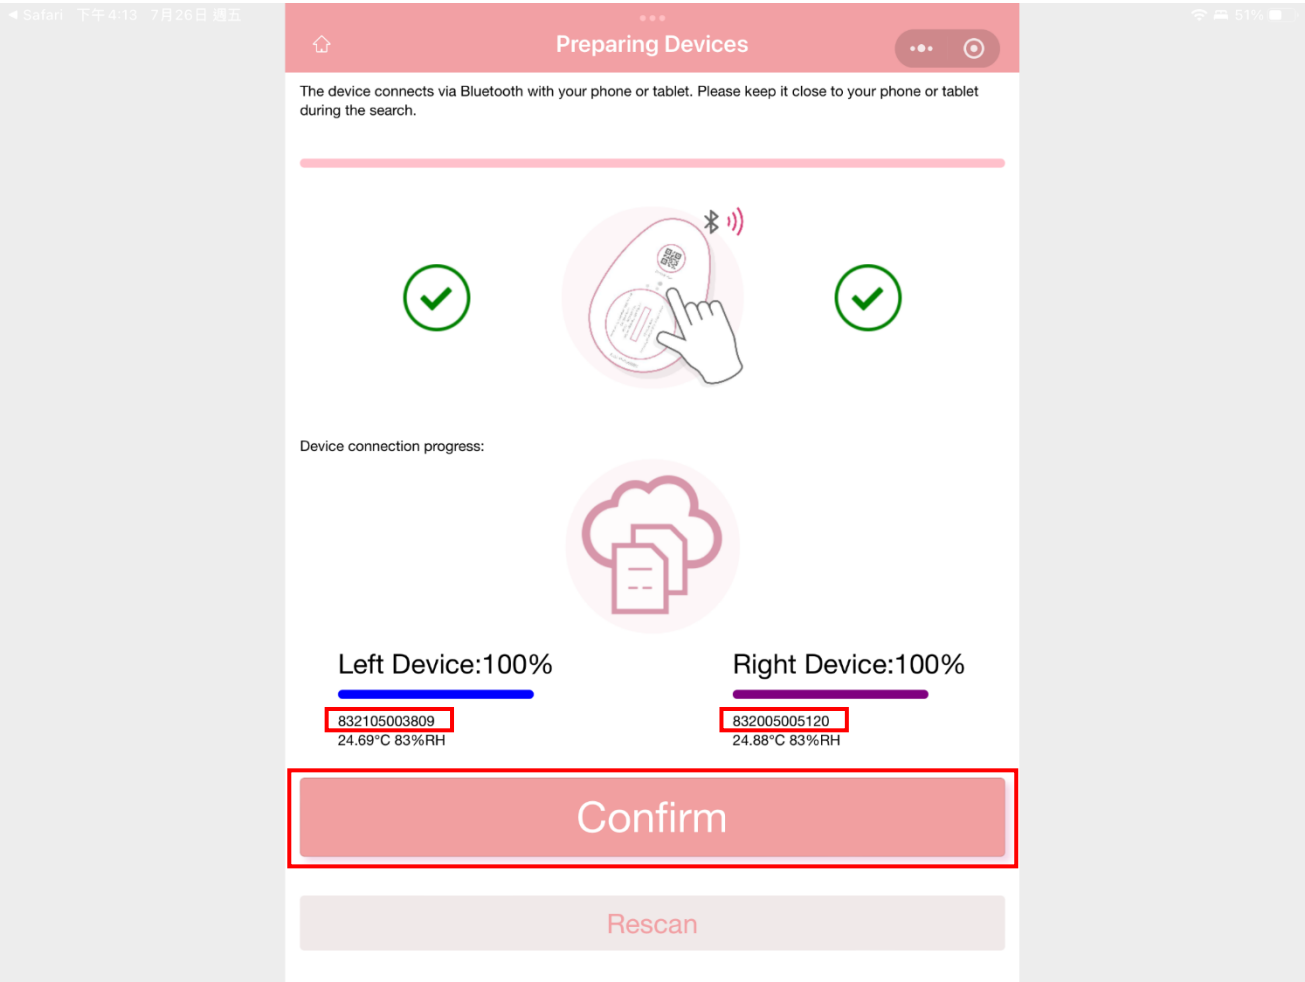

2.上傳數據：

如果您在資料上傳過程中遇到問題，可以透過以下三種方法解決：

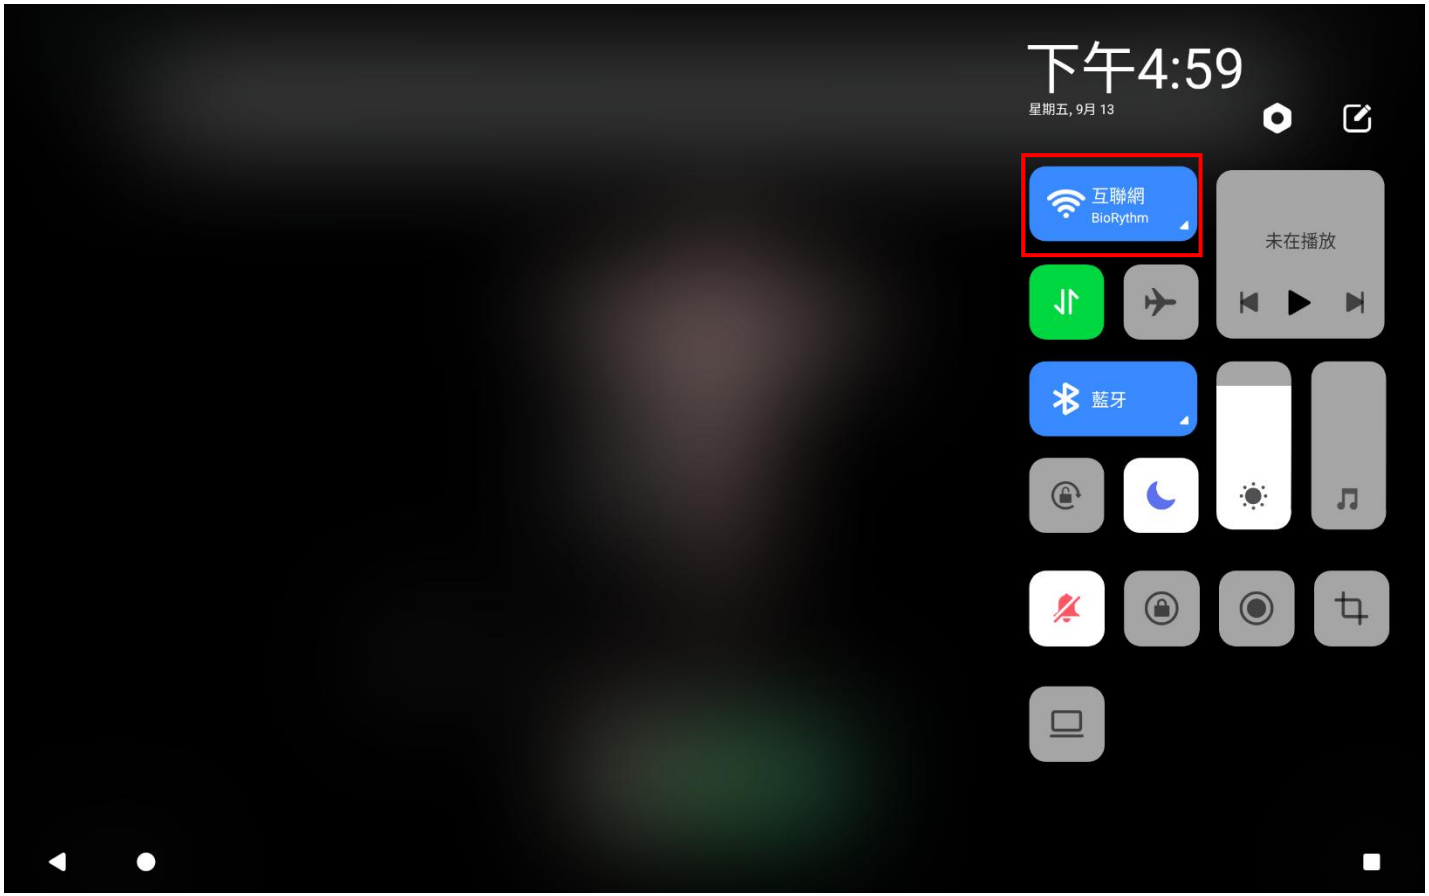

2.1 檢查無線網路：

請檢查您目前的 Wi-Fi 連線是否成功連結到網路。

2.2 關閉小程式（如果仍未解決問題，則執行第 3 步）：

資料上傳過程中，系統會自動跳轉至小程式。點擊右上角的圓形圖示關閉小程式。然後您可以返回系統頁面並重複資料上傳步驟。

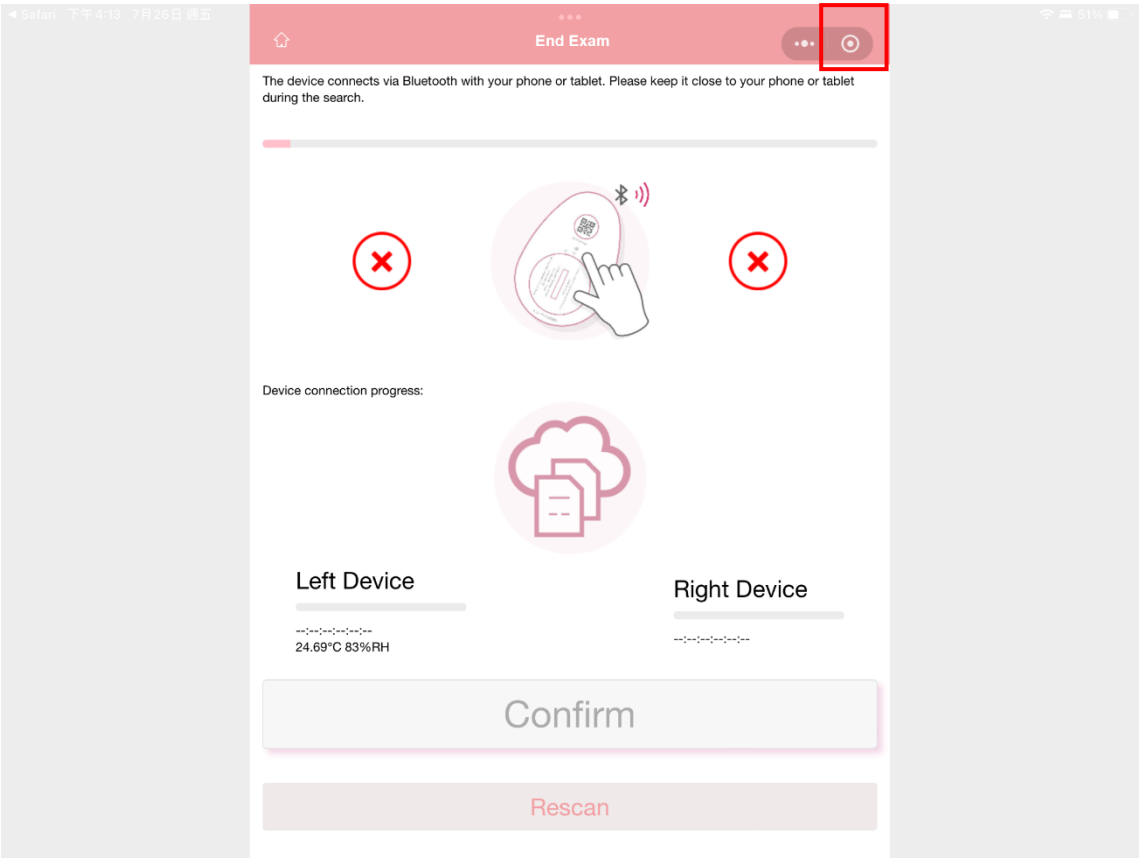

2.3 刪除小程式：

刪除微信內的小程式。

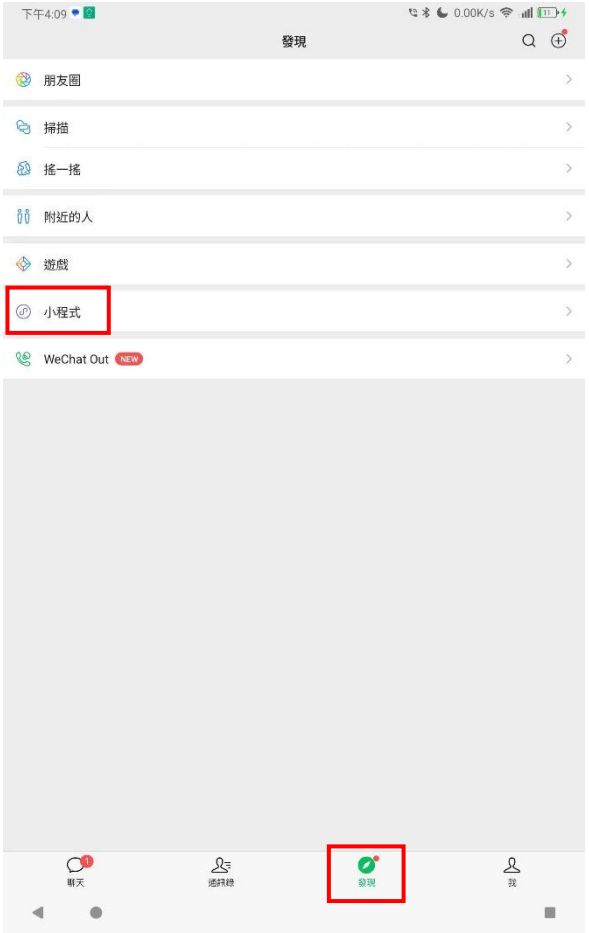

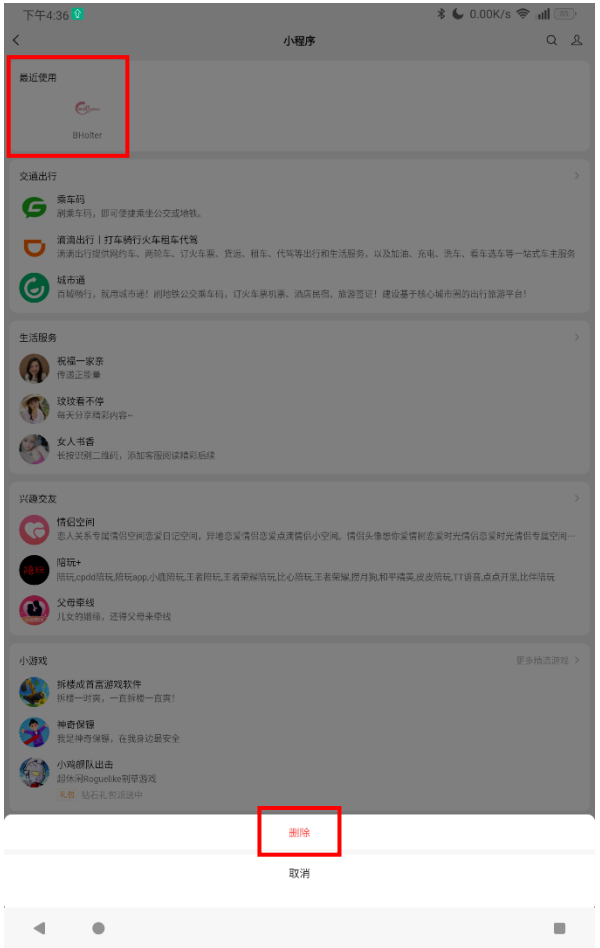

刪除小程式的步驟：

1. 打開微信，選擇「發現」頁面，點擊「小程式」，長按頂部最近使用欄位中的「BHolter」圖標，然後點擊底部的「刪除」。小程式現已成功刪除。

2. 返回系統頁面，從目錄中選擇「監控任務」，再次點擊「上傳數據」，繼續執行資料上傳步驟，再次上傳數據。

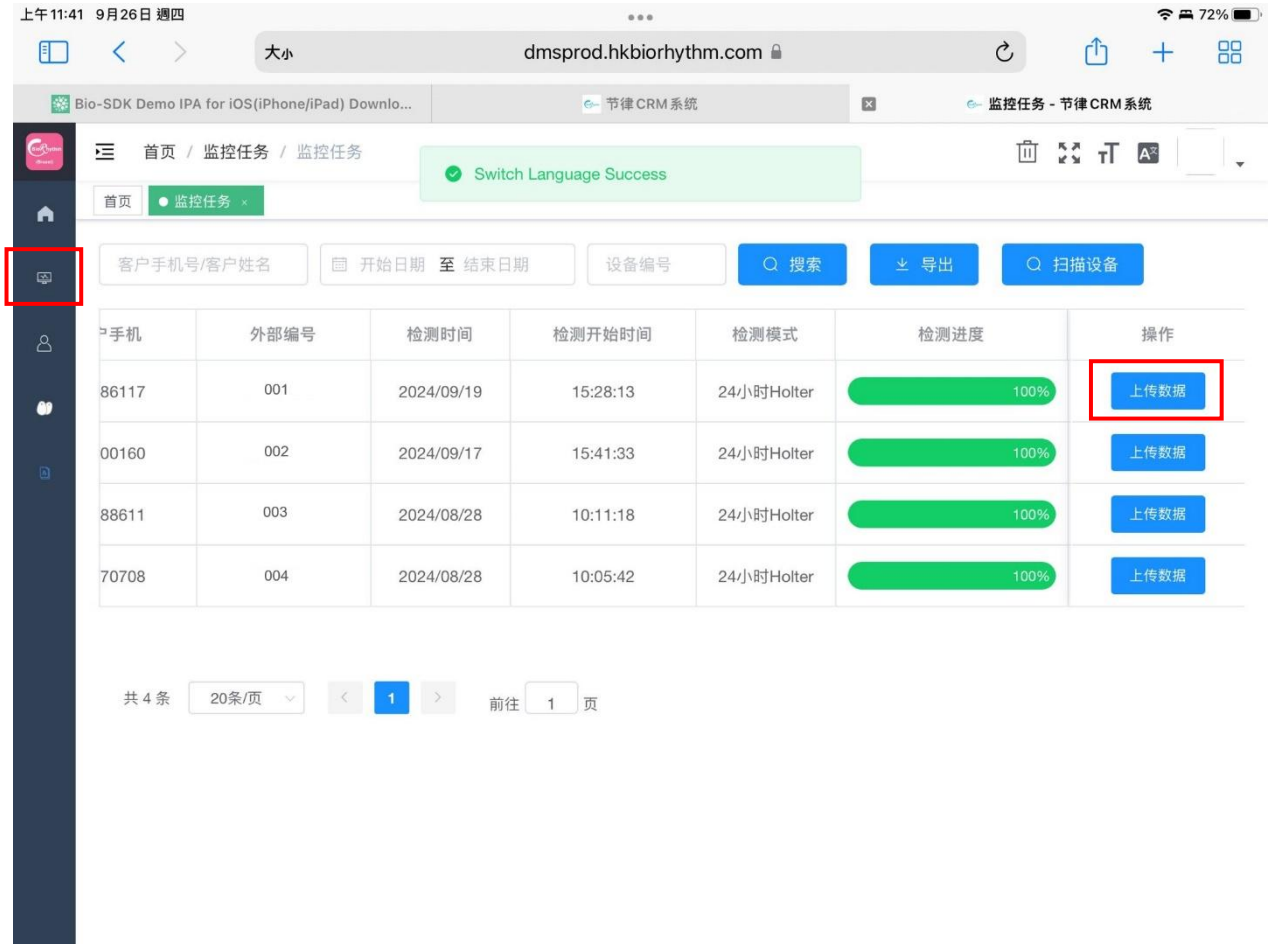

3. 當系統自動跳到微信小程式時，點擊「同意並繼續」，然後點擊「微信授權」繼續。

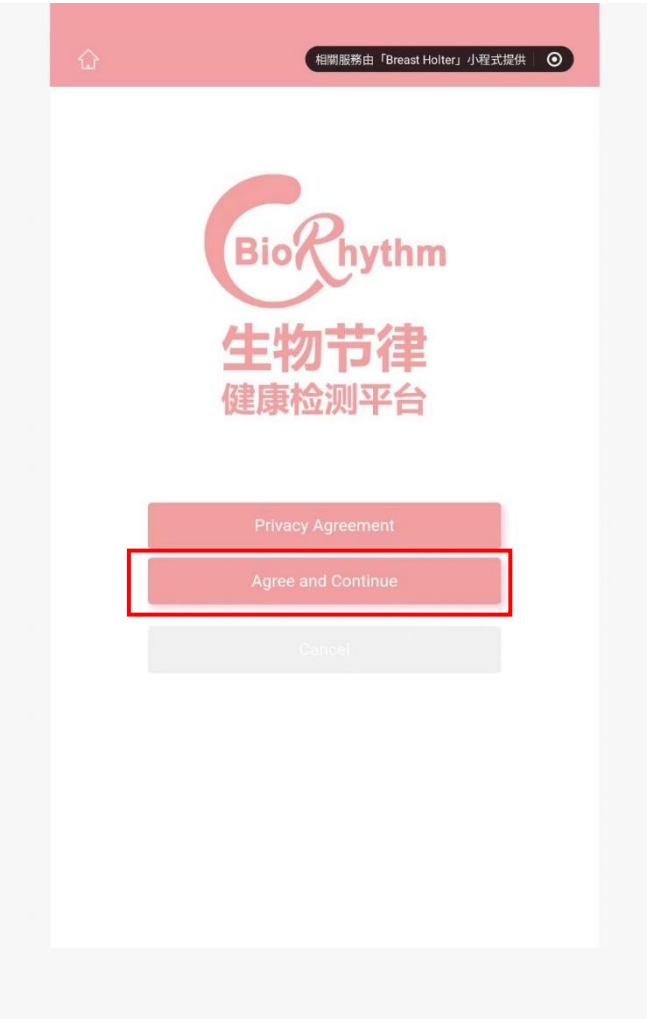

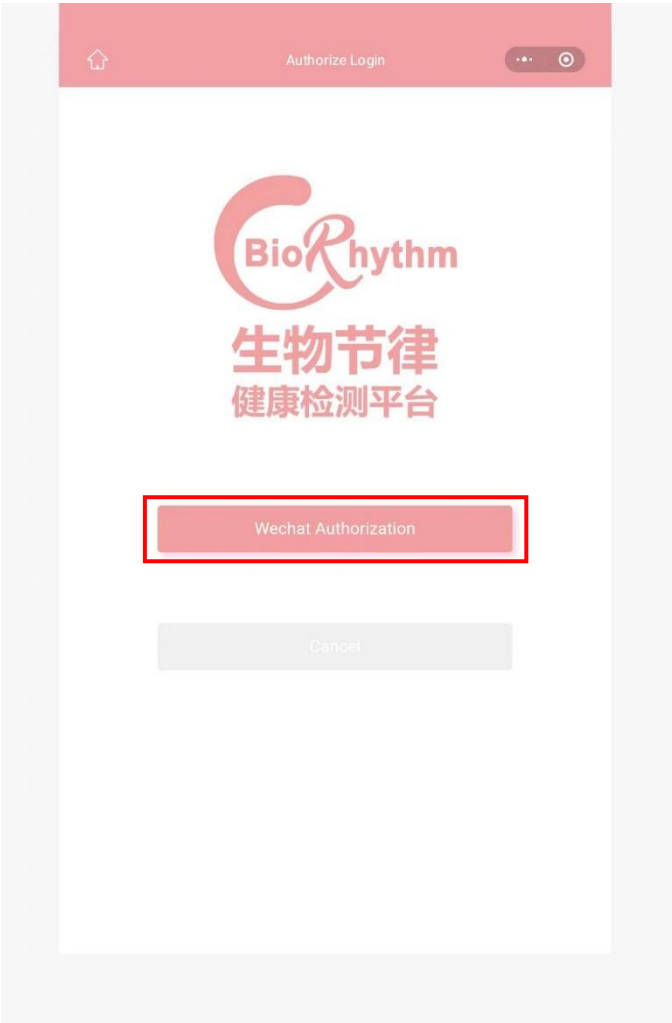

4. 當提示「使用你的藍牙」授權時，點擊「允許」。
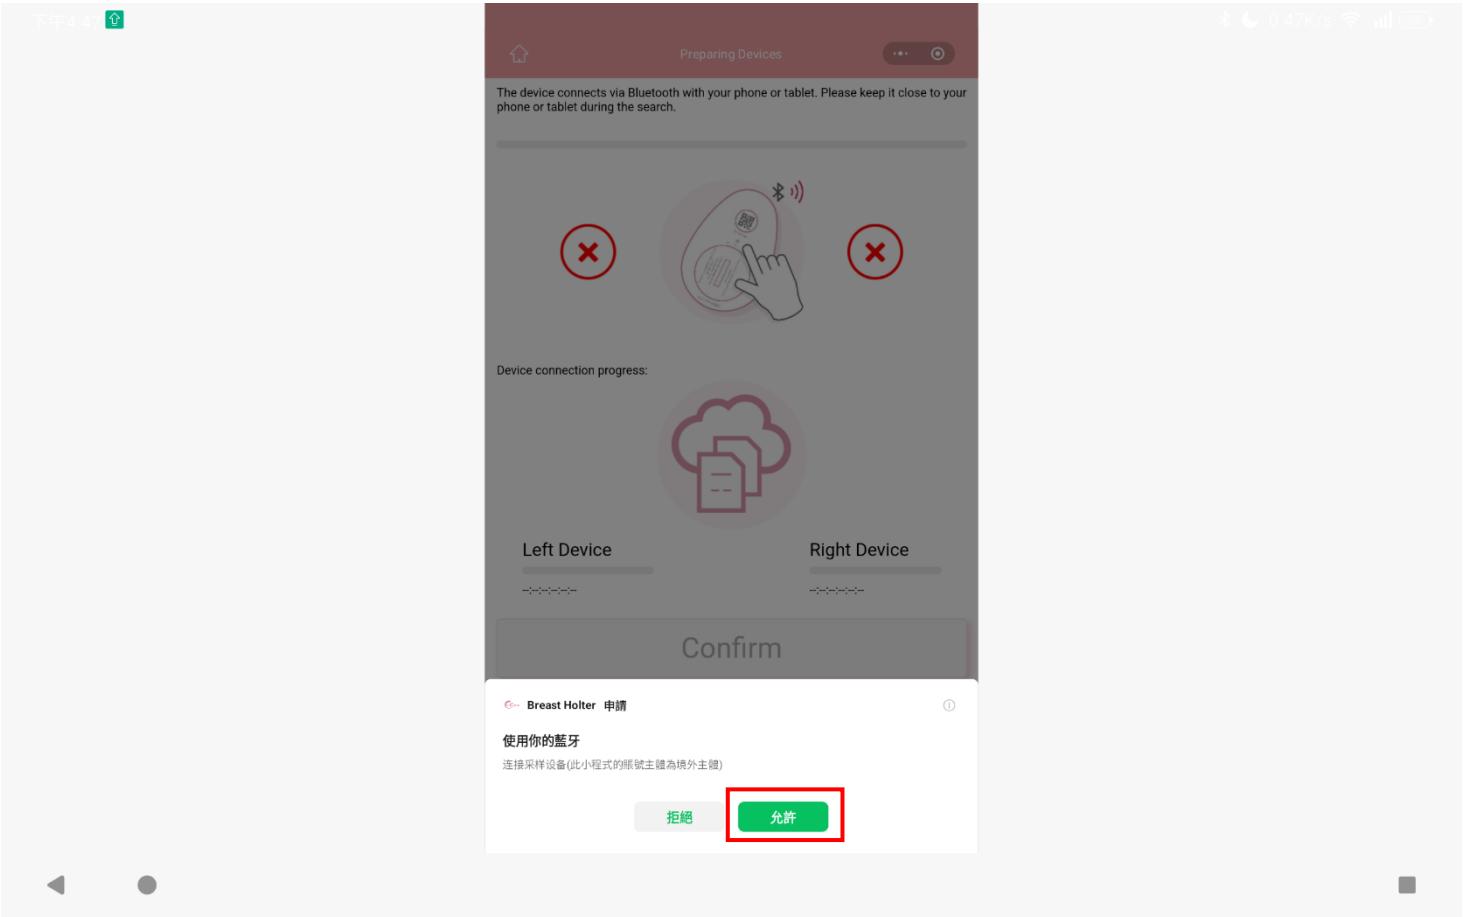
5. 現在您可以按照正常步驟上傳數據。