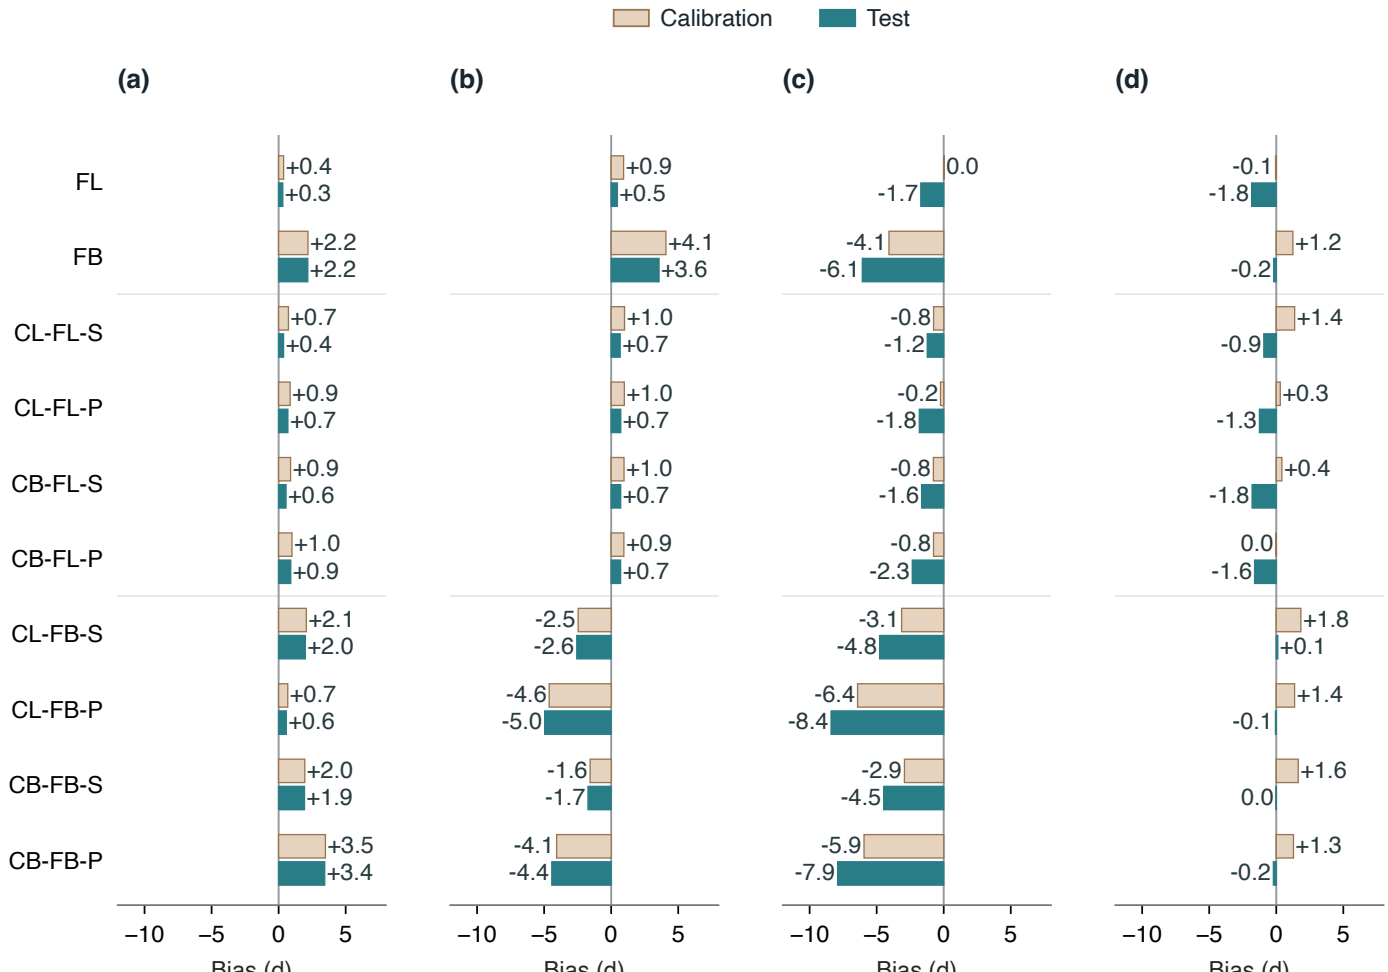

Calibration
Test
(a)
(b)
(c)
(d)
FL
FB
CL-FL-S
CL-FL-P
CB-FL-S
CB-FL-P
CL-FB-S
CL-FB-P
CB-FB-S
CB-FB-P
+0.4
+0.3
+2.2
+2.2
+0.7
+0.4
+0.9
+0.7
+0.9
+0.6
+1.0
+0.9
+2.1
+2.0
+0.7
+0.6
+2.0
+1.9
+3.5
+3.4
+0.9
+0.5
+4.1
+3.6
+1.0
+0.7
+1.0
+0.7
+1.0
+0.7
+0.9
+0.7
-2.5
-2.6
-4.6
-5.0
-1.6
-1.7
-4.1
-4.4
0.0
-1.7
-4.1
-6.1
-0.8
-1.2
-0.2
-1.8
-0.8
-1.6
-0.8
-2.3
-3.1
-4.8
-6.4
-8.4
-2.9
-4.5
-5.9
-7.9
-0.1
-1.8
+1.2
-0.2
+1.4
-0.9
+0.3
-1.3
+0.4
-1.8
0.0
-1.6
+1.8
+0.1
+1.4
-0.1
+1.6
0.0
+1.3
-0.2
−10
−5
0
5
Bias (d)