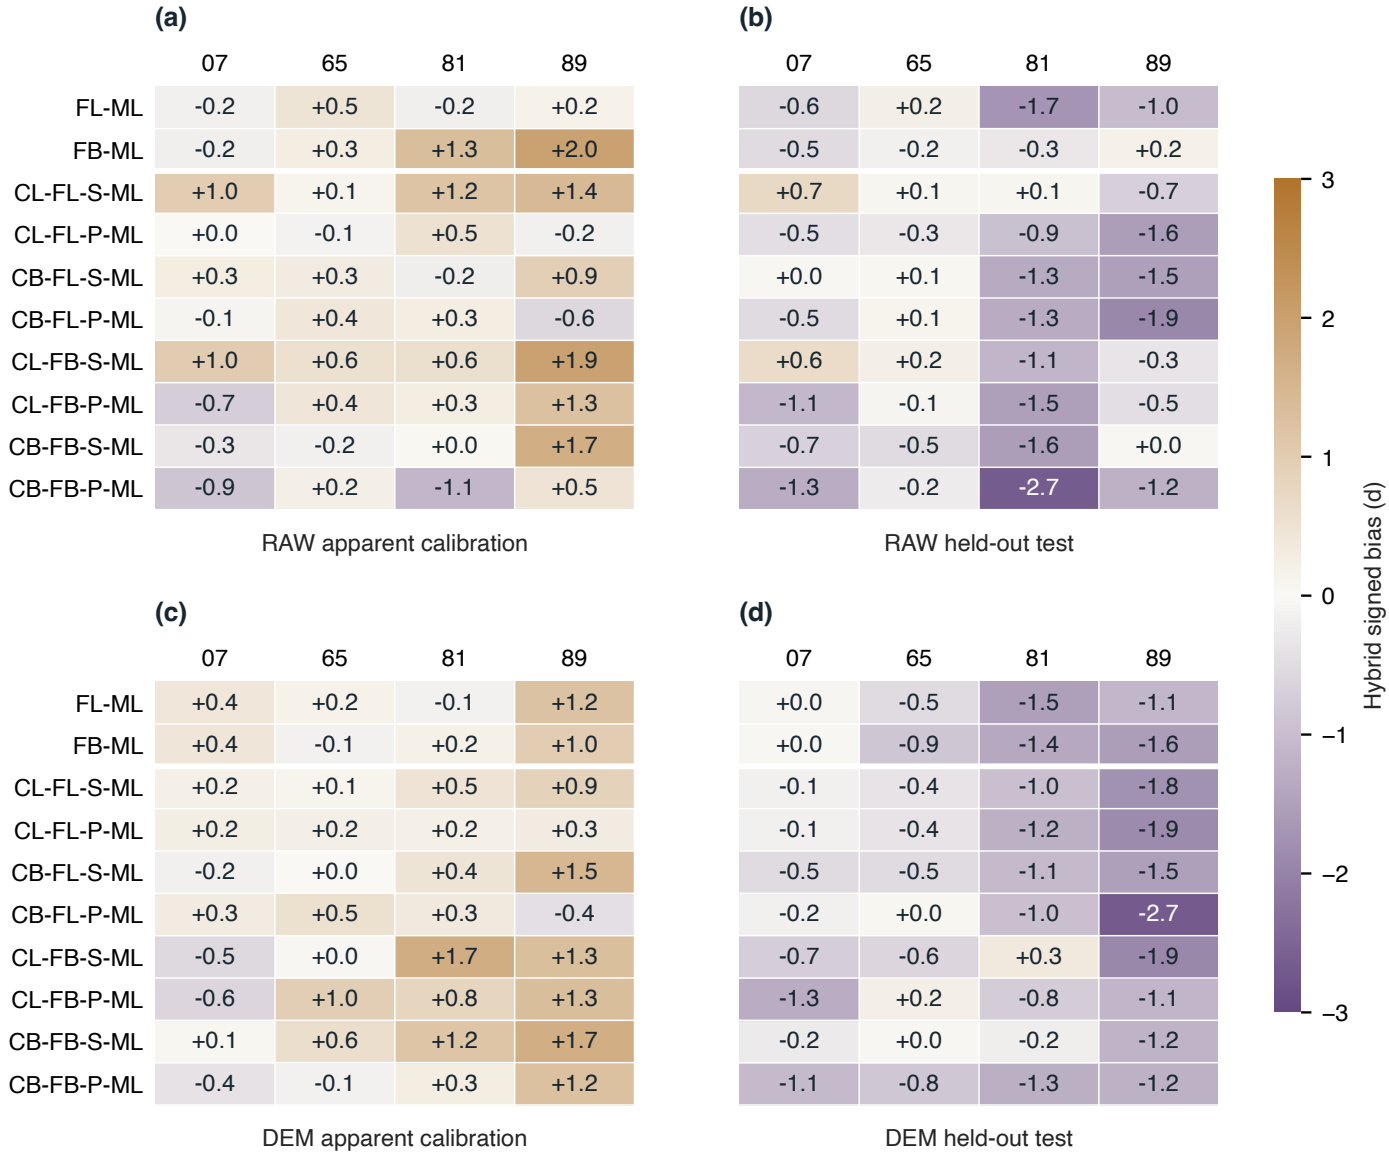

(a)
07 65 81 89
FL-ML -0.2 +0.5 -0.2 +0.2
FB-ML -0.2 +0.3 +1.3 +2.0
CL-FL-S-ML +1.0 +0.1 +1.2 +1.4
CL-FL-P-ML +0.0 -0.1 +0.5 -0.2
CB-FL-S-ML +0.3 +0.3 -0.2 +0.9
CB-FL-P-ML -0.1 +0.4 +0.3 -0.6
CL-FB-S-ML +1.0 +0.6 +0.6 +1.9
CL-FB-P-ML -0.7 +0.4 +0.3 +1.3
CB-FB-S-ML -0.3 -0.2 +0.0 +1.7
CB-FB-P-ML -0.9 +0.2 -1.1 +0.5
RAW apparent calibration
(b)
07 65 81 89
-0.6 +0.2 -1.7 -1.0
-0.5 -0.2 -0.3 +0.2
+0.7 +0.1 +0.1 -0.7
-0.5 -0.3 -0.9 -1.6
+0.0 +0.1 -1.3 -1.5
-0.5 +0.1 -1.3 -1.9
+0.6 +0.2 -1.1 -0.3
-1.1 -0.1 -1.5 -0.5
-0.7 -0.5 -1.6 +0.0
-1.3 -0.2 -2.7 -1.2
RAW held-out test
(c)
07 65 81 89
FL-ML +0.4 +0.2 -0.1 +1.2
FB-ML +0.4 -0.1 +0.2 +1.0
CL-FL-S-ML +0.2 +0.1 +0.5 +0.9
CL-FL-P-ML +0.2 +0.2 +0.2 +0.3
CB-FL-S-ML -0.2 +0.0 +0.4 +1.5
CB-FL-P-ML +0.3 +0.5 +0.3 -0.4
CL-FB-S-ML -0.5 +0.0 +1.7 +1.3
CL-FB-P-ML -0.6 +1.0 +0.8 +1.3
CB-FB-S-ML +0.1 +0.6 +1.2 +1.7
CB-FB-P-ML -0.4 -0.1 +0.3 +1.2
DEM apparent calibration
(d)
07 65 81 89
+0.0 -0.5 -1.5 -1.1
+0.0 -0.9 -1.4 -1.6
-0.1 -0.4 -1.0 -1.8
-0.1 -0.4 -1.2 -1.9
-0.5 -0.5 -1.1 -1.5
-0.2 +0.0 -1.0 -2.7
-0.7 -0.6 +0.3 -1.9
-1.3 +0.2 -0.8 -1.1
-0.2 +0.0 -0.2 -1.2
-1.1 -0.8 -1.3 -1.2
DEM held-out test
Hybrid signed bias (d)
3
2
1
0
−1
−2
−3