
КОНСОЛЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КГР-453 «АТРИУМ»

Краткая инструкция по безопасной эксплуатации

По данным руководства по эксплуатации консолей КГР и регистрационного удостоверения ФСР 2007/00872



Лицевая сторона

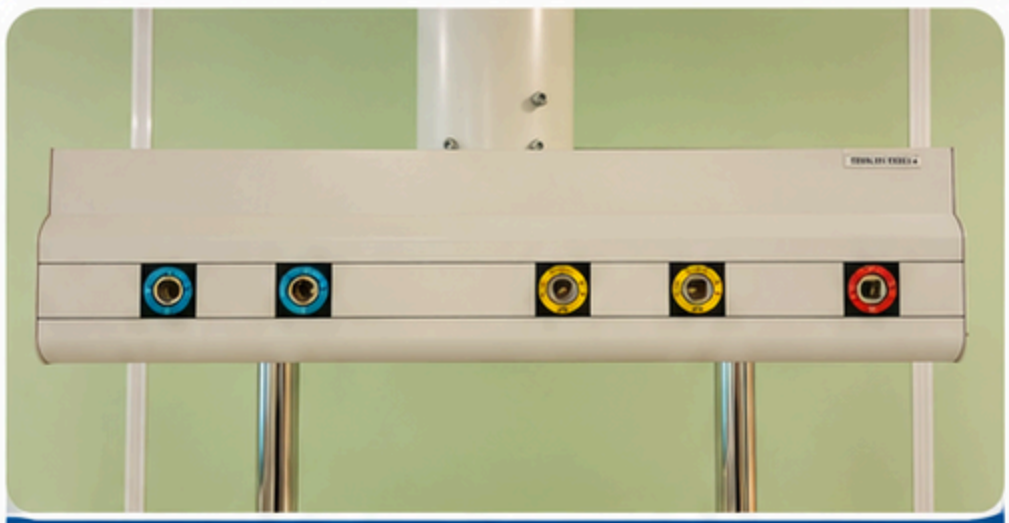

Обратная сторона

НАЗНАЧЕНИЕ

Консоль предназначена для электрической и газовой коммутации и контроля. Используется для подключения систем и аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к центральным разводкам медицинских газов и электрической сети лечебного учреждения.

СОСТАВ И РАЗЪЁМЫ

- **Лицевая сторона:** 12 розеток 220 V, центральный защитный модуль, световые индикаторы.
- **Обратная сторона:** O_2 — 2 разъёма, AIR — 2 разъёма, VAC — 1 разъём.
- Допускается подключение только совместимого зарегистрированного медицинского оборудования.

ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. Проверьте целостность корпуса, розеток, газовых разъёмов и кабелей.
2. Убедитесь, что подключаемое оборудование совместимо с сетью 220±22 В, 50±0,5 Гц.
3. Сверьте обозначение медицинского газа и используйте только соответствующие штекеры и шланги.
4. К работе допускается обученный персонал.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Подключайте аппаратуру аккуратно, не допуская натяжения проводов и газовых шлангов.
- Не перегружайте электрические розетки.
- Не закрывайте доступ к электрическим и газовым соединениям.
- Используйте только исправное оборудование и принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не реже одного раза в три месяца проверяйте качество крепления боковых стоек консоли.
- Наружные поверхности очищайте по утверждённому СОП учреждения.
- Проверку, ремонт и замену элементов выполняет только квалифицированный специалист.

ВАЖНО

- Консоль имеет опасное напряжение **220 В.**
- Подключение допускается только к сетевому питанию с **защитным заземлением.**
- Масло в соединении с кислородом **взрывоопасно.**
- При отказе или неисправности отключите консоль сетевым выключателем и сообщите ремонтному персоналу.
- **Не выполняйте самостоятельный ремонт.**

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ГАЗОВЫХ РАЗЪЁМОВ:

- O_2 — кислород (2 разъёма)
- **AIR** — сжатый воздух (2 разъёма)
- **VAC** — вакуум (1 разъём)

Памятка не заменяет паспорт изделия и локальные инструкции учреждения.