




- a) ON/OFF
- b) кнопки регулирования базовых настроек CPAP
- c) ручка изменения и подтверждения значений
- d) кнопка запуска ручной поддержки
- e) кнопка отключения тревоги
- f) кнопка специальных и прочих настроек

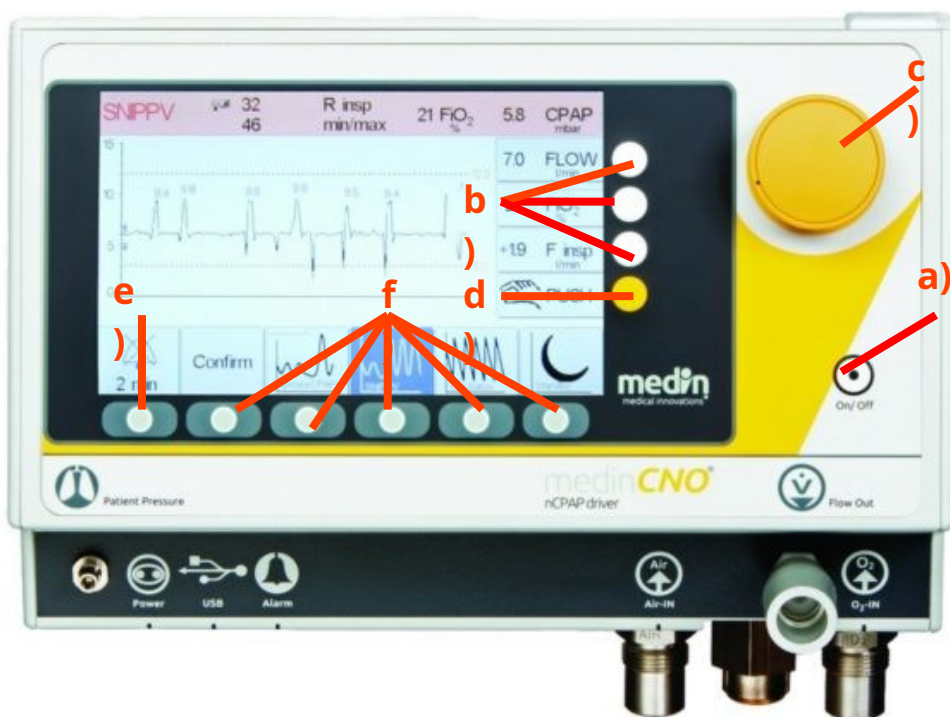

- a) ON/OFF
- b) кнопки регулирования базовых настроек CPAP
- c) ручка изменения и подтверждения значений
- d) кнопка запуска ручной поддержки
- e) кнопка отключения тревоги
- f) кнопка специальных и прочих настроек

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора, а также датчики пульсоксиметрические, кабель пациента, манжеты для измерения давления, датчики температуры, принадлежности капнометра и модуля инвазивного измерения давления не одноразового применения.

Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора, а также датчики пульсоксиметрические, кабель пациента, манжеты для измерения давления, датчики температуры, принадлежности капнометра и модуля инвазивного измерения давления не одноразового применения.

Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;