

NIHON KONDEN Прикроватный монитор

PVM-2701/2703

Передняя панель

Индикатор тревоги. Красная или оранжевая лампа мигает согласно настройкам тревоги. Зеленая лампа мигает синхронно с импульсами QRS пациента.


Сенсорный экран. Отображает данные мониторинга. При касании кнопок или данных на экране изменяются настройки и экраны.

Выключатель питания. Для включения или выключения монитора нажмите и удерживайте её не менее 1 секунды.

Индикатор питания. Светится когда питание монитора включено.

Индикатор питания от сети переменного тока. Светится, когда кабель питания подключен от гнезда сетевого кабеля к розетке электросети.

Индикатор батареи. Отображает состояние аккумуляторной батареи.

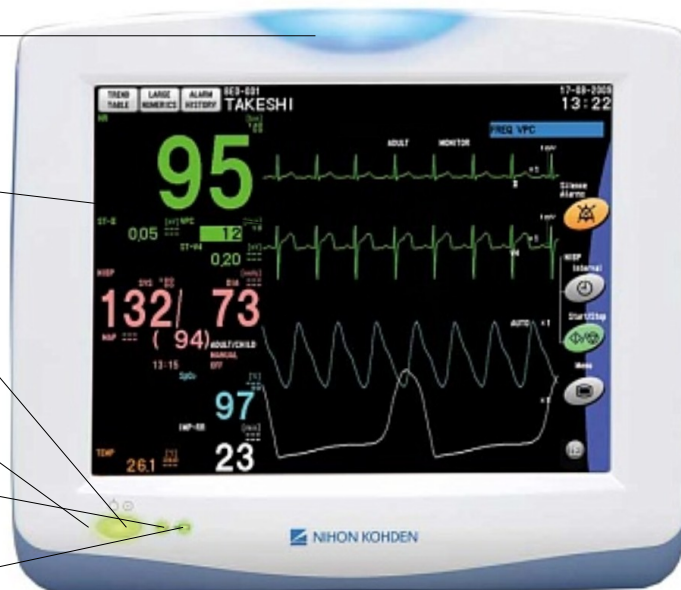

NIHON KONDEN Прикроватный монитор

PVM-2701/2703

Передняя панель

Индикатор тревоги. Красная или оранжевая лампа мигает согласно настройкам тревоги. Зеленая лампа мигает синхронно с импульсами QRS пациента.


Сенсорный экран. Отображает данные мониторинга. При касании кнопок или данных на экране изменяются настройки и экраны.

Выключатель питания. Для включения или выключения монитора нажмите и удерживайте её не менее 1 секунды.

Индикатор питания. Светится когда питание монитора включено.

Индикатор питания от сети переменного тока. Светится, когда кабель питания подключен от гнезда сетевого кабеля к розетке электросети.

Индикатор батареи. Отображает состояние аккумуляторной батареи.

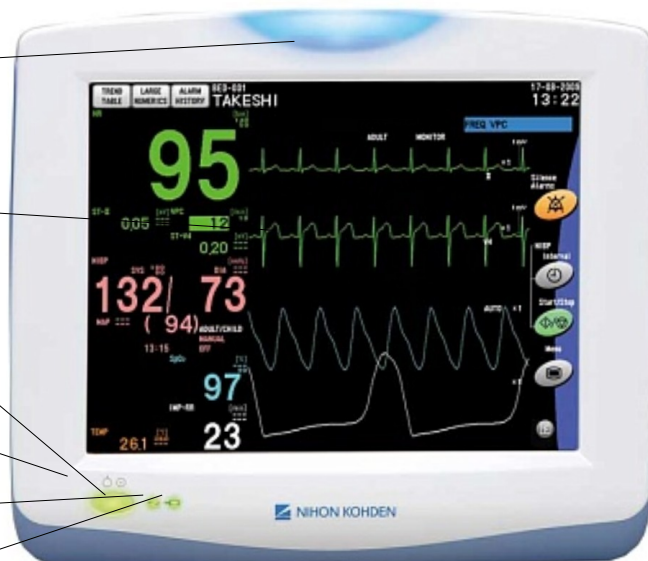

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора. Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора. Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;