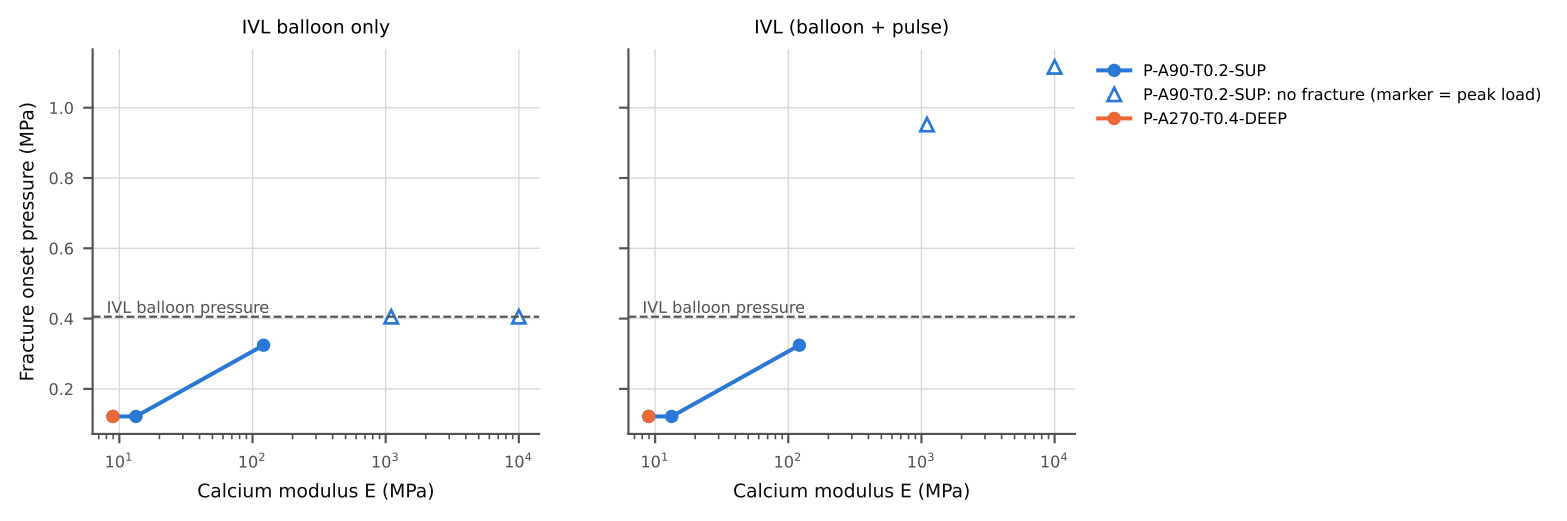
IVL balloon only
IVL (balloon + pulse)
Fracture onset pressure (MPa)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
IVL balloon pressure
IVL balloon pressure
10^1
10^2
10^3
10^4
Calcium modulus E (MPa)
Calcium modulus E (MPa)
P-A90-T0.2-SUP
P-A90-T0.2-SUP: no fracture (marker = peak load)
P-A270-T0.4-DEEP