

批量升级工具的使用

为提升客户端升级软件效率，特配置多串口下载工具。支持最多 8 台单泵同时升级软件，药物库，品牌库等。

所需工具：

- 1、多串口下载工具
- 2、USB 连接线——连接电脑
- 3、多串口下载工具电源
- 4、8 根 3 系串口线或 8 根 5 系串口线。
- 5、所需升级单泵。
- 6、U 盘内含驱动或前往


http://www.mmui.com.cn/cn/product_details868.html 下载、
接线图如下




配置 COM 口



由于 PC 工具只能识别 COM1-COM9，无法识别 COM10 以上端口，若接入多串口升级工具，需在设备管理界面设置 COM 口数字。

进入我的电脑，右键管理，进入设备管理器，下拉端口（COM 和 LPT），若 COM 口数字超过 9. 需将 10 及以上的数字修改为 10 以后。

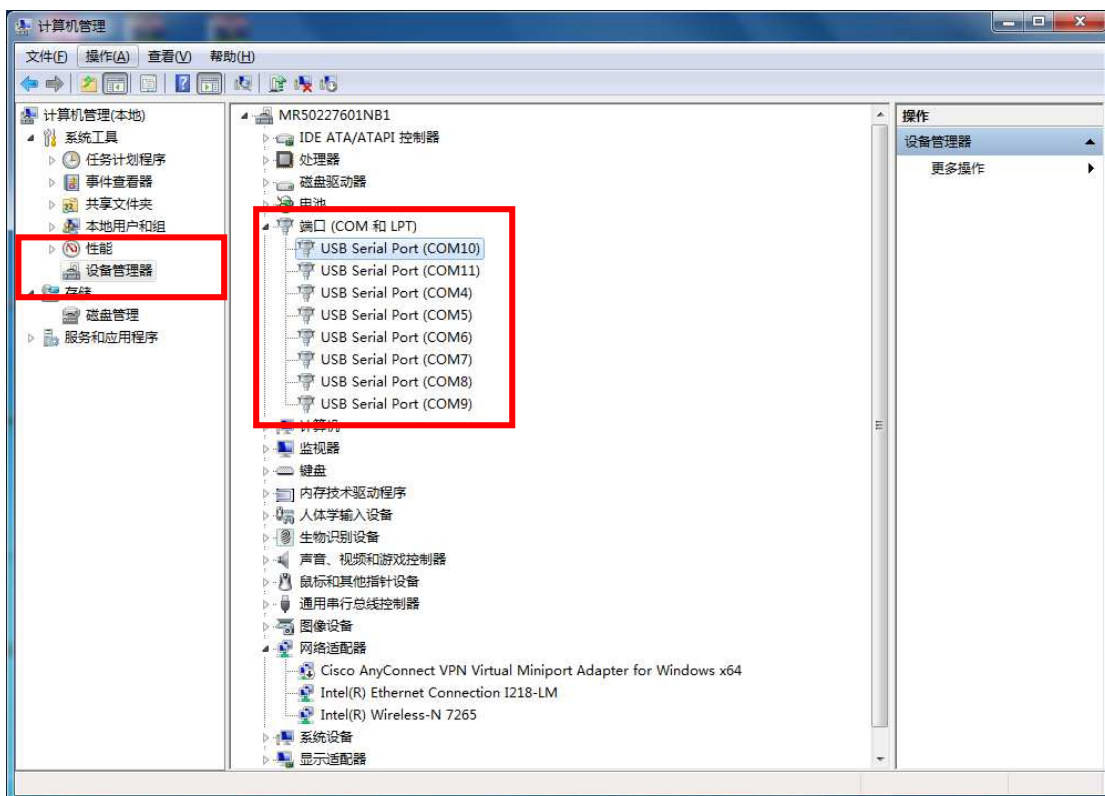

选择对应的端口，右键属性、端口设置，高级，选择未使用的端口即可。

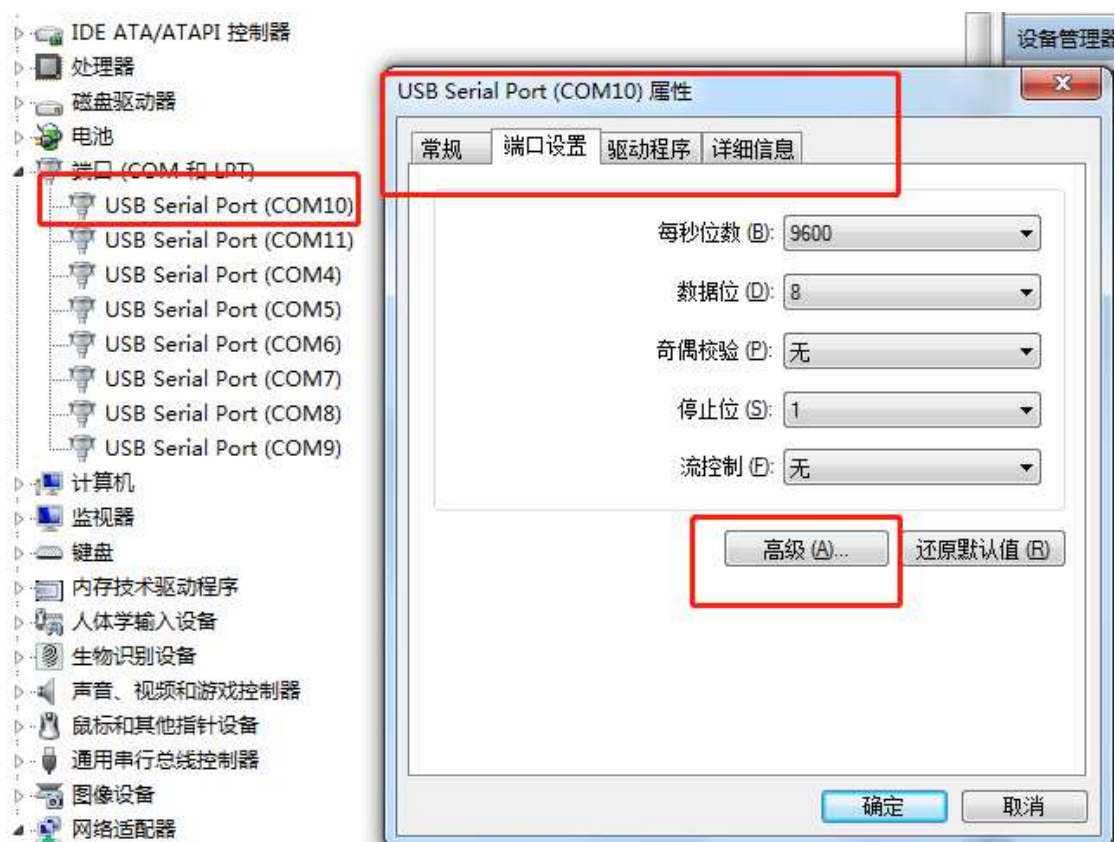


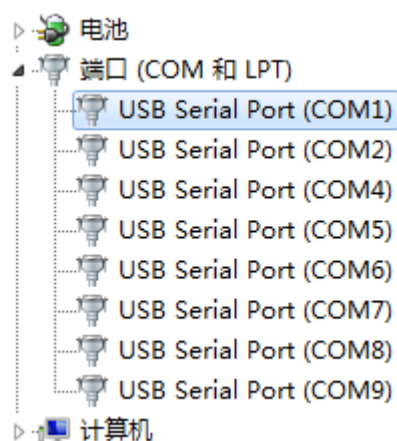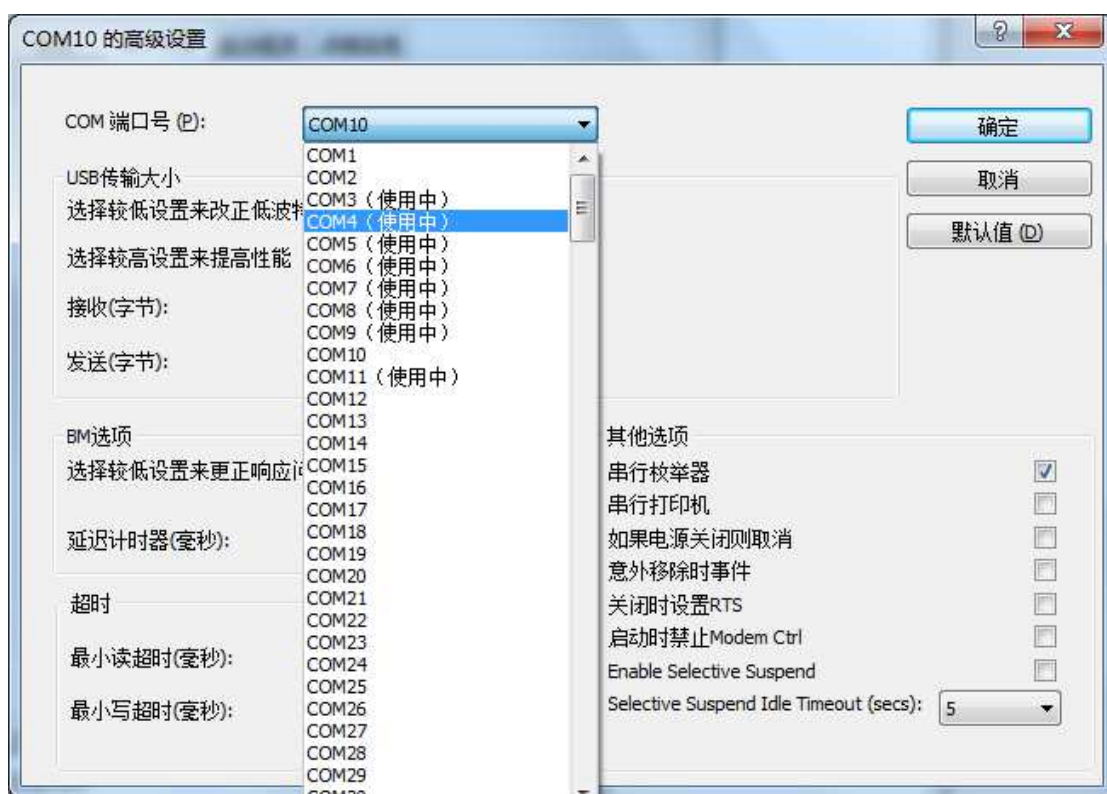

确保各 COM 口不重复即可。

使用步骤：

- 1、安装驱动
- 2、按照上图接线。
- 3、按照单泵升级方式进行操作
- 4、软件界面显示 8 台泵升级进度，每个 COM 口对应不同的机器。

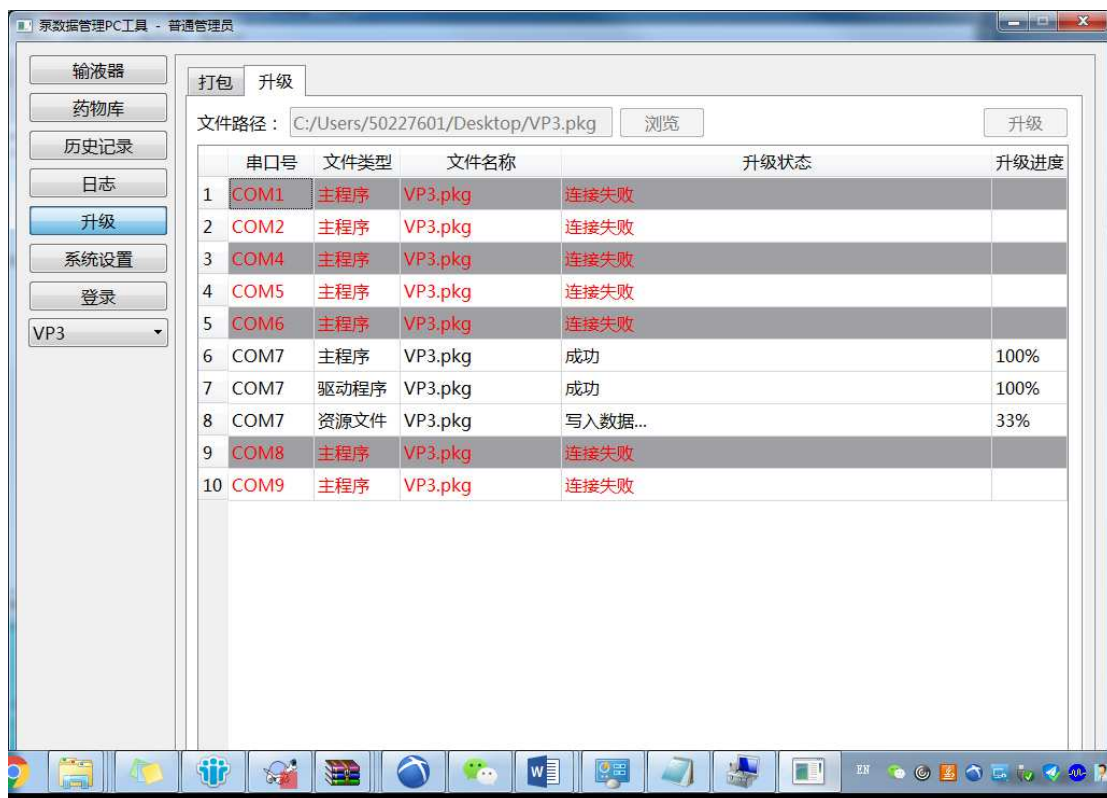

注意：升级时 8 台泵同时升级软件，这 8 台泵需要是使用同一目标软件的泵。